

CATALOGO GENERALE

EDIZIONE 11 **2022/2023**



Orgogliosamente Italiani

OUR MISSION

Nata dall'esperienza maturata nel settore odontotecnico e della meccanica di precisione, Anteea con sede a Lucca è la sintesi tra esperienze di medici odontoiatri, esperti di settore nel campo dell' implantologia dentale e del settore odontoiatrico.

Anteea, studia, progetta, produce e commercializza componenti innovativi che permettono di soddisfare le richieste dei professionisti. La collaborazione con aziende e professionisti con elevata esperienza nel settore chirurgico, implantologico, tecnico, protesico, informatico e meccanico, che giornalmente utilizzano le più innovative e sofisticate tecniche di implantologia, consente ad Anteea di avere a disposizione tutto il know-how necessario per lo sviluppo di tutti i prodotti a catalogo.

La ricerca della qualità, sia in produzione che nell'organizzazione e nei servizi erogati, è una scelta strategica dell'azienda, nonché fattore chiave del suo successo. Quotidianamente si eseguono controlli diretti e rigorosi sul 100% dei semi-lavorati al termine di ogni fase del processo produttivo, avvalendosi di sofisticate apparecchiature ottiche di precisione.

Il controllo di produzione si basa su protocolli definiti nei quali vengono standardizzate le quantità e la frequenza dei controlli (a seconda della tipologia del prodotto) e i criteri di accettabilità. I controlli dimensionali avvengono mediante macchine di misurazione professionali 3d in grado di assicurare una precisione di 0,005mm (0,5 micron).

Anteea mantiene anche i più alti standard di qualità in tutti gli aspetti delle nostre operazioni dalla ricerca e sviluppo, approvvigionamento di materie prime, fabbricazione, stoccaggio, spedizione del prodotto, fino ai consulenti di vendita e di servizio al cliente.

Questo include anche una formazione costante e lo sviluppo professionale di tutto il nostro personale ad ogni livello.

Per garantire questo alto livello di qualità, ogni prodotto è sottoposto a numerosi test e verifiche utilizzando processi sia interni che esterni.

Anteea opera in un regime di controllo della qualità conforme agli standard UNI CEI EN ISO 13485/2016 relative ai dispositivi medici, in ottemperanza alla Direttiva Europea MDR 745/2017.

In Anteea, la tradizione incontra l'innovazione e la rende una realtà originale e con caratteristiche uniche che ci rende orgogliosamente italiani.

LEGENDA

H	Altezza tras mucosa
PE	Profilo di Emergenza.
E	In stock a magazzino ma disponibile fino ad esaurimento
R	Disponibile su richiesta
$\varnothing$	Diametro in mm.



DUAL SISTEM

ATTENZIONE: IL MONCONE PERSONALIZZABILE DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

In fase di ordine postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete **vite D.I.S. testa esagonale**

In fase di ordine postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete **vite D.I.S. testa torx**

In fase di ordine lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete **vite "standard"**

Nel presente catalogo tutte le misure sono espresse in millimetri (mm)

*Tutti i prodotti contrassegnati dai simboli **®** e **TM** sono marchi registrati del produttore corrispondente.*

La pubblicazione e/o riproduzione non è consentita.

IMPORTANTE

Tutti i prodotti salvo diverse indicazioni sono venduti singolarmente (pack singolo).

Tutti i prodotti (che necessitano di vite) salvo diverse indicazioni sono comprensivi della vite stessa coordinata.

I dati tecnici, le foto ed i colori contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi. Anteea Srl si riserva di modificare e apportare soluzioni tecniche differenti in ogni momento e senza preavviso.

I codici del presente catalogo potrebbero subire variazioni.

In fase d'ordine specificare sempre codice casa implantare e specifiche tecniche.

Qualora in fase d'ordine uno dei codici articolo del presente catalogo, non fosse disponibile, sarà premura di Anteea Srl contattare le S.V. per informazioni e verifica timeline produzione.

Al fine di migliorare i prodotti Anteea Srl si riserva di modificare e apportare soluzioni tecniche differenti in ogni momento e senza preavviso.

I prodotti sono in continuo e costante aggiornamento. Vi invitiamo a visionare eventuali nuove piattaforme sul sito:

WWW.ANTEEA.COM

Indice

A Serie Compatibile ASTRATECH®/ OSSEOSPEED™

Pag. 20

Ø3.0

Cortex - Dinamix NP

Ø3.5 / 4.0

Mozo Grau® (In-Ex MTA)
 Etk® (Natea)
 Etk® (natural)
 Etk® (naturactis)
 Geass® (Way milano)
 Geass® (Way extra)
 Geass® (Way mix)
 Leader Medica® (five)
 Leader Medica® (tsmart)
 Leader Medica® (five)
 ProClinique® (Aqua CM)
 Southern Implants® (Deep Conical)
 Btk® (Mth)
 Btk® (Mtd)
 Btk® (kr)
 Btk® (easy+)
 Clscientific® (conic)
 Sympla® (GTB)
 Sympla® (GTB-r)
 Galimplant® (ipx)
 Galimplant® (iCI)
 Cortex - Magix RP
 Cortex - Dinamix RP
 Cortex - Classix RP

Ø4.5 / 5.0

Geass® (Milano)
 Geass® (Way)
 Geass® (Way extra)
 Geass® (Way mix)
 Southern Implants® (Deep Conical)
 Cortex - Dinamix WP
 Cortex - Classix WP

AK Serie Compatibile ANKYLOS®

Pag. 24

AL Serie Compatibile ALPHABIO® / AB® / NORIS®

Pag. 28

Ø3.75

AB®
 Adin® (Os / S / Swell)
 Alphabio®
 Avinent® (IC Ø3.5)
 Axelmed® (Paradigma)
 Bio Horizon®
 BTK®
 Cortex® (Classic)
 Cortex® (Internal Ex Dinamic)
 Cortex® (Saturn)
 DentalTech® (Implogic)
 Dering® (Exacort)
 Ditron® (Mci-Ultimate)
 Edgar® (MaxLogic)
 Hi-Tec Implant® (Plus Spark)
 Implant Direct® (Legacy)
 Intralock® (Intra Hex)
 Ires® (Shape One b)
 Ires® (TN)
 Ires® (Imax NHSI)
 Ires® (Volution)
 Isomed® (E-Interno)

JDCare® (JD Evolution)
 JDCare® (Evolution Plus+)
 Kristal® (Bioimplant)
 Kristal® (Core V2)
 Kristal® (K-Core V2)
 Krugg® (Platinum / Gold)
 Leader® Medica (Mito)
 Medline® (VCore / Classic /Short)
 Mirell®
 MIS® (Seven - M4)
 Noris Medical® (Tuff)
 Noris Medical® (Tuff Pro)
 Noris Medical® (Tuff TT)
 Noris Medical® (Onyx)
 Noris Medical® (Cortical Ptericore)
 NSI® (Light)
 Proclinique® (Connection Internal)
 Resita® (IC / IA / IK)
 Ritter®
 Southern Implant® (Internal Ex)
 Tag® (Axis - Massif)
 Triton® (Q Implant - 3.5 QZA)

ø3.5 (NP)

Mozo Grau® (In-Ex)
 Etk®
 Geass® (Way Venezia)
 Leader Medica®
 ProClinique® (Aqua CM)
 Southern Implants® (DC)
 Ires® (nhse ø3.3)
 Sympla® (syx full ø3.4)

ø4.1 (RP)

Ace® 3.75/4.1
 Antogyr® 3.75/4.1
 Avanza® 3.75/4.1/RP
 Avinent® RP
 Best Fit® RP
 Biolok®
 Bionnovation®
 Biotec®
 BTK® (Konic Ex)
 BTK® (Klassic Ext)
 Bti® (3.75/4.1 Universal)
 Calcitek® (Threadalock)
 Conexao®
 Phibo® (TSH S3/S4)
 Eckeman® 3.75/4.1
 Endopore® 3.75/4.1
 Ergo-System® RP
 Euroteknika® 3.75/4.1
 Evert® RP
 GMI® 4.1
 Imtec® 3.75/4.1
 Infit® 4.1
 Innova® 3.75/4.0/4.1
 INP® (Conus HE)

ø4.1 (RP)

Intra-Lock® ex
 I-RES® (EH - NH SE)
 Leather® 4.1
 Lifecore® RD
 Megagen® (External)
 Microdent® (Universal 3.75)
 Neodent® (Est 3.75 - 4.1)
 Oral-Tronics®
 Osseotite® RP
 Paragon® (Swede-Vent)
 Peclab®
 Proclinc® (S4)
 Steri-oss® (HL 3.80/4.10)
 Sterngold®
 Sustainv 4.1
 TBR®
 Tecnopro® (RP)
 Titanium Fix® 3.75
 Trinon® (Titanium-Q-Implant)
 ZIACOM® - (Osseolife RP EX)
 Sympla® (syx full ø3.4)

ø5.0 (WP)

Avanza® WP
 Avinet® WP
 Atlantis®
 Best Fit® WP
 Ilerimplant® 5.10
 INP® (Conus HE)
 Lifecore® RD
 Microdent® (Mt)
 Neodent®
 Titanium Fix® 5.1

ø3.5

AB®
 Adin® (OS / S / SWELL)
 Alpha-Bio®
 Avinent® (IC Ø3.5)
 Axelmed® (Paradigma)
 Bio Horizon ø3.5
 BTK® (INT IR)
 Cortex® (Classics)
 Cortex® (Interna Ex Dinamix)
 Cortex® (Saturn)
 Dentaltech® (Implogic)
 Dering® (Exakort)
 Ditron® (MCI-Ultimate)
 Edgar (Max-Logic)
 HI-TEC Implant® (Plus-Spark)
 Implant Direct® (Legacy)
 Intralock® (Intra Hex)
 Ires® (Shape One B)
 Ires® (Tn)
 Ires® (IMAX Nhsi)
 Ires® (Volution)
 Isomed® (E-Intern)

ø3.5

JDCare® (JD Evolution)
 JDCare® (JD Evolution Plus+)
 Kristal® (Bioimplant)
 Kristal® (Core V2)
 Kristal® (K-Core V2)
 Krugg® (Platinum / Gold)
 Leader Medica® (Mito)
 Medline® (V Core/Classic/Short)
 Mirrell®
 MIS® (Seven-M4)
 Noris Medical® (Tuff)
 Noris Medical® (Tuff PRO)
 Noris Medical® (Tuff TT)
 Noris Medical® (Onyx)
 Noris Medical® (Cortical Ptericore)
 NSI® (Light)
 Procilique® (Connection Internal)
 Resita® (IC / IA / IK)
 Ritter®
 Southern Implant® (Internal EX)
 TAG® (Axis-Massif)
 Trinon® (Q Implant ø3.5 QZA)

ø4.5

Avinent® (IC Ø4.1)
 Bio Horizon® ø4.5
 Dentaltech® (Implogic)
 HI-TEC Implant® (Plus Spark)
 Implant Direct® (Legacy)
 MIS® (Seven-M4)
 Trinon® (Q Implant ø4.5 QZA)

ø5.7

Bio Horizon® ø5.7



BX Serie Compatibile STRAUMANN® / BLX®

Pag. 48

C Serie Compatibile 3I® / CERTAIN® TAPERED CERTAIN INTERNAL / PARALLEL WALLED CERTAIN INTERNAL

Pag. 52

Ø4.1

Leader Medica® (TFI - versione pm)

Titan Implants®

CI Serie Compatibile CAMLOC® ISI®

Pag. 56

CL Serie Compatibile CAMLOG®

Pag. 58

CX Serie Compatibile ICX®

Pag. 60

D Serie Compatibile STRAUMANN® / BONE LEVEL®

Pag. 62

EV Serie Compatibile ASTRA TECH® / IMPLANT SYSTEM EV®

Pag. 66



FX Serie Compatibile DENTSPLY® / XIVE® / FRIALIT®

Pag. 70

Ø3.4

Geass® (KENTRON)

S.I.N.® (strong)

Ø3.8

Geass® (KENTRON)

S.I.N.® (Strong)

Ø4.5

S.I.N.® (Strong)

I Serie Compatibile IDI EVOLUTION®

Pag. 74

LE Serie Compatibile LEONE®

Pag. 77

LP Serie Compatibile LIFECORE® / PRIMACONNEX®

Pag. 79

MO Serie Compatibile MEGAGEN® / ANYONE®

Pag. 81

Dio Implant®

Dentium® (Superline™) & Implantium®

Dentis® (SQ®) (ONE Q®) (S-Clear®)

Biogenesis® (Aticon®)

Chaorum® (PT®)

M2 Implant®

MG Serie Compatibile MEGAGEN® / ANYRIDGE®

Pag. 85



MS Serie Compatibile MIS® / SEVEN® / M4®

Pag. 88

Ø3.75

AB®

Adin® (OS / S / SWELL)

Alpha-Bio®

Avinent® (IC Ø3.5)

Axelmed® (Paradigma)

Bio Horizon Ø3.5

BTK® (INT IR)

Cortex® (Classics)

Cortex® (Interna Ex Dinamix)

Cortex® (Saturn)

Dentaltech® (Implogic)

Dering® (Exakort)

Ditron® (MCI-Ultimate)

Edgar (Max-Logic)

Ø3.75

HI-TEC Implant® (Plus-Spark)

Implant Direct® (Legacy)

Intralock® (Intra Hex)

Ires® (Shape One B)

Ires® (Tn)

Ires® (IMAX Nhsi)

Ires® (Volution)

Isomed® (E-Intern)

JDCare® (JD Evolution)

JDCare® (JD Evolution Plus+)

Kristal® (Bioimplant)

Kristal® (Core V2)

Kristal® (K-Core V2)

Krugg® (Platinum / Gold)

Leader Medica® (Mito)

Ø3.75

Medline® (V Core/Classic/Short)

Mirrell®

MIS® (Seven-M4)

Noris Medical® (Tuff)

Noris Medical® (Tuff PRO)

Noris Medical® (Tuff TT)

Noris Medical® (Onyx)

Noris Medical® (Cortical Ptericore)

NSI® (Light)

Procilique® (Connection Internal)

Resita® (IC / IA / IK)

Ritter®

Southern Implant® (Internal EX)

TAG® (Axis-Massif)

Trinon® (Q Implant Ø3.5 QZA)

Ø4.5

Avinent® (IC Ø4.1)

Bio Horizon® Ø4.5

Dentaltech® (Implogic)

HI-TEC Implant® (Plus Spark)

Implant Direct® (Legacy)

MIS® (Seven-M4)

Trinon® (Q Implant Ø4.5 QZA)

MSC Serie Compatibile MIS® C1®

Pag. 92

NEW!

MSV Serie Compatibile MIS® V3®

Pag. 94

NEW!

N Serie Compatibile ACTIVE®/ REPLACE CC®/ PARALLEL®

Pag. 96

ø3.5 (NP)

Implant Direct® (Internal active)
Itech® (Expert)
Itech® (Immex logic)
Dering® (Dynamic)
Dering® (Singular)
Adin® (Close Fit)

ø4.3/5.0 (RP)

Adin® (Close Fit)

NE Serie Compatibile NEOSS®/ PROACTIVE®

Pag. 100

O Serie Compatibile 3I®/ESAGONO ESTERNO®

Pag. 102

ø3.4

3I® (Micro-mini)
AoN® (Cyrth)
AoN® (Karothe)
Atlantis®
Biolock® ø3.45
Microdent® (Ms)
Minimatic® ø3.45
Mozo Grau® ø3.40
Peclab®
Sin® ø3.4
Southern Implants®
leader medica® ø 3.4
Geass® (Hexa)
Geass® (Way Venezia)

ø4.1

AoN® (Cyrth / Karoth)
Avinet®
Branemark® (MK3I)
Biolok®
BTI® (Externa)
BTK® (Konic Ext)
BTK® (Klassic Ext)
Dio® (Ext)
Geass® (Hexa)
Geass® (Way Venezia)
Geass® (omni classics)
Leader®
Lifecore®
MIS® EX
Mozo Grau® (In-Ext)
Sin®
Southern Implants®
Sweden&Martina® (Outlink 2)

ø4.1

Titan Implants® (Maximum)
Resista® (ec)
Resista® (ek)
Resista® (ecmc)
Resista® (short)
Resista® (es genth)
Endopore® (External Hex)
Galimplant® (IPxe)
Dering® (biodent)
Dering® (kort)
Leader medica® (TCE)
Leader medica® (TfE)
Leader medica® (short)

ø5.0

Ace®
Endopore®
GMI® (Phoenix)
Imtec®
Innova®
Leader®
Leather®
MIS® (Ex)
Microdent Universal®
Sin®
Southern Implants®
Sweden&Martina® (Outlink)
Resista® ø5.0
Leader medica® ø5.0
BTK® (Ext ø5.0)
Geass® (Hexa)
Geass® (Way Venezia)
Galimplant® (IPxe)

OS Serie Compatibile OSSTEM®/ TSII®/ TSIII®/ TSIII ULTRA WIDE®/ TSIV®

Pag. 106

ø3.5

Hiossen® (ET II - ET III NH - ET III SA)
Shinhung® (Luna)
Shinhung® (Luna-S)

ø4.0

Hiossen® (ET II - ET III NH - ET III SA)
Shinhung® (Luna)
Shinhung® (Luna-S)

PH Serie Compatibile PHIBO®/ TSH®

Pag. 110

R Serie Compatibile REPLACE®/ SELECT TAPARED®/ SELECT STRAIGHT®

Pag. 113

ø3.5

Implant Direct® (Trilobe)
Hi Tech® (Vision)
Dering® (Bioneck)

ø4.3/5.0

Implant Direct® (Trilobe)
Hi Tech® (Vision)
Dering® (Bioneck)

S Serie Compatibile STRAUMANN®/ TISSUE LEVEL®

Pag. 117

Ø4.8 (RN)

Best Fit® (Oct)
DentalTech® (TR2 / TRW2)
Etk® (Aesthetica)
Geass® (Way Roma)
Geass® (Esedra dual)
Geass® (Way Rock)
Geass® (Way short)

Ø4.8 (RN)

GT-Medical®
Hightech® (Tite-Fit)
I-RES® (sIt)
Implant Direct® (Swish)
Megagen® (Ex Feel Internal)
Mis® (Mistral)
Osstem® (SS Line)

Ø4.8 (RN)

Proclinc® (Octa)
Sweden & Martina® (Stark)
Titan® (T-C)
Zimmer® (Swiss Plus)
symplo® (sy tissue)
endopore® (Internal connection tc)

SH Serie Compatibile SWEDEN®/ SHELTA®/ PREMIUM®/ KOHNO ONE®

Pag. 121

SK Serie Compatibile SWEDEN®/ PREMIUM®/ KOHNO®

Pag. 125

SO Serie Compatibile SWEDEN®/ OUTLINK®/ SYRA®

Pag. 129

T Serie Compatibile THOMMEN®

Pag. 133

WX Serie Compatibile WINSIX®

Pag. 136

Z Serie Compatibile ZIMMER®

Pag. 139

Ø3.5

AB®
Adin® (OS/S/Swell)
Alpha Bio®
AoN® (Cyroth)
AoN® (Karoht)
AoN® (Is-Four)
AoN® (Is-Two)
Avinent® (IC Ø3.5)
Axelmed® (Paradigma)
BioHorizon® Ø3.5
BTK® (INT IR)
Cortex® (CLASSICS)
Cortex® (Internal Ex Dinamix)
Cortex® (Saturn)
Dentaltech® (Implogic)
Dering® (Exacort)
Ditron® (Mci-Ultimate)
Edgar® (Max-Logic)
Hi-Tec Implant® (Plus-Spark)
Implant Direct® (Legacy)
Intralock® (IntraHex)

Ø3.5

Ires® (Shape Oneb)
Ires® (TN)
Ires® (Imax Nhsi)
Ires® (Volution)
Isomed® (E-lintero)
JDCare® (JD Evolution)
JDCare® (JD Evolution Plus+)
Kristal® (BioImplant)
Kristal® (Core V2)
Kristal® (K-Core V2)
Krugg® (Platinum/Gold)
Leader Medica® (Mito)
Medline® (V Core/Classic / Short)
Mirell®
MIS® (Seven-M4)

Ø3.5

Noris Medical® (Tuff)
Noris Medical® (TUFF PRO)
Noris Medical® (TUFF TT)
Noris Medical® (ONYX)
Noris Medical® (Cortical Ptericore)
NSI® (LIGHT)
Proclinique® (Connection Internal)
RESITA® (IC / IA / IK)
Ritter®
SouthernImplant® (Internal Ex)
TAG® (Axis-Massif)
Trinon® (Q Implant Ø3.5 QZA)

Ø4.5

Avinent® (IC Ø4.1)
Bio Horizon®
Dentaltech® (Implogic)
Hi-Tec Implant® (Plus-Spark)
Implant Direct® (Legacy)
MIS® (Seven M4)
Triton® (Q Implant Ø4.5 QZA)

Ø5.7

Bio Horizon® Ø 5.7

Soluzioni Overdenture

Pag. 143



Strumentario

Pag. 159

I•SCAN

INTRAORAL **S**CAN **A**BUTMENT

I.Scan sono gli scan abutment intraorali prodotti da Anteea®. Sono dispositivi fondamentali per effettuare un adeguato processo di scansione, sia per uso intraorale che per uso su modello dentale. Posizionati su analogo o su un impianto consentono, durante il processo di acquisizione, di rilevare e registrare con altissima precisione il corretto posizionamento dell'impianto all'interno del progetto implanto-protetico.

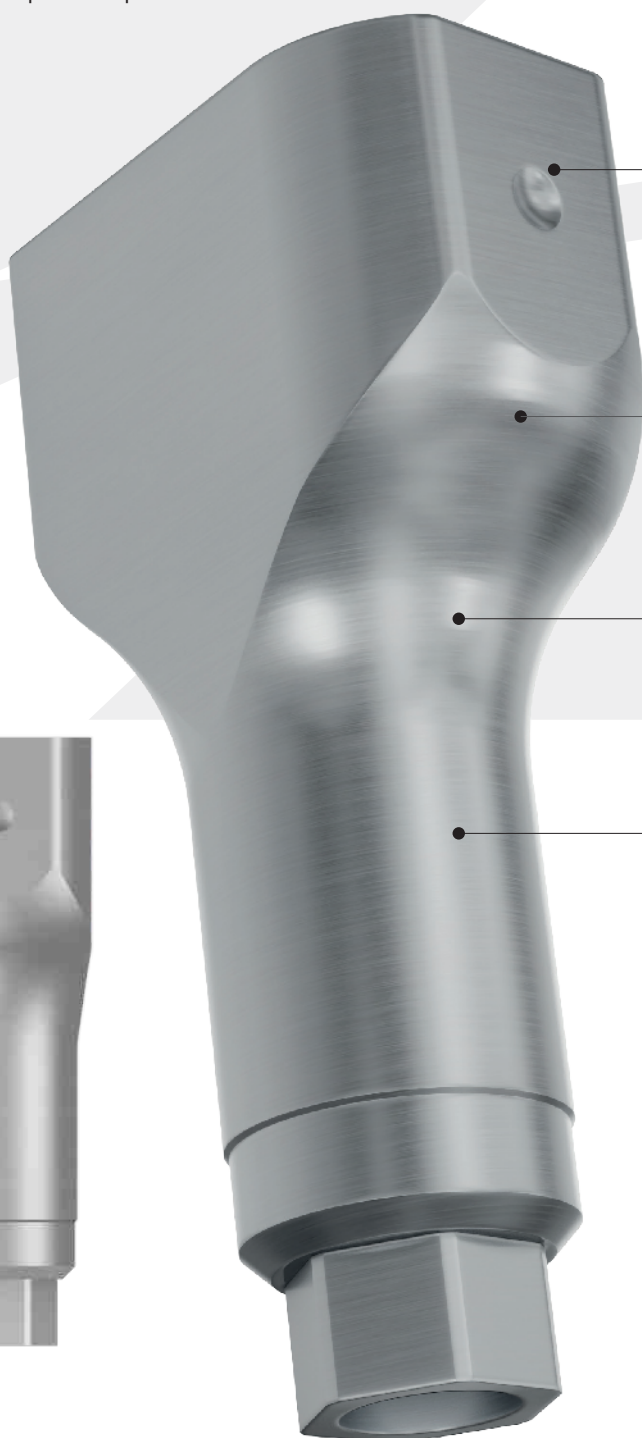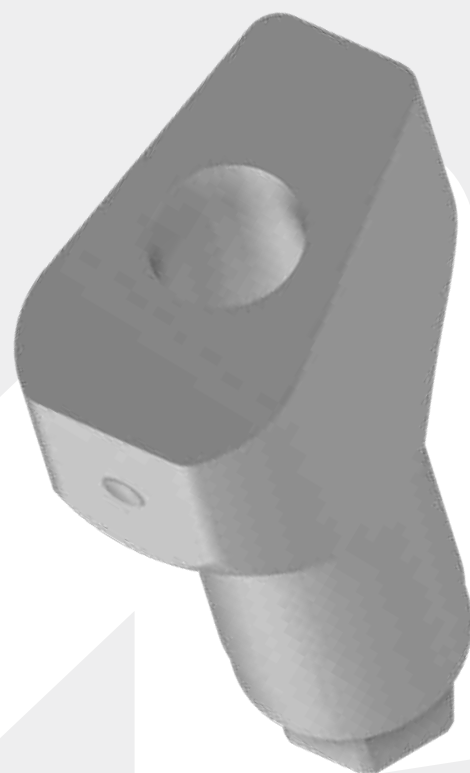

MARK DI POSIZIONAMENTO

Il mark di posizionamento è un riferimento presente sulla testa. Il mark aiuta l'operatore a posizionare l'I.Scan e a eseguire corrette scansioni intraorali evitando di storsioni.

DESIGN

La forma rastremata permette un agevole gestione degli spazi interprossimali stretti e facilitando posizionamento nel cavo orale.

MATERIALI

Per ottenere la massima precisione e lasciare inalterata la loro performance. I nuovi Intraoral Scan-Abutment I.Scan sono realizzati in lega di Titanio Gr. 4

SUPERFICIE

La superficie di I.Scan sabbiata grigio opaca consente una scansione accurata sia in studio che in laboratorio evitando l'uso di opacizzatori.

LIBRERIE

Le librerie implantari IScan sono disponibili per tutte le piattaforme prodotte da Anteea e costantemente aggiornate con i più performanti software disponibili in commercio:

3shape
exocad

egsolutions
dental wings
digital dentistry solutions


DUALSistem

MONCONE PERSONALIZZABILE PER TECNICA DA INCOLLAGGIO

I monconi personalizzabili per per tecnica da incollaggio ANTEEA DualSistem® nascono per dare a chi opera nel settore implantare (Odontoiatra - Odontotecnico - Centri Fresaggio) un sistema completo per la realizzazione di protesi dentali su impianti, con le interfacce di bonding della tecnica di modellazione CAD, manualmente o con la tecnica di fusione a cera persa.

Il prodotto viene venduto con vite e calcinabile, che permette di avere sempre gli spessori programmati per l'incollaggio sia della dima generata dalla scansione del converter, sia con la tecnica della fusione a cera persa. Il sistema DualSistem® consentirà la realizzazione di restauri in Titanio, Zirconia, Laser-Melting (SLM), Ceramica Pressata e tutti i materiali ceramici di nuova generazione.

Il sistema offre un'alternativa economica per corone e ponti in lega a base di metalli nobili, senza rinunciare allo standard di precisione della connessione e alla compatibilità della casa implantare scelta dal cliente.

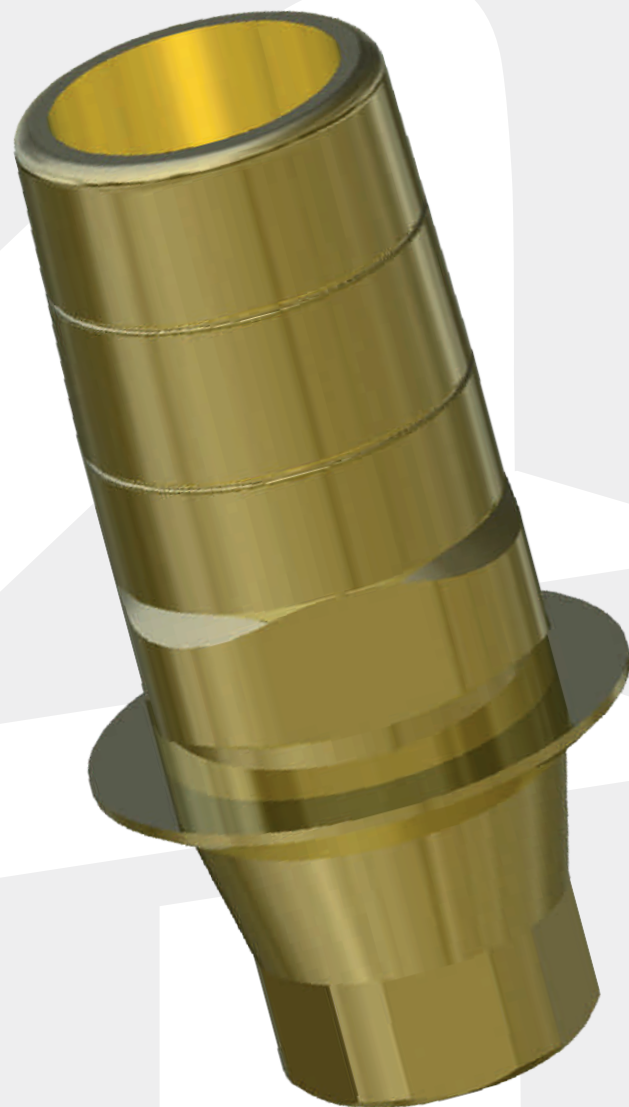

VANTAGGI

- La cannula calcinabile in dotazione consente una semplice modellazione del prodotto protesico
- Varie altezze transmucose disponibili a catalogo
- Struttura modellabile e personalizzabile grazie ai "Cut Marks" gestiti dal software (Fig.1)
- Elevato standard di precisione e compatibilità della connessione dei sistemi Anteea.
- Configurazione personalizzabile su casi protesici che prevedono l'inclinazione della vite attraverso il canale. (Fig. 2-3)

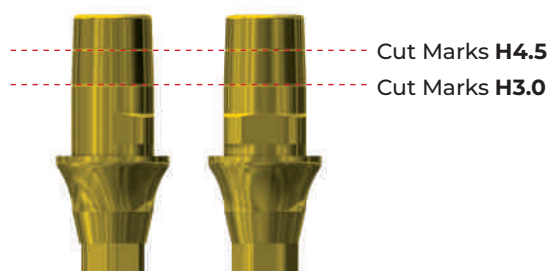


FIG. 1

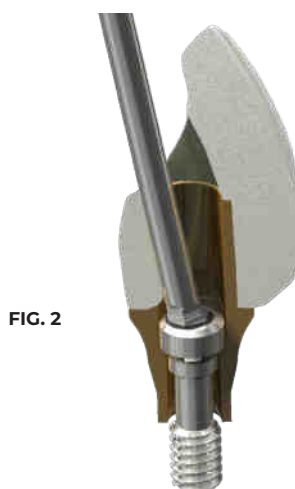


FIG. 2

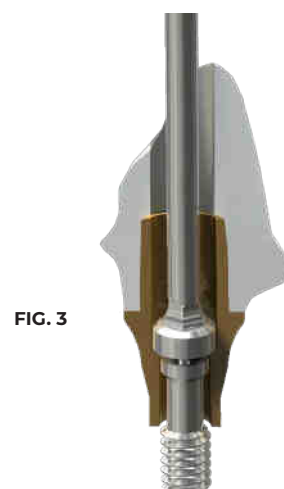


FIG. 3

♥ DUALSistem ISTRUZIONI PER IL TAGLIO

Taglio Lineare

VANTAGGI


Il tecnico può modellare il moncone Dual Sistem® seguendo le linee "Cut Marks".

Anteea Srl fornisce un supporto completo per casi protesici che prevedono l'inclinazione del canale della vite, in dettaglio:

- Vite e cacciavite dedicati
- Librerie di impianti dedicate



I Dual Sistem® vengono forniti ad un'altezza di 6 mm con tacche per il taglio "Cut Marks"

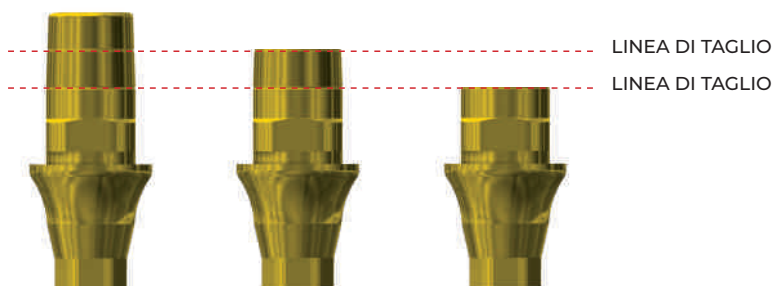

Dual Sistem® tagliato con misure Librerie Anteea Srl


Taglio Personalizzato

VANTAGGI

Il tecnico può modellare liberamente il moncone Dual Sistem® seguendo sia le linee "Cut Marks" che fresando e adattando il manufatto al percorso inclinato.

Anteea Srl fornisce un supporto completo per casi protesici che comportano l'inclinazione del canale della vite, in dettaglio:

- Vite dedicata (D.I.S. Dinamic Inclined Screws) e cacciavite specifico dedicato
- Librerie di impianti dedicate

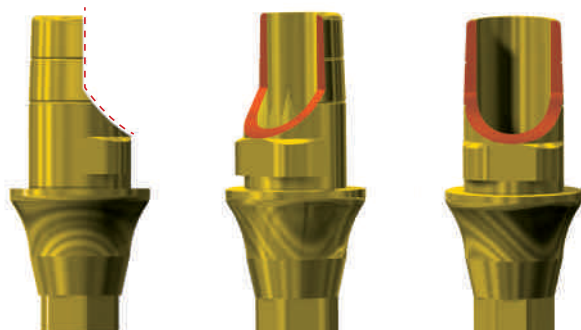

Il Dual Sistem® può essere tagliato a mano libera dal tecnico, seguendo la forma del prodotto



Viti in dotazione **NEW!**

VANTAGGI

I monconi Dual Sistem® sono forniti con vite "standard" in dotazione. A richiesta del cliente, la vite "standard" può essere sostituita con vite D.I.S. Torx o Esagono.



I Dual Sistem® sono disponibili per modellazione Cad-Cam ed è compatibile con librerie:

3shape
exocad

egsolutions
dental wings
digital dentistry solutions

NON ROTANTI

VANTAGGI

- Questi monconi sono dotati di un blocco anti-rotazione sulla superficie esterna in grado di garantire alla corona o abutment una volta cementata di non ruotare.
- Sul lato esterno sono presenti delle linee circolari che determinano l'altezza massima dove la base può essere tagliata prima di incontrare la vite primaria.
- Spalla a 90° come ottima preparazione per accogliere il manufatto da incollare.
- Profilo d'emergenza personalizzabile del manufatto per accogliere viti angolate D.I.S.
- Alto standard di precisione e compatibilità su tutte le connessioni compatibili.
- Cappetta calcinabile calibrata inclusa che consente una modellazione semplice ed efficace.


RISPARMIO DI TEMPO

- Modellazione individuale, diminuzione del tempo di procedura nell'adattamento degli abutment pre-confezionati.
- Costruzione virtuale e fresatura di precisione con sistema cad-cam.
- Controllo diretto e personalizzato nel proprio laboratorio, la forma e l'altezza dell'abutment.

IMPIEGO CLINICO

- Per la produzione di abutment personalizzati e di corone avvitate occlusamente incollati a basi in titanio, nella regione anteriore e posteriore dell'arcata superiore e inferiore.
- **Per corone singole o abutment personalizzati.**
- **Con blocco antirotazione.**
- **Superficie esterna parallela per la massima stabilità.**

DIMENSIONI

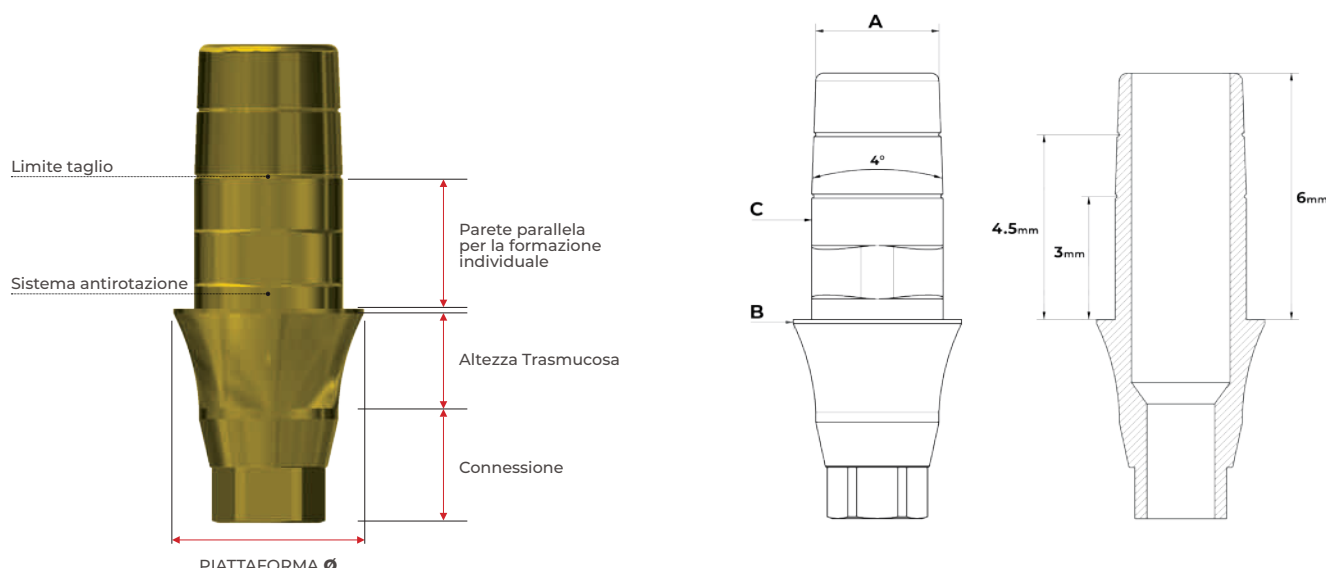

Impianti da **2.7-3.3**

Piattaforma **S**

Impianti da **3.4-4.0**

Piattaforma **N**

Impianti da **4.1-4.9**

Piattaforma **R**

Impianti da **5.0-6.0**

Piattaforma **W**

A	3.0mm	3.0mm	3.3mm	3.8mm
B	3.6mm	4.1mm	4.8mm	6.0mm
C	3.2mm	3.2mm	3.5mm	4.0mm

Tutte le misure sono espresse in mm

ROTANTI

VANTAGGI

- La forma esterna conica facilita l'inserimento e la passivazione di ponti o più elementi.
- Queste basi sono senza blocco anti-rotazione sulla superficie esterna quindi sono ideali per la realizzazione di ponti o strutture da più elementi.
- Sul lato esterno sono presenti linee circolari che determinano l'altezza massima dove la base può essere sbassata prima di incontrare la vite primaria.
- Alto standard di precisione e compatibilità alla connessione DualSistem®.
- Cappetta calcinabile calibrata inclusa per le basi in titanio che consente una modellazione semplice ed efficace.


RISPARMIO DI TEMPO

- Modellazione individuale, diminuzione del tempo di procedura nell'adattamento degli abutment preconfezionati.
- Costruzione virtuale e fresatura di precisione con sistema cad-cam.
- Controllo diretto e personalizzato nel proprio laboratorio, la forma e l'altezza del ponte o struttura.

IMPIEGO CLINICO

- Per la produzione di ponti avvitati occlusalmente e di strutture avvitate come only block incollati alle basi in titanio.
- **Per ponti.**
- **Senza blocco antirotazione per la massima passivazione.**
- **Superficie esterna conica per facilitare l'inserimento.**

DIMENSIONI

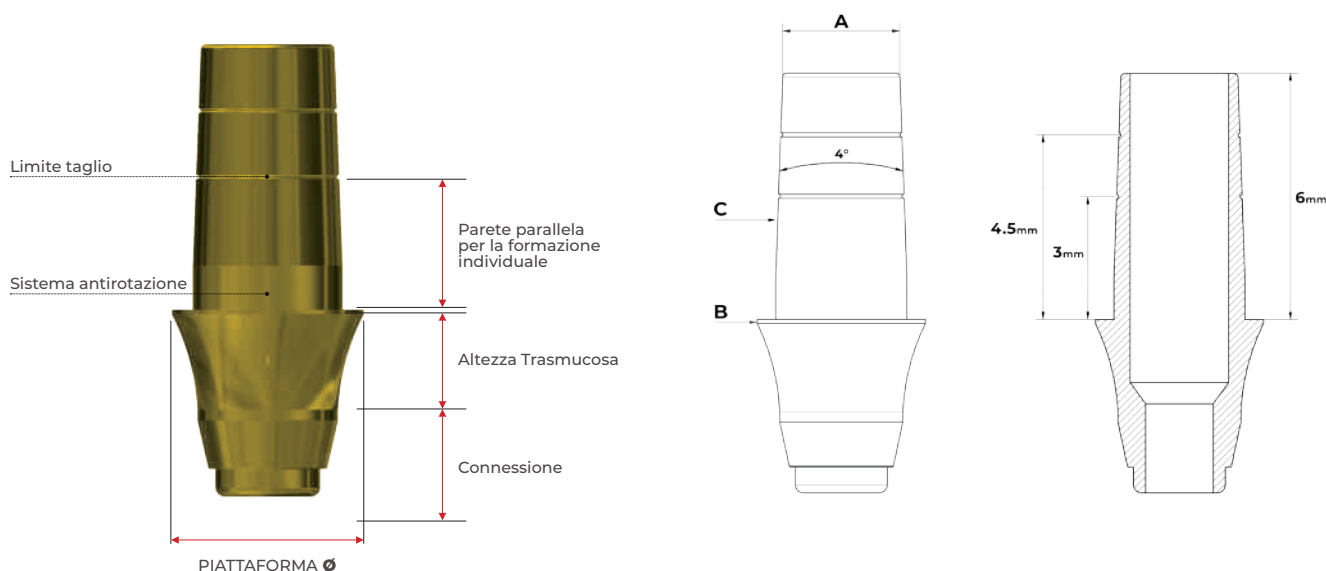

Impianti da **2.7-3.3**

Piattaforma **S**

Impianti da **3.4-4.0**

Piattaforma **N**

Impianti da **4.1-4.9**

Piattaforma **R**

Impianti da **5.0-6.0**

Piattaforma **W**

A	2.76mm	2.86mm	3.16mm	3.66mm
B	3.5mm	4.1mm	4.8mm	6.0mm
C	3.1mm	3.2mm	3.5mm	4.0mm

COMBY CHROME

LEGA DENTALE PER CERAMICA A BASE DI CROMO COBALTO. ASSOLUTAMENTE PRIVA DI NICHEL E BERILLIO


Lega per ceramizzazione di protesi fisse in metallo ceramica ideale per ponti estesi.
Adatta all'utilizzo di ogni tipo di ceramica dentale.

Il sistema Comby Chrome di Anteea® è una soluzione universale di facile processo per i restauri supportati da impianti.


Si compone di una base in cromo cobalto (base in lega senza nichel e berillio), un manicotto di modellazione plastica e una vite di fissaggio.

Questo sistema offre una soluzione conveniente per monconi a base di leghe auree con una straordinaria flessibilità sia per il tecnico che per il modellatore grazie al suo profilo di emergenza gengivale adattabile secondo le esigenze individuali.

Sia per progetti di protesi cementata che per ricostruzioni avvitate Comby Chrome® consente restauri protesici, anche in casi in cui non è possibile utilizzare monconi standard fresabili in casi dove è troppo profondo il tragitto tras mucoso e nel caso di forti disparallelismi.

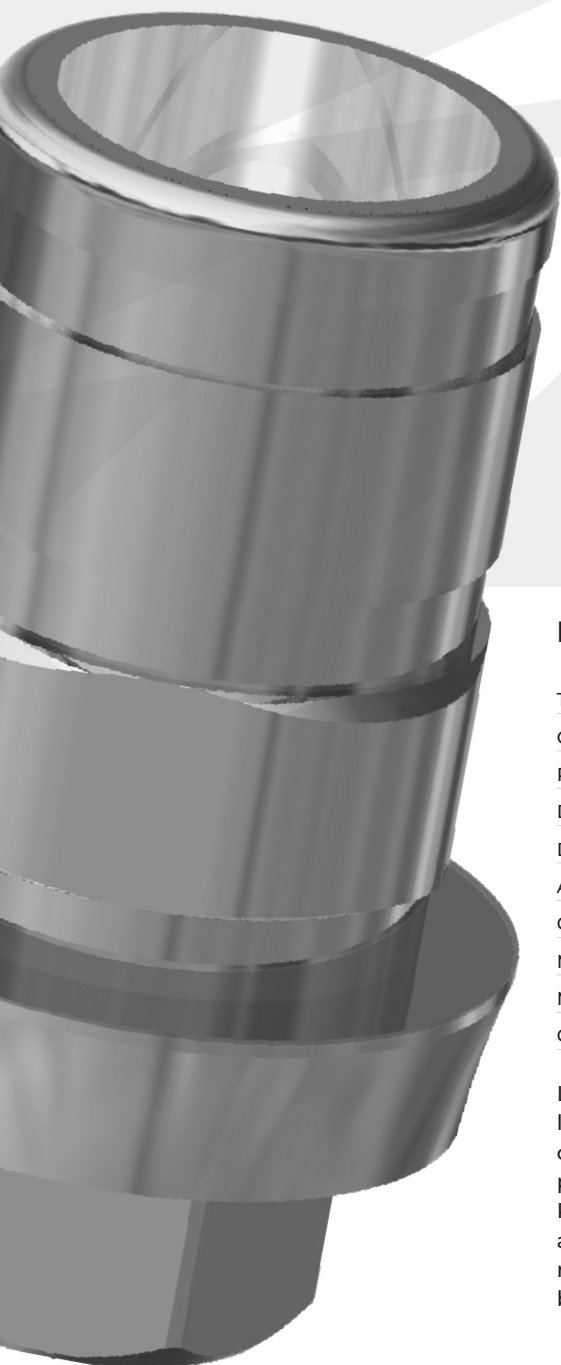

MAGNUM SOLARE

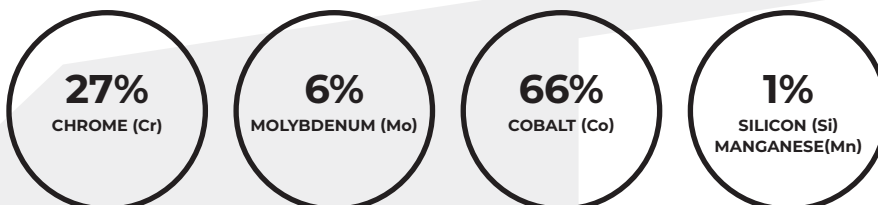

CE 0123 ACCORDING TO: ISO 9693-1, ISO 22674

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Temperatura di solidus-liquidus	1307 ÷ 1417 °C
Coefficiente di espansione termica	(25 ÷ 500 °C) 14,3 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹ – (25 ÷ 600 °C) 14,5 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Punto di fusione	1470 °C
Densità	8,4 g/cmc
Durezza Vickers	255 HV10
Allungamento percentuale a rottura	11 %
Carico unitario di snervamento	(Rp0.2) 395 MPa
Modulo di elasticità	233 GPa
Massima temperatura di cottura	980°C
Colore	Bianco

La fusione con leghe vili, meno predicibile rispetto a quella con leghe nobili, aumenta la difficoltà di mantenere la precisione a livello della connessione protesica perché oltre ai fattori di intimo contatto tra le leghe e resistenza meccanica subentrano anche problematiche di fenomeni corrosivi, ben noti agli odontotecnici.

Poiché queste leghe durante il loro riscaldamento si ossidano, è necessario avere ulteriori accorgimenti durante la preparazione dei modellati, durante la procedura di messa in rivestimento e fusione per evitare complicanze non solo di tipo meccanico, ma anche biologico.

L'inserimento del cilindro in resina sul moncone Comby Chrome facilita la modellazione del tragitto della vite protesica.

Posizionare il moncone nel modello master assicurandosi che l'abutment sia correttamente ingaggiato prima di serrare la vite di fissaggio.

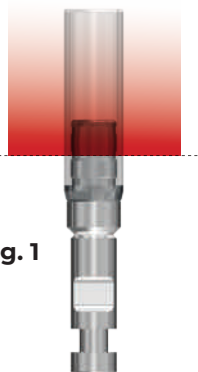


Fig. 1

AREA TAGLIO

A seconda delle circostanze individuali, la cannula di modellazione plastica può essere tagliato in conformità con i requisiti individuali di modellazione (Fig. 1).

Ricostruire la forma ottimale della battuta con la cera da modellazione usuale. Riempire con cura la parte della zona antirotazionale sopra la spalla del pilastro con la cera di modellazione. Assicurarsi che la zona antirotazionale sopra la spalla sia completamente rivestita con uno strato uniforme di cera per modellare (vedi dettaglio 2).

Addensare la cera per evitare bolle sulla zona di connessione metallo. La modellazione sul pilastro deve essere sufficientemente spessa (uno strato di cera di almeno 0,7 mm). Durante la modellazione, utilizzare sempre una mascherina gengivale per garantire che il profilo di emergenza della corona sia ottimamente sagomato (Fig. 2).

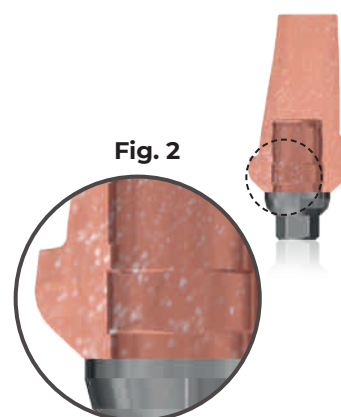


Fig. 2

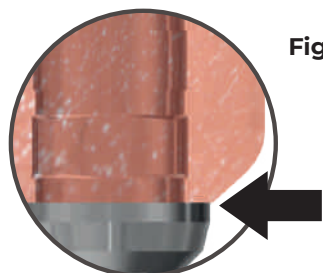


Fig. 3

Assicurarsi che non vi sia cera sul margine del bordo circolare della base di battuta per evitare la fuoriuscita della lega di sovrافusione (Fig. 3) Rivestire il componente modellato nel modo consueto con materiali di alta qualità di rivestimento.

AVVERTENZE IMPORTANTI

Effettuare la smuffolatura delicatamente con gli ultrasuoni, getto d'acqua, decapaggio o pennello in fibra di vetro.

Per rimuovere lo strato di ossido usare perle di uso di vetro (50 micron / 2 ~ 4 bar).

Non sabbiare la connessione del moncone, al fine di evitare danneggiamenti all'abutment.

Utilizzare una nuova vite di riscontro per l'inserimento definitivo della componente secondaria. Stringere la vite primaria con l'aiuto di una chiave dinamometrica calibrata rispettando le raccomandazioni concernenti la coppia di serraggio.

Utilizzare il cacciavite originale fornito.

CONTRAINDICAZIONI

è consigliato non inclinare l'abutment oltre 30 gradi, su impianti con diametro inferiore a 4 mm e destinati alla regione posteriore.

Viti in dotazione **NEW!**

VANTAGGI

I Tbase Comby Chrome® sono forniti con vite "standard" in dotazione. A richiesta del cliente, la vite "standard" può essere sostituita con vite D.I.S. Torx o Esagono.



I TBase Comby Chrome® è disponibile per modellazione Cad-Cam ed è compatibile con librerie:

3shape

exocad

egsolutions

dental wings
digital dentistry solutions

A.D.M.

ANALOG FOR DIGITAL MODEL

Caratteristiche:

Costituiti da due pezzi riposizionabili con estrema precisione per ricostruzioni con tecnica Cad-Cam.

La Sleeve A.D.M. ausiliare per progettazione analogica: regola e supporta con precisione il riposizionamento della mascherina gengivale rimovibile.

Vantaggi/Applicazioni:

- Estrema precisione e duttilità in fase Cad-Cam;
- Estrema precisione e duttilità in fase analogica.



CONNESSIONE

Sono disponibili per tutte le piattaforme implantari prodotte da Anteea: estrema precisione e risultati senza alterazioni.

DESIGN

Il disegno cilindrico con due scanalature nella parte inferiore garantiscono un'elevata accuratezza di riposizionamento sul modello ottenuto in stampa 3D. Con l'ausilio dell'apposito strumento d'inserimento viene facilitata e preservata l'accuratezza nella sede progettata.

SLEEVE IN P.O.M.

Disponibile a richiesta per l'utilizzo nei modelli in gesso convenzionali.

BOCCOLA FILETTATA

Questa boccola filettata inferiore consente all'analogo di stabilizzarsi nella posizione adeguata con un'elevata precisione. Anteea consiglia il suo utilizzo in specifici casi per incollare l'analogo al modello 3D.

LIBRERIE

Le librerie implantari ADM sono disponibili per tutte le piattaforme prodotte da Anteea e costantemente aggiornate con i più performanti software disponibili in commercio:

3shape
exocad

egsolutions
dental wings
digital dentistry solutions



D.I.S.

DINAMIC INCLINATED SCREW

Caratteristiche:



Viti per fori inclinati fino a 25°

Questa speciale vite permette in fase di laboratorio di progettare dispositivi per elementi singoli o multipli (Barre) avvitati con fori disassati fino a 25°

Questa particolare funzione presente su innumerevoli Software Cad permette una migliore estetica e una facilità di lavorazione su tutta l'arcata dentale.

Le caratteristiche materiali del cacciavite atto all'uso per queste viti, può inclinarsi fino ai 25°. È progettato per fratturarsi, in caso di sovraccarico torque da parte dell'operatore, al fine di impedire il danneggiarsi della vite stessa.

0° 25°

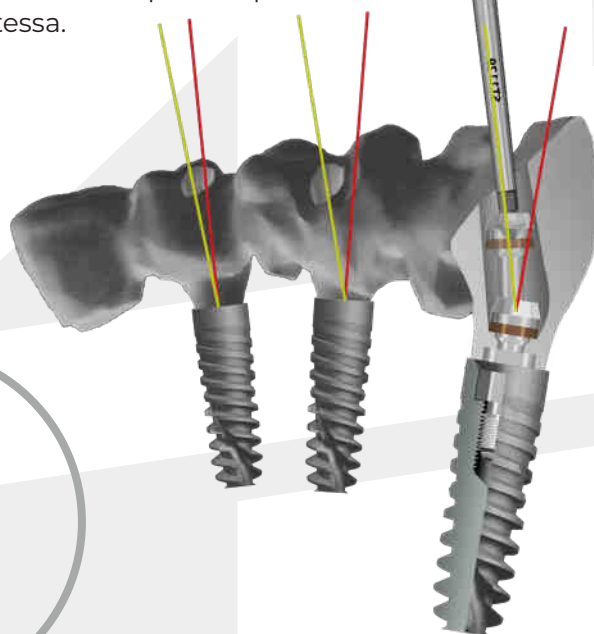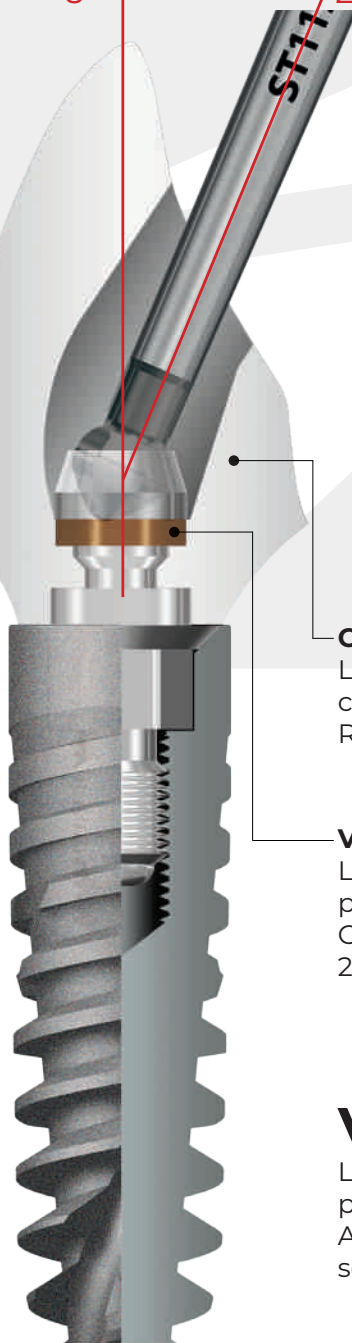

Corona anatomica

Le corone possono essere realizzate con tecnica CAD-CAM (zirconia, ceramiche monolitiche, etc.) mediante tecnica per iniezione (PEEK o Resine rinforzate) o per fusione, nel caso di strutture in titanio o Cr.Co.

Vite D.I.S. - Specifiche tecniche

Le viti D.I.S. sono progettate e indicate per realizzare sovrastrutture protesiche nel materiale scelto dall'operatore.

Grazie al loro cacciavite coordinato si possono risolvere angolazioni fino a 25°.


Viti in dotazione

Le nuove viti protesiche Anteea si differenziano per uso e design.

A richiesta del cliente, la vite "standard" può essere sostituita con vite D.I.S. Torx o Esagono.



COMPONENTISTICA IMPLANTARE

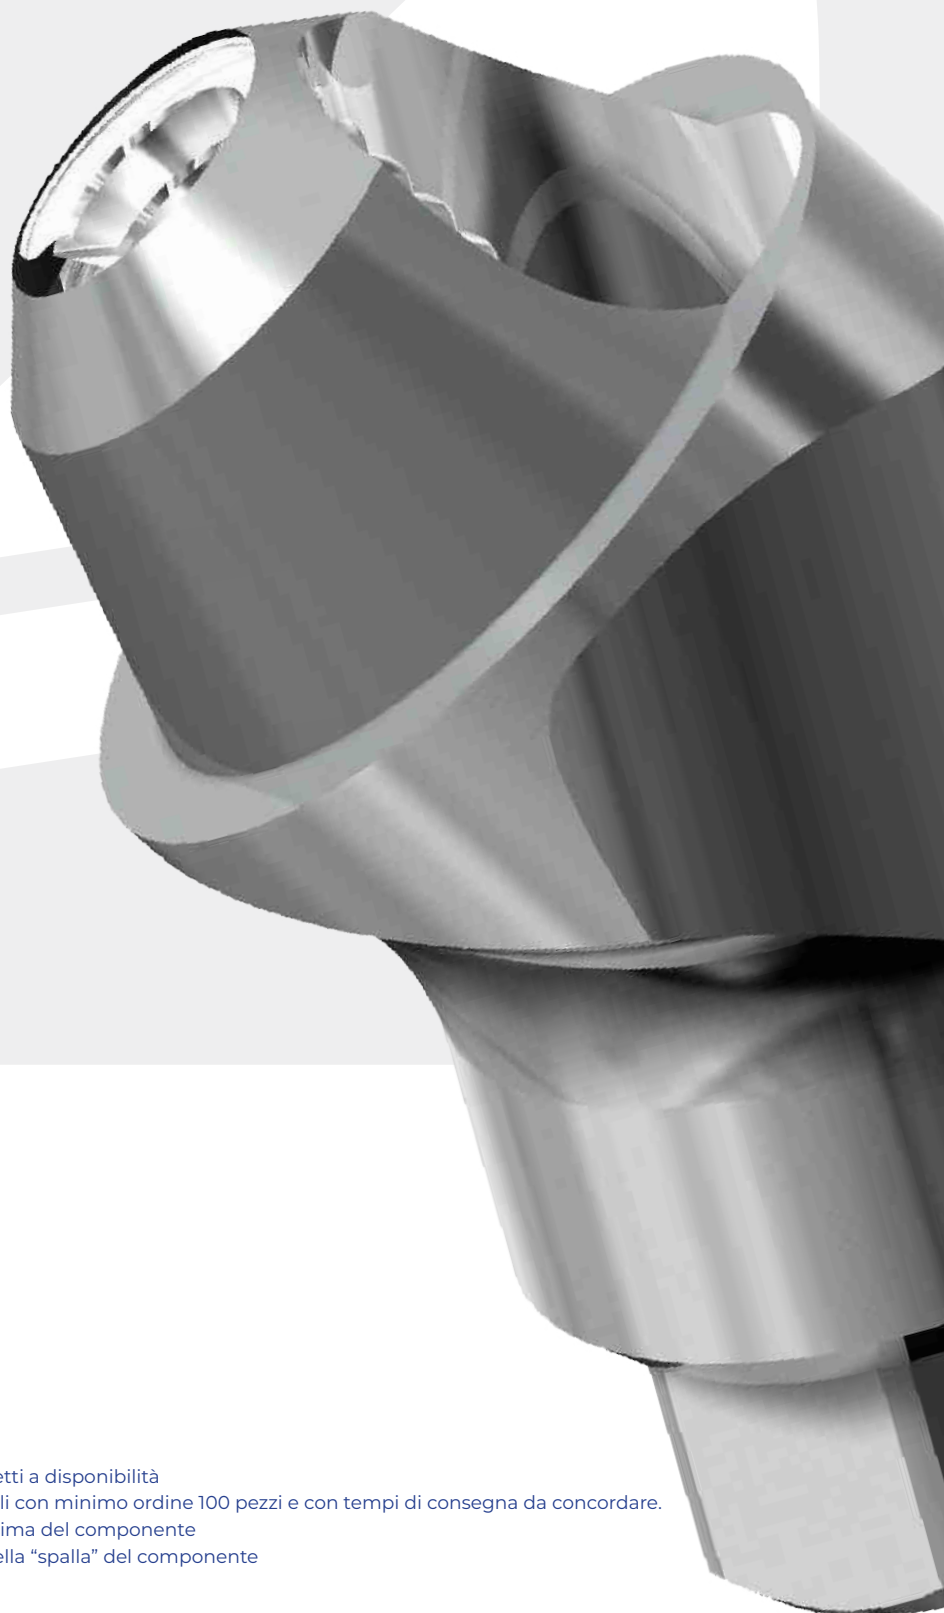

LEGENDA

(E) Ad esaurimento - Articoli presenti in magazzino ma soggetti a disponibilità

(R) Su richiesta - Articoli non presenti a magazzino e ordinabili con minimo ordine 100 pezzi e con tempi di consegna da concordare.

P.E. Profilo di emergenza - Valore che indica l'ampiezza massima del componente

H Altezza tras mucosa - Valore che indica l'altezza massima della "spalla" del componente


DUAL SISTEM

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

In fase di ordine postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete **vite D.I.S. testa esagonale** 

In fase di ordine postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete **vite D.I.S. testa torx** 

In fase di ordine lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete **vite "standard"**

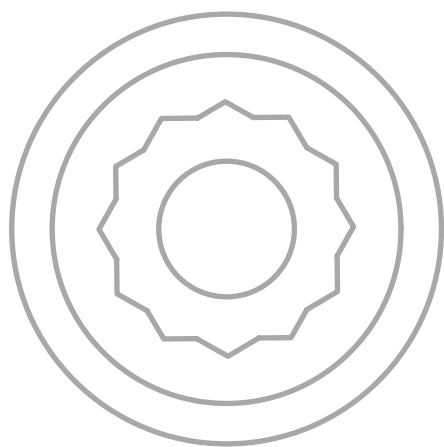

ASerie





ANALOGO

Acciaio




TRANSFER SHORT H 11 mm

TRANSFER LONG H 15 mm

TRANSFER ROTANTE H 14 mm

Titanio grado 5



MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm

MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 3.0 mm

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 3.0 mm

Titanio grado 5



MONCONE CALCINABILE ROTANTE

MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

Polimetilmetacrilato



MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 4.0

MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 4.5

MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 5.5

MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 4.5

MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 5.5

Titanio grado 5



MONCONE FRESABILE DRITTO P.E. 3.5

MONCONE FRESABILE DRITTO P.E. 4.5

MONCONE FRESABILE DRITTO P.E. 5.5

MONCONE FRESABILE DRITTO P.E. 6.5

Titanio grado 5



MONCONE 20° H 2.5 mm - P.E. 4.5

MONCONE 20° H 2.5 mm - P.E. 5.5

MONCONE 20° H 3.5 mm - P.E. 4.5

MONCONE 20° H 3.5 mm - P.E. 5.5

Titanio grado 5



VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 3.5

VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 4.5

VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 5.5

VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 6.5

VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 3.5

VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 4.5

VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 5.5

VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 6.5

VITE GUARIGIONE H 6.0 mm - P.E. 3.5

VITE GUARIGIONE H 6.0 mm - P.E. 4.5

VITE GUARIGIONE H 6.0 mm - P.E. 5.5

VITE GUARIGIONE H 6.0 mm - P.E. 6.5

Titanio grado 5



VITE PROTESICA

VITE TRANSFER SHORT

VITE TRANSFER LONG

MICROVITE D.I.S. e (Esagono)

MICROVITE D.I.S. t (Torx)

Titanio grado 5

	IMPIANTI Ø3.0	IMPIANTI Ø3.5/4.0	IMPIANTI Ø4.5/5.0
	PIATTAFORMA YELLOW	PIATTAFORMA AQUAMARINE	PIATTAFORMA LILLAC
ANALOGO	AN1176	AN1373	AN1374
Acciaio			
TRANSFER SHORT H 11 mm	-	AN1030 (E)	AN1626 (E)
TRANSFER LONG H 15 mm	AN1177	AN1031	AN1214
TRANSFER ROTANTE H 14 mm	-	AN1010 (E)	-
Titanio grado 5			
MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN1181	AN1049	AN1047
MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 3.0 mm	-	AN1040	AN1048
MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm	AN1187	AN1029	AN1017
MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 3.0 mm	-	AN1067	AN1073
Titanio grado 5			
MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN2269	AN2270	AN2271
MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	AN1188	AN1211	AN1532
Polimetilmetacrilato			
MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 4.0	AN1121	-	-
MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 4.5	-	AN1263	-
MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 5.5	-	AN1443 (E)	AN1265
MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 4.5	-	AN1264	-
MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 5.5	-	AN1444 (E)	AN1266
Titanio grado 5			
MONCONE FRESABILE DRITTO P.E. 3.5	AN1196	-	-
MONCONE FRESABILE DRITTO P.E. 4.5	-	AN1618	-
MONCONE FRESABILE DRITTO P.E. 5.5	-	AN1625	AN1619
MONCONE FRESABILE DRITTO P.E. 6.5	-	AN2333	AN2334
Titanio grado 5			
MONCONE 20° H 2.5 mm - P.E. 4.5	-	AN1527	-
MONCONE 20° H 2.5 mm - P.E. 5.5	-	AN1528	AN1529
MONCONE 20° H 3.5 mm - P.E. 4.5	-	AN1320	-
MONCONE 20° H 3.5 mm - P.E. 5.5	-	AN1321	AN1298
Titanio grado 5			
VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 3.5	AN1197	-	-
VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 4.5	-	AN1032	-
VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 5.5	-	AN1035	AN1018
VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 6.5	-	-	AN1021
VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 3.5	AN1198	-	-
VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 4.5	-	AN1033	-
VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 5.5	-	AN1036	AN1019
VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 6.5	-	-	AN1022
VITE GUARIGIONE H 6.0 mm - P.E. 3.5	AN1199	-	-
VITE GUARIGIONE H 6.0 mm - P.E. 4.5	-	AN1034	-
VITE GUARIGIONE H 6.0 mm - P.E. 5.5	-	AN1037	AN1020
VITE GUARIGIONE H 6.0 mm - P.E. 6.5	-	-	AN1023
Titanio grado 5			
VITE PROTESICA	AN1200	AN1041	AN1024
VITE TRANSFER SHORT	AN1201	AN1043	AN1627
VITE TRANSFER LONG	-	AN1042	AN2004
MICROVITE D.I.S. e (Esagono)	AN3755	AN3212	AN3213
MICROVITE D.I.S. t (Torx)	AN2953	AN2961	AN2962
Titanio grado 5			




SIRONA CEREC I-BASE H 1.0mm
SIRONA CEREC I-BASE H 2.0mm
Titanio grado 5



BASE "FOR PRESS" ROTANTE
BASE "FOR PRESS" NON ROTANTE
Titanio grado 5



COMBY CHROME ROTANTE
COMBY CHROME NON ROTANTE
Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato



DUAL SISTEM ROTANTE H 0,75 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 1,5 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 2,5 mm
CALCINABILE ROTANTE
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.75 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.5 mm
CALCINABILE NON ROTANTE
Titanio grado 5
ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE
SCANBODY NON ROTANTE
Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN
Titanio grado 4



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm
Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 144**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA H 1.0 mm
MONCONE SFERA H 2.0 mm
MONCONE SFERA H 3.0 mm
MONCONE SFERA H 4.0 mm
MONCONE SFERA H 5.0 mm
MONCONE SFERA H 6.0 mm
Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm
Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

	Ø3.0	Ø3.5/4.0	Ø4.5/5.0	UNI	M.U.A.
	N. cm 15	N. cm 20	N. cm 32	N. cm 15	N. cm 15
	M 1.4	M 1.6	M 2.0	M 1.4	M 1.4
	Es 1.27 mm	Es 1.27 mm	Es 1.27 mm	Es 1.27 mm	Es 1.27 mm

	IMPIANTI Ø3.0 PIATTAFORMA YELLOW	IMPIANTI Ø3.5/4.0 PIATTAFORMA AQUAMARINE	IMPIANTI Ø4.5/5.0 PIATTAFORMA LILLAC
SIRONA CEREC I-BASE H 1.0mm	-	AN3198	AN3202
SIRONA CEREC I-BASE H 2.0mm	-	AN3201	AN3203
BASE "FOR PRESS" ROTANTE	-	AN2582 (E)	-
BASE "FOR PRESS" NON ROTANTE	-	-	-
COMBY CHROME ROTANTE	AN1190	AN1191	AN1195
COMBY CHROME NON ROTANTE	AN1189	AN1256	AN1262
DUAL SISTEM ROTANTE H 0,75 mm	AN1963	AN1960	AN1961
DUAL SISTEM ROTANTE H 1,5 mm	-	AN2573	AN2577
DUAL SISTEM ROTANTE H 2,5 mm	-	AN2575	AN2579
CALCINABILE ROTANTE	AN5526	AN3101	AN3102
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.75 mm	AN1962	AN1027	AN1016
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm	-	AN2574	AN2578
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.5 mm	-	AN2576	AN2580
CALCINABILE NON ROTANTE	AN5526	AN3098	AN3099
SCANBODY ROTANTE	SCAN S-R	SCAN N-R	SCAN R-R
SCANBODY NON ROTANTE	SCAN S	SCAN N	SCAN R
INTRAORAL SCAN	SCAN1100	SCAN1018	SCAN1019
MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm	-	AN2583	AN2588
MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm	-	AN2584	AN2589
MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm	-	AN2585	AN2590
MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm	-	AN2586	AN2591
MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm	-	AN2587	AN2592
MONCONE SFERA H 1.0 mm	AN3831 (R)	AN3818 (R)	AN3844 (R)
MONCONE SFERA H 2.0 mm	AN3832 (R)	AN3819 (R)	AN3845 (R)
MONCONE SFERA H 3.0 mm	AN3833 (R)	AN3820 (R)	AN3846 (R)
MONCONE SFERA H 4.0 mm	AN3834 (R)	AN3821 (R)	AN3847 (R)
MONCONE SFERA H 5.0 mm	AN3835 (R)	AN3822 (R)	AN3848 (R)
MONCONE SFERA H 6.0 mm	AN3836 (R)	AN3823 (R)	AN3849 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm	AN3837 (R)	AN3811 (R)	AN3824 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm	AN3838 (R)	AN3812 (R)	AN3825 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm	AN3839 (R)	AN3813 (R)	AN3826 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm	AN3840 (R)	AN3814 (R)	AN3827 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm	AN3841 (R)	AN3815 (R)	AN3828 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm	AN3842 (R)	AN3816 (R)	AN3829 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm	AN3843 (R)	AN3817 (R)	AN3830 (R)

Chiavi inserimento M.U.A.



M.U.A. DRIVER for RATCHET LUNGO ST1106

M.U.A. DRIVER for RATCHET CORTO ST1107



M.U.A. DRIVER ST1001

SERRAGGIO
Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

COMPONENTISTICA PER PROTESI AVVITATA



UNI 20° H 0.5 mm


UNI 20° H 1.0 mm

UNI 20° H 2.0 mm

UNI 20° H 3.0 mm

UNI 20° H 4.0 mm

Titanio grado 5



UNI 45° H 0.5 mm


UNI 45° H 1.0 mm

UNI 45° H 2.0 mm

UNI 45° H 3.0 mm

UNI 45° H 4.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm

M.U.A. DRITTO H 2.0 mm

M.U.A. DRITTO H 3.0 mm

M.U.A. DRITTO H 4.0 mm

M.U.A. DRITTO H 5.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.5 mm

M.U.A. 17° H 3.5 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.5 mm

M.U.A. 30° H 4.5 mm

Titanio grado 5



VITE M.U.A.

Titanio grado 5



A. ANALOGO M.U.A.

AN1604

B. ANALOGO UNI 20°

AN1248

C. ANALOGO UNI 45°

AN1026

Acciaio



A. MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN1371

B. MONCONE PROVVISORIO UNI 20° AN1123

C. MONCONE PROVVISORIO UNI 45° AN1124

Titanio grado 5



MONCONE SALDATURA M.U.A. AN2774

Titanio grado 5



ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275

Acciaio



SCANBODY M.U.A. SCAN-M-A

SCANBODY UNI 20° SCAN-U-20

SCANBODY UNI 45° SCAN-U-45

Alluminio Ergal Mediale



MICROVITE M.U.A. AN1274

TRANSFER M.U.A. AN1423

MICROVITE UNI AN1244

TRANSFER UNI AN1723

MICROVITE D.I.S. e (Esagono) AN3290

MICROVITE D.I.S. t (Torx) AN3894

Titanio grado 5



VITE PROTEZIONE M.U.A. AN1258

VITE PROTEZIONE UNI 20° AN1278

VITE PROTEZIONE UNI 45° AN1277

Titanio grado 5

IMPIANTI
Ø3.0
PIATTAFORMA
YELLOW

IMPIANTI
Ø3.5/4.0
PIATTAFORMA
AQUAMARINE

IMPIANTI
Ø4.5/5.0
PIATTAFORMA
LILLAC

-

AN2128

AN2132

-

AN2129

AN2133

-

AN2130

AN2134

-

AN3250

AN3336

-

AN2131

AN2135

-

AN2140

AN2136

-

AN2141

AN2137

-

AN2142

AN2138

-

AN3337

AN3338

-

AN2143

AN2139

-

AN1268

AN1315

-

AN1269

AN1316

-

AN1270

AN1317

-

AN1271

AN2314

-

AN1272

AN2315

-

AN1376

AN1379

-

AN1377

AN1380

-

AN1383

AN1385

-

AN1384

AN1386

-

AN2192

AN1359



A. TRANSFER M.U.A.

AN1722


B. TRANSFER UNI 20°

AN1724

C. TRANSFER UNI 45°

AN1725

Titanio grado 5



A. MONCONE CALCINABILE M.U.A. AN1216

B. MONCONE CALCINABILE UNI 20° AN1804

C. MONCONE CALCINABILE UNI 45° AN1805

Polimetilmetacrilato



COMBY CHROME M.U.A. AN2317

COMBY CHROME UNI 20° AN1328

COMBY CHROME UNI 45° AN1261

Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato



I-SCAN M.U.A. SCAN1001

I-SCAN UNI 20° SCAN1082

I-SCAN UNI 45° SCAN1083

Alluminio Ergal Mediale



DUAL SISTEM M.U.A. AN1337

DUAL SISTEM UNI 20° AN1365

DUAL SISTEM UNI 45° AN1368

CALCINABILE M.U.A. AN3106

CALCINABILE UNI AN3102

Titanio grado 5
Polimetilmetacrilato




VITE CORTE AN1723

VITE LUNGA AN2776

Titanio grado 5

NOTE LEGALI

Astra® è un marchio registrato da Dentsply International Inc., USA.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

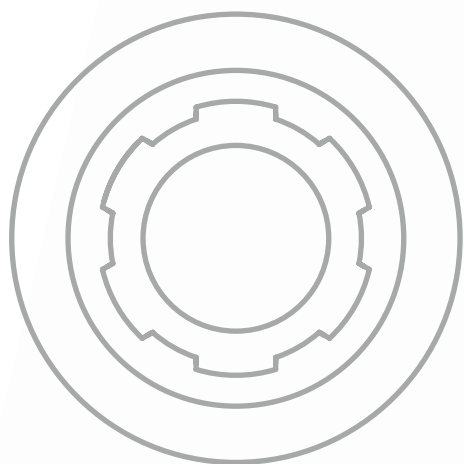

AKSerie



IMPIANTI Ø3.5/4.5/5.5/7.0	
PIATTAFORMA SINGLE	
	AN3121
	AN2735
	AN1489
	AN1490
	AN1135
	AN1136
	AN3120
	AN3113
	AN3114
	AN1507
	AN1508
	AN1509
	AN3131
	AN3132
	AN3133
	AN1609
	AN1273
	AN3276
	AN3279
	AN2746
	AN2747
	AN2748
	AN3098
	AN2024
	AN2744
	AN2745
	AN3098
	SCAN1024
	SCAN N-R
	SCAN N
	AN3182
	AN3177
	AN3176
	AN3194
	AN3195
	AN3196
	AN4638
	AN4639
	AN4637
	AN3197



COMBY CHROME NON ROTANTE
Cromo Cobalto
Polimetilmetacrilato

IMPIANTI Ø3.5/4.5/5.5/7.0
PIATTAFORMA SINGLE

AN3110



MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 6.0 mm
Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 139**

AN2739
AN2740
AN2741
AN2742
AN2743



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA H 2.0 mm
MONCONE SFERA H 3.0 mm
MONCONE SFERA H 4.0 mm
MONCONE SFERA H 5.0 mm
MONCONE SFERA H 6.0 mm
MONCONE SFERA H 7.0 mm
Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**

AN3857 (R)
AN3858 (R)
AN3859 (R)
AN3860 (R)
AN3861 (R)
AN3862 (R)



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm
Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

AN3850 (R)
AN3851 (R)
AN3852 (R)
AN3853 (R)
AN3854 (R)
AN3855 (R)
AN3856 (R)

COMPONENTISTICA SYNCONE



ANALOGO PILASTRO SYNCONE
Acciaio

AN3266



MONCONE PILASTRO SYNCONE
Titanio grado 5

AN3267



CAPPETTA GUARIGIONE SYNCONE
Titanio grado 5

AN3347

	Ø3.5/4.5/5.5/7.0	BALANCE BASE
	N. cm 25	N. cm 15
	M 1.8	M 1.4
	Es 1.0 mm	Es 1.0 mm

COMPONENTISTICA MONCONE STANDARD

IMPIANTI Ø3.5/4.5/5.5/7.0
PIATTAFORMA SINGLE



PILASTRO STANDARD /C A / 1.5 / 4.0

PILASTRO STANDARD /C A / 3.0 / 4.0

PILASTRO STANDARD /C A / 4.5 / 4.0

Titanio grado 5

AN1499

AN1500

AN1503



ANALOGO PILASTRO STANDARD /C A / 4.0

Titanio grado 5

AN2318



CALCINABILE STANDARD /C

Titanio grado 5

AN1491



A. PILASTRO STANDARD /C Saldatura

AN1130

B. PILASTRO STANDARD /C Saldatura

AN3140

Titanio grado 5



MICROVITE PILASTRO STANDARD /C

Titanio grado 5

AN1348

COMPONENTISTICA PER PROTESI AVVITATA



BALANCE BASE DRITTO H 0.75 mm - P.E. 4.2

BALANCE BASE DRITTO H 1.5 mm - P.E. 4.2

BALANCE BASE DRITTO H 3.0 mm - P.E. 4.2

BALANCE BASE DRITTO H 4.5 mm - P.E. 4.2

Titanio grado 5

AN1131

AN1132

AN1133

AN1134



ANALOGO BALANCE BASE

Acciaio

AN2023



MONCONE PROVVISORIO BALANCE BASE

Titanio grado 5

AN2738



MONCONE SALDATURA BALANCE BASE

Titanio grado 5

AN2737



DUAL SISTEM BALANCE BASE

AN3119

CALCINABILE BALANCE BASE

ANXXXX

Titanio grado 5

Polimetilmetacrilato



TRANSFER BALANCE BASE

Titanio grado 5

AN2734



MONCONE CALCINABILE BALANCE BASE

Polimetilmetacrilato

AN2736



COMBY CHROME BALANCE BASE

Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato

AN3134



I-SCAN BALANCE BASE

Titanio grado 4

SCAN1087



VITE PROTEZIONE BALANCE BASE

Titanio grado 5

AN3135



SCANBODY BALANCE BASE

SCAN-M-K

Alluminio



MICROVITE BALANCE BASE

AN3116

VITE TRANSFER BALANCE BASE

AN3117

MICROVITE D.I.S. e (Esagono)

AN3283

MICROVITE D.I.S. t (Torx)

AN4942


Titanio grado 5

NOTE LEGALI

Ankylos®, Frialit® and XIVE® sono marchi registrati da Dentsply® International Inc., USA.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.



ALSerie

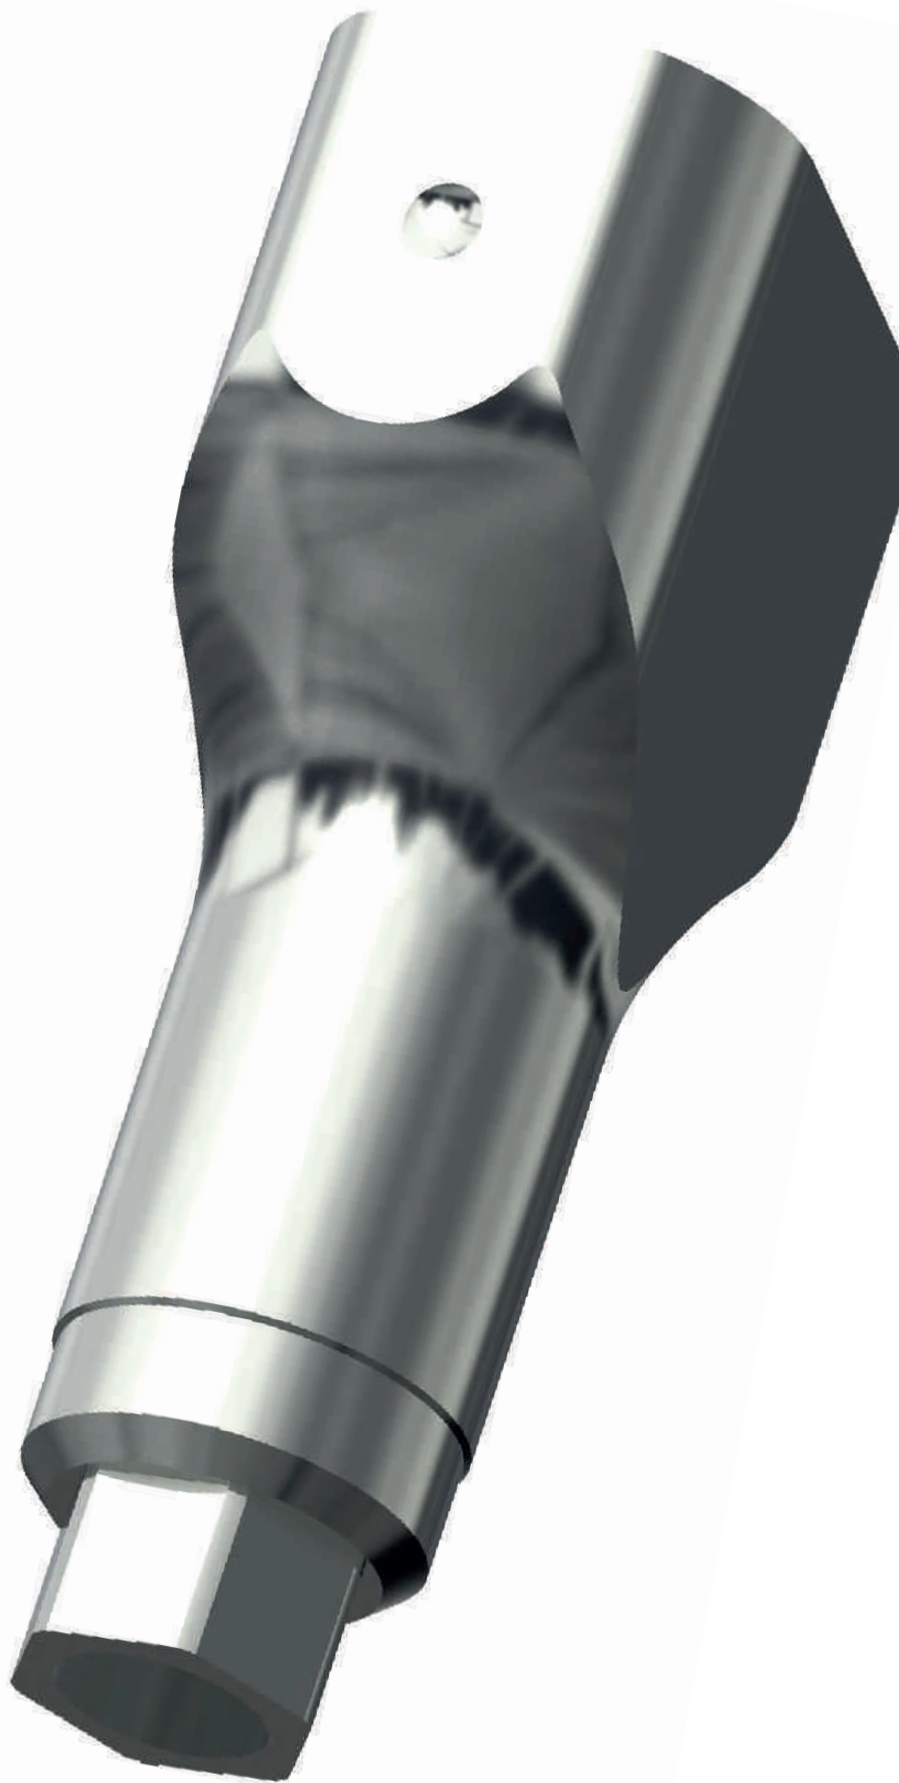

		IMPIANTI Ø3.3/3.75/4.2/5.0/6.0
		PIATTAFORMA SINGLE
	ANALOGO	AN1169
	Acciaio	
  	A. TRANSFER OPEN TRAY	AN1824
	B. TRANSFER CLOSED TRAY	AN2602
	C. UNIVERSAL IMPRESSION CAP	AN3136
Titanio grado 5		
 	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN1224
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm	AN1148
Titanio grado 5		
 	MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN1831
	MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	AN1832
Polimetilmetacrilato		
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - PE 4.5	AN1839
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - PE 5.5	AN2594
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - PE 4.5	AN1842
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - PE 5.5	AN2595
Titanio grado 5		
	MONCONE FRESABILE CILINDRICO PE 3.8	AN2470
	MONCONE FRESABILE CILINDRICO PE 4.5	AN1147
	MONCONE FRESABILE CILINDRICO PE 5.5	AN1829
Titanio grado 5		
	MONCONE 15° H 2.0 mm - PE 4.5	AN1209
	MONCONE 15° H 2.0 mm - PE 5.5	AN2596
	MONCONE 15° H 4.0 mm - PE 4.5	AN2597
	MONCONE 15° H 4.0 mm - PE 5.5	AN2598
Titanio grado 5		
	MONCONE 25° H 2.0 mm - PE 4.5	AN1155
	MONCONE 25° H 2.0 mm - PE 5.5	AN2599
	MONCONE 25° H 4.0 mm - PE 4.5	AN2600
	MONCONE 25° H 4.0 mm - PE 5.5	AN2601
Titanio grado 5		
	VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 4.5	AN1845
	VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 4.5	AN1867
	VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 4.5	AN1848
	VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 4.5	AN1853
	VITE GUARIGIONE H 7.0 mm - P.E. 4.5	AN1851
Titanio grado 5		
	VITE PROTESICA	AN1075
	VITE TRANSFER	AN1779
	VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3229
	VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN3299
Titanio grado 5		
	SIRONA® CEREC® I-BASE NON ROTANTE H 0.5mm	AN3172
	SIRONA® CEREC® I-BASE NON ROTANTE H 1.5mm	AN3173
	SIRONA® CEREC® I-BASE NON ROTANTE H 2.5mm	AN3174
	SCANPOST I-BASE	AN3175
Titanio grado 5		

		IMPIANTI Ø3.3/3.75/4.2/5.0/6.0
		PIATTAFORMA SINGLE
	BASE "FOR PRESS" ROTANTE	AN2604 (E)
	BASE "FOR PRESS" NON ROTANTE Titanio grado 5	AN2603 (E)
	COMBY CHROME ROTANTE	AN1836
	COMBY CHROME NON ROTANTE Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato	AN1835
	DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm	AN1331
	DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm	AN2448
	DUAL SISTEM ROTANTE H 2.5 mm	AN2454
	CALCINABILE ROTANTE	AN3701
	DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm	AN1429
	DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm	AN2459
	DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.5 mm	AN2461
	CALCINABILE NON ROTANTE Titanio grado 5	AN3098
ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE. N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera E riceverete vite D.I.S. testa esagonale N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera T riceverete vite D.I.S. testa torx N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"		
	SCANBODY ROTANTE	SCAN N-R
	SCANBODY NON ROTANTE Poli-Eter-Eter-Chetone	SCAN N
	INTRAORAL SCAN	SCAN1004
	Titanio grado 4	
	MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm	AN2482
	MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm	AN2483
	MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm	AN2484
	MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm	AN2485
	MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm	AN2486
Titanio grado 5 Kit riferimento pag. 139		
	MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm	AN1093 (R)
	MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm	AN1092 (R)
	MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm	AN1125 (R)
	MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm	AN1126 (R)
	MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm	AN1234 (R)
	MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm	AN3892 (R)
Titanio grado 5 Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN		
	MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm	AN3764 (R)
	MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm	AN3765 (R)
	MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm	AN3766 (R)
	MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm	AN3767 (R)
	MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm	AN3768 (R)
	MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm	AN3769 (R)
	MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm	AN3770 (R)
	Titanio grado 5 Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE	

	Ø3.75	M.U.A.
	N. cm 15	N. cm 15
	M 1.8	M 1.4
	Es 1.27 mm	Es 1.27 mm

Chiavi inserimento m.u.a.



M.U.A. DRIVER for RATCHET LUNGO ST1106


M.U.A. DRIVER for RATCHET CORTO ST1107



M.U.A. DRIVER ST1001

SERRAGGIO
Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

COMPONENTISTICA PER PROTESI AVVITATA

IMPIANTI Ø3.3/3.75/4.2/5.0/6.0	
PIATTAFORMA SINGLE	
	AN1615
	AN1616
	AN1617
	AN1336
	AN1536
Titanio grado 5	
	AN1012
	AN1356
	AN1013
Titanio grado 5	
	AN1207
	AN1144
	AN1334
Titanio grado 5	
	AN2749
Titanio grado 5	
	AN1720
Titanio grado 5	

ANALOGO M.U.A. AN1604
Acciaio



TRANSFER M.U.A. AN1318
Titanio grado 5



MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN1226
Titanio grado 5



MONCONE CALCINABILE M.U.A. AN1253
Polimetilmetacrilato



MONCONE SALDATURA M.U.A. AN2774
Titanio grado 5



COMBY CHROME M.U.A. AN2327
Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato



ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275
Acciaio



DUAL SISTEM M.U.A. AN1332
CALCINABILE M.U.A. AN3106
Titanio grado 5
Polimetilmetacrilato



VITE PROTEZIONE M.U.A. AN2258
Titanio grado 5



MICROVITE M.U.A. AN1274
VITE TRANSFER M.U.A. AN1423
MICROVITE D.I.S. e (Esagono) AN3290
MICROVITE D.I.S. t (Torx) AN3894
Titanium grade 5



VITE CERATURA M.U.A. CORTA AN1723
VITE CERATURA M.U.A. LUNGA AN2776
Titanio grado 5



INTRAORAL SCAN M.U.A. SCAN1001
Titanio grado 4




SCANBODY M.U.A. SCAN-M
Alluminio Ergal Mediale




NOTE LEGALI

AlphaBio® è un marchio registrato da Alpha-Bio Tec Ltd., ISRAEL.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

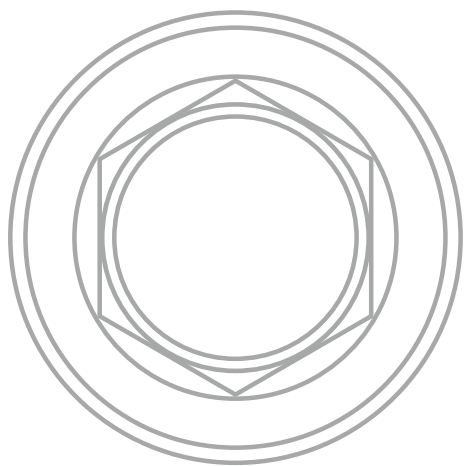

BSerie





ANALOGO

Acciaio

- A. TRANSFER OPEN TRAY**
B. TRANSFER CLOSED TRAY
C. UNIVERSAL IMPRESSION CAP

Titanio grado 5



- MONCONE PROVVISORIO ROTANTE** H 1.5 mm
MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 3.0 mm
MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm
MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 3.0 mm

Titanio grado 5



- MONCONE CALCINABILE ROTANTE**
MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

Polimetilmetacrilato



- MONCONE ESTETICO DRITTO** H 1.0 mm
MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm
MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm
MONCONE ESTETICO DRITTO H 4.0 mm

Titanio grado 5



- MONCONE FRESABILE DRITTO**
MONCONE FRESABILE 25°

Titanio grado 5



- MONCONE 15°** H 2.0 mm
MONCONE 15° H 4.0 mm

Titanio grado 5



- MONCONE 25°** H 2.0 mm
MONCONE 25° H 4.0 mm

Titanio grado 5



- VITE GUARIGIONE** H 2.0 mm - P.E. 3.5
VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 5.0
VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 3.5
VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 5.0
VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 5.5
VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 3.5
VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 5.0
VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 3.5
VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 5.0
VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 5.5

Titanio grado 5



- VITE PROTESICA**
VITE TRANSFER OPEN TRAY
VITE TRANSFER CLOSED TRAY
VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)
VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)

Titanio grado 5



- SIRONA® CEREC® I-BASE NON ROTANTE** H 0.7 mm
SIRONA® CEREC® I-BASE NON ROTANTE H 1.5 mm
SIRONA® CEREC® I-BASE NON ROTANTE H 2.5 mm

SCANPOST I-BASE

Titanio grado 5


IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø3.75/4.2	IMPIANTI Ø5.0
PIATTAFORMA (NP)	PIATTAFORMA (RP)	PIATTAFORMA (WP)
AN1549	AN1539	AN1550
AN1158	AN1571	AN1578
AN2662	AN2663	-
AN3136	AN3136	-
AN1557	AN1419	AN1558
-	AN1160	-
AN1559	AN1418	AN1560
-	AN1161	-
AN1551	AN1552	AN1553
AN1555	AN1554	AN1556
P.E. 4 AN3188	P.E. 5 AN1127	-
P.E. 4 AN1564	P.E. 5 AN1229	P.E. 6 AN1166
P.E. 4 AN3189	P.E. 5 AN1128	-
P.E. 4 AN1165	P.E. 5 AN1230	P.E. 6 AN1565
AN1218	AN1537	AN1562
AN2295	AN2195	-
AN1167	AN1566	AN1562
AN1168	AN1569	-
AN2664	AN1567	-
AN2665	AN1568	-
AN3082	-	-
-	AN1579	-
AN2075	-	-
-	AN1580	-
-	-	AN2077
AN3083	-	-
-	AN1581	-
AN2076	-	-
-	AN1129	-
-	-	AN2078
AN1546	AN2284	AN1547
AN1174	AN1665	AN1175
AN3183	AN3184	-
AN3245	AN3244	-
AN3863	AN3864	-
AN3667	AN3670	-
AN3668	AN3671	-
AN3669	AN3672	-
-	-	-



BASE "FOR PRESS" ROTANTE
BASE "FOR PRESS" NON ROTANTE
Titanio grado 5



COMBY CHROME ROTANTE
COMBY CHROME NON ROTANTE
Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato



DUAL SISTEM ROTANTE H 1.0 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 2.0 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 3.0 mm
CALCINABILE ROTANTE
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.0 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.0 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.0 mm
CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5
ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE
SCANBODY NON ROTANTE
Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN
Titanio grado 4



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm
Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 139**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm
Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm
Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

	Ø3.5 (NP)	Ø4.1 (RP)	Ø5.0 (WP)	M.U.A.
	N.cm 20	N.cm 32	N.cm 35	N.cm 5
	M 1.6	M 2.0	M 2.5	M 1.4
	TX 5.5 mm	TX 5.5 mm	TX 5.5 mm	TX 5.5 mm

Chiavi inserimento m.u.a.



M.U.A. DRIVER for RATCHET LUNGO ST1106


M.U.A. DRIVER for RATCHET CORTO ST1107



M.U.A. DRIVER ST1001

SERRAGGIO
Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

ABUTMENT PROTESI AVVITATA



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm
M.U.A. DRITTO H 2.0 mm
M.U.A. DRITTO H 3.0 mm
M.U.A. DRITTO H 4.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 3.0 mm
M.U.A. 17° H 4.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.0 mm
M.U.A. 30° H 4.0 mm

Titanio grado 5



VITE ANGOLATA M.U.A.

Titanio grado 5

IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø3.75/4.2	IMPIANTI Ø5.0
PIATTAFORMA (NP)	PIATTAFORMA (RP)	PIATTAFORMA (WP)
AN1586	AN1590	AN1589
AN1587	AN1591	AN1588
AN2678	AN1592	AN2456
AN2679	AN1593	-
AN2680	AN2068	-
AN2681	AN2070	-
AN2682	AN2073	-
AN2683	AN2074	-
AN2259	AN2260	-



ANALOGO M.U.A.

Acciaio

AN1604



MONCONE PROVVISORIO M.U.A.

Titanio grado 5

AN1601



MONCONE SALDATURA M.U.A.

Titanio grado 5

AN2783



ANALOGO PROTEZIONE M.U.A.

Acciaio

AN2275



VITE PROTEZIONE M.U.A.

Titanio grado 5

AN1279



MICROVITE M.U.A.

AN1548

VITE TRANSFER M.U.A.

AN1119

MICROVITE D.I.S. e (Esagono)

AN3290

MICROVITE D.I.S. t (Torx)

AN3894

Titanium grade 5



INTRAORAL SCAN M.U.A.

Titanio grado 4

SCAN1000



TRANSFER M.U.A.

Titanio grado 5

AN1603



MONCONE CALCINABILE M.U.A.

Polimetilmetacrilato

AN1602



COMBY CHROME M.U.A.

Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato

AN2029



DUAL SISTEM M.U.A.

AN1105

CALCINABILE M.U.A.

AN3106

Titanio grado 5
Polimetilmetacrilato



VITE CERATURA M.U.A. SHORT

AN1119

VITE CERATURA M.U.A. LONG

AN2784

Titanio grado 5



SCANBODY M.U.A.

Alluminio Ergal Mediale

SCAN-M-B

NOTE LEGALI

Brånemark®, Replace® e Active® sono marchi registrati da Nobel Biocare, AB SWEDEN.

Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.



BESerie





ANALOGO

Acciaio

TRANSFER OPEN TRAY

Titanio grado 5

MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm

Titanio grado 5

MONCONE CALCINABILE ROTANTE

MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

Polimetilmetacrilato

MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm - P.E. 4.0

MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm - P.E. 4.5

MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm - P.E. 5.5

MONCONE ESTETICO DRITTO H 4.0 mm - P.E. 4.5

Titanio grado 5

MONCONE FRESABILE CILINDRICO P.E. 4.5

MONCONE FRESABILE CILINDRICO P.E. 5.5

Titanio grado 5

MONCONE 15° H 2.0 mm P.E. 4.5

MONCONE 15° H 2.0 mm P.E. 5.5

MONCONE 15° H 2.0 mm P.E. 5.0

Titanio grado 5

MONCONE 25° H 2.0 mm P.E. 4.0

MONCONE 25° H 2.0 mm P.E. 4.5

MONCONE 25° H 2.0 mm P.E. 4.5

Titanio grado 5

VITE GUARIGIONE H 2.0 mm

VITE GUARIGIONE H 3.0 mm

VITE GUARIGIONE H 4.0 mm

VITE GUARIGIONE H 6.0 mm

Titanio grado 5

VITE PROTESICA

VITE TRANSFER OPEN TRAY

VITE TRANSFER CLOSED TRAY

VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)

VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)

Titanio grado 5

SIRONA® CEREC® I-BASE NON ROTANTE H0.7 mm

SIRONA® CEREC® I-BASE NON ROTANTE H1.5 mm

SIRONA® CEREC® I-BASE NON ROTANTE H2.5 mm

SCANPOST I-BASE

Titanio grado 5


COMBY CHROME ROTANTE

COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.

Polimetilmetacrilato

	IMPIANTI Ø3.25 Ø3.75	IMPIANTI Ø4.1	IMPIANTI Ø4.5
	PIATTAFORMA Ø3.67 Ø3.67	PIATTAFORMA Ø4.1	PIATTAFORMA Ø4.5
ANALOGO	AN1210	AN1222	AN1212
TRANSFER OPEN TRAY	AN1991	AN1223	AN3343
MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN2533	AN1225	AN1224
MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm	AN2345	AN1232	AN2345
MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN1831	AN1243	AN1833
MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	AN1062	AN1250	AN2346
MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm - P.E. 4.0	AN3306	-	-
MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm - P.E. 4.5	AN1343	AN1255	-
MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm - P.E. 5.5	-	-	AN2042
MONCONE ESTETICO DRITTO H 4.0 mm - P.E. 4.5	AN1826	AN1275	-
MONCONE FRESABILE CILINDRICO P.E. 4.5	AN1103	AN2184	-
MONCONE FRESABILE CILINDRICO P.E. 5.5	-	-	AN2185
MONCONE 15° H 2.0 mm P.E. 4.5	AN2347	-	-
MONCONE 15° H 2.0 mm P.E. 5.5	-	-	AN3330
MONCONE 15° H 2.0 mm P.E. 5.0	AN3286	AN1276	-
MONCONE 25° H 2.0 mm P.E. 4.0	AN3331	-	-
MONCONE 25° H 2.0 mm P.E. 4.5	AN2348	-	-
MONCONE 25° H 2.0 mm P.E. 4.5	-	AN1288	-
VITE GUARIGIONE H 2.0 mm	P.E. 3.8 AN1324	P.E. 4.5 AN1845	P.E. 5.5 AN2477
VITE GUARIGIONE H 3.0 mm	P.E. 3.8 AN1325	P.E. 4.5 AN1867	P.E. 5.5 AN2478
VITE GUARIGIONE H 4.0 mm	P.E. 3.8 AN1326	P.E. 4.5 AN1848	P.E. 5.5 AN2479
VITE GUARIGIONE H 6.0 mm	P.E. 3.8 AN1327	P.E. 4.5 AN1851	P.E. 5.5 AN2480
VITE PROTESICA	AN1075	AN1075	AN1075
VITE TRANSFER OPEN TRAY	AN1779	AN1779	AN1779
VITE TRANSFER CLOSED TRAY	AN1076	AN1076	AN1076
VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3229	AN3229	AN3229
VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN3299	AN3299	AN3299
SIRONA® CEREC® I-BASE NON ROTANTE H0.7 mm	AN3801	-	-
SIRONA® CEREC® I-BASE NON ROTANTE H1.5 mm	AN3804	-	-
SIRONA® CEREC® I-BASE NON ROTANTE H2.5 mm	AN3803	-	-
SCANPOST I-BASE	AN3800	-	-
COMBY CHROME ROTANTE	AN1836	AN3804	AN2041
COMBY CHROME NON ROTANTE	AN1082	AN3805	AN1083



DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 2.5 mm
CALCINABILE ROTANTE
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.5 mm
CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE
SCANBODY NON ROTANTE
 Poli-Eter-Eter-Chetone




INTRAORAL SCAN
 Titanio grado 4



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 139**
 * i diametri Ø 3.75/4.1 possono essere utilizzati nei diametri maggiori Ø 4.5 creando platform switching



SU RICHIESTA 5 GIORNI LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**
 * i diametri Ø 3.75/4.1 possono essere utilizzati nei diametri maggiori Ø 4.5 creando platform switching



SU RICHIESTA 5 GIORNI LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

IMPIANTI Ø3.25 Ø3.75	IMPIANTI Ø4.1	IMPIANTI Ø4.5
PIATTAFORMA Ø3.67 Ø3.67	PIATTAFORMA Ø4.1	PIATTAFORMA Ø4.5
AN1331	AN1294	AN4806
AN2448	AN1306	AN2457
AN2454	AN1308	AN2458
AN3101	AN3101	AN3102
AN1631	AN1314	AN2040
AN2670	AN1381	AN2043
AN2671	AN1483	AN2044
AN3098	AN3098	AN3099
SCAN N-R	SCAN N-R	SCAN R-R
SCAN N	SCAN N	SCAN R
SCAN1022	SCAN1022	SCAN1022
AN2482	AN3788*	AN2636*
AN2483	AN3789*	AN2637*
AN2484	AN3790*	AN2638*
AN2485	AN3791*	AN2639*
AN2486	AN3792*	AN2640*
AN1093 (R)	AN3776 (R)	AN3771 (R)
AN1092 (R)	AN3777 (R)	AN3772 (R)
AN1125 (R)	AN3778 (R)	AN3773 (R)
AN1126 (R)	AN3779 (R)	AN3774 (R)
AN1234 (R)	AN3780 (R)	AN3775 (R)
AN3891 (R)	AN3781 (R)	AN3893 (R)
AN 3764 (R)	AN3793 (R)	AN3781 (R)
AN 3765 (R)	AN3794 (R)	AN3782 (R)
AN 3766 (R)	AN3795 (R)	AN3783 (R)
AN 3767 (R)	AN3796 (R)	AN3784 (R)
AN 3768 (R)	AN3797 (R)	AN3785 (R)
AN 3769 (R)	AN3798 (R)	AN3786 (R)
AN 3770 (R)	AN3799 (R)	AN3787 (R)

	Ø3.25/3.75	Ø4.1	Ø4.5	M.U.A.
	N.cm 20	N.cm 32	N.cm 35	N.cm 5
	M 1.8	M 1.8	M 1.4	M 1.4
	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm

Chiavi inserimento m.u.a.



M.U.A. DRIVER for RATCHET LUNGO ST1106

M.U.A. DRIVER for RATCHET CORTO ST1107




M.U.A. DRIVER ST1001

SERRAGGIO

Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
 Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

ABUTMENT PROTESI AVVITATA



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm
M.U.A. DRITTO H 2.0 mm
M.U.A. DRITTO H 3.0 mm
M.U.A. DRITTO H 4.0 mm
M.U.A. DRITTO H 5.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.5 mm
M.U.A. 17° H 3.5 mm
M.U.A. 17° H 4.5 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.5 mm
M.U.A. 30° H 4.5 mm
M.U.A. 30° H 5.5 mm

Titanio grado 5



VITE ANGOLATA M.U.A.

Titanio grado 5

IMPIANTI Ø3.25 Ø3.75	IMPIANTI Ø4.1	IMPIANTI Ø4.5
PIATTAFORMA Ø3.67 Ø3.67	PIATTAFORMA Ø4.1	PIATTAFORMA Ø4.5
AN1615	AN1615	AN1614
AN1616	AN1616	AN1362
AN1617	AN1617	AN1856
AN1336	AN1336	AN1333
AN1536	AN1536	AN1858
AN1057	AN1057	-
AN1058	AN1058	-
AN1311	AN1311	-
AN2349	AN2349	-
AN2350	AN2350	-
AN2351	AN2351	-
AN1720	AN1720	-



ANALOGO M.U.A.

Acciaio

AN1604



TRANSFER M.U.A.

Titanio grado 5

AN1318



MONCONE PROVVISORIO M.U.A.

Titanio grado 5

AN1226



MONCONE CALCINABILE M.U.A.

Polimetilmetacrilato

AN1253



MONCONE SALDATURA M.U.A.

Titanio grado 5

AN2774



COMBY CHROME M.U.A.

Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato

AN2327



ANALOGO PROTEZIONE M.U.A.

Acciaio

AN2275



DUAL SISTEM M.U.A.

CALCINABILE M.U.A.

Titanio grado 5
Polimetilmetacrilato

AN1332

AN3106



MICROVITE M.U.A.

AN1274

VITE TRANSFER M.U.A.

AN1423

MICROVITE D.I.S. e (Esagono)

AN3290

MICROVITE D.I.S. t (Torx)

AN3894

Titanium grade 5



VITE CERATURA M.U.A. CORTA

AN1723

VITE CERATURA M.U.A. LUNGA

AN2776

Titanio grado 5



INTRAORAL SCAN M.U.A.

Titanio grado 4

SCAN1001



SCANBODY M.U.A.

Alluminio Ergal Mediale

SCAN-M-BE

NOTE LEGALI

Bego®, è un marchio registrato da Bremer Goldschlägerer Wilh. Herbst GmbH & Co. KG GERMANY.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.



BHSerie



		IMPIANTI Ø3.0/3.4/3.8	IMPIANTI Ø3.8/4.6	IMPIANTI Ø4.6/5.8	IMPIANTI Ø5.8
		PIATTAFORMA Ø3.0	PIATTAFORMA Ø3.5	PIATTAFORMA Ø4.5	PIATTAFORMA Ø5.7
 ANALOGO Acciaio   		AN2635	AN1169	AN1056	AN1055
	A. TRANSFER OPEN TRAY	AN3395	AN1824	AN1825	-
	B. TRANSFER CLOSED TRAY	AN3396	AN2602	-	-
	C. UNIVERSAL IMPRESSION CAP	AN3136	AN3136	-	-
 	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE - H 1.5 mm	AN3726	AN1224	AN1142	-
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE - H 1.5 mm	AN3727	AN1148	AN1098	-
Titanio grado 5					
 	MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN3725	AN1831	AN1833	AN2633
	MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	AN2293	AN1832	AN1834	AN2634
Polimetilmetacrilato					
 	MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 4.5	AN3729	AN1839	-	-
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 5.5	-	-	AN1840	-
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 6.5	-	-	-	AN1841
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 4.5	-	AN1842	-	-
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 5.5	-	-	AN1843	-
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 6.5	-	-	-	AN1844
	Titanio grado 5				
	MONCONE FRESABILE P.E. 3.8	AN2632	AN2470	-	-
	MONCONE FRESABILE P.E. 4.5	-	AN1147	AN1095	-
	MONCONE FRESABILE P.E. 5.5	-	AN1829	AN1152	AN1712
Titanio grado 5					
	MONCONE 15° H 2.0 mm - P.E. 4.5	AN3728	AN1209	-	-
	MONCONE 15° H 2.0 mm - P.E. 5.5	-	AN2596	AN1355	-
	MONCONE 15° H 4.0 mm - P.E. 4.5	-	AN2597	-	-
	MONCONE 15° H 4.0 mm - P.E. 5.5	-	AN2598	-	-
Titanio grado 5					
	MONCONE 25° H 2.0 mm - P.E. 4.5	AN3922	AN1155	-	-
	MONCONE 25° H 2.0 mm - P.E. 5.5	-	AN2599	AN1094	-
	MONCONE 25° H 4.0 mm - P.E. 4.5	-	AN2600	-	-
	MONCONE 25° H 4.0 mm - P.E. 5.5	-	AN2601	-	-
Titanio grado 5					
	VITE GUARIGIONE H 2.0 mm	-	AN1845	-	-
	VITE GUARIGIONE H 3.0 mm	AN3397	AN1867	AN1846	AN1847
	VITE GUARIGIONE H 4.0 mm	-	AN1848	-	-
	VITE GUARIGIONE H 5.0 mm	AN3730	AN1853	AN1849	AN1850
	VITE GUARIGIONE H 7.0 mm	AN5096	AN1851	AN1852	-
Titanio grado 5					
	VITE PROTESICA	AN2294	AN1075	AN1075	AN1075
	VITE TRANSFER	AN4805	AN1779	AN1779	AN1779
	VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3229	AN3229	AN3229	AN3229
	VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN3923	AN3923	AN3923	AN3923
Titanio grado 5					
	I-BASE H 0.5 mm	AN3913	AN3172	AN3309	-
	I-BASE H 1.5 mm	AN3914	AN3173	AN3310	-
	I-BASE H 2.5 mm	AN3915	AN3174	AN3311	-
Titanio grado 5					




BASE FOR PRESS ROTANTE
BASE FOR PRESS NON ROTANTE

Titanio grado 5



COMBY CHROME ROTANTE
COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato



DUAL SISTEM ROTANTE - H 0.5 mm
DUAL SISTEM ROTANTE - H 1.5 mm
DUAL SISTEM ROTANTE - H 2.5 mm
CALCINABILE ROTANTE
DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 0.5 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 1.5 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 2.5 mm
CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE
SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone




INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4



MONCONE CONNECTOR H 1.0 mm
MONCONE CONNECTOR H 2.0 mm
MONCONE CONNECTOR H 3.0 mm
MONCONE CONNECTOR H 4.0 mm
MONCONE CONNECTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 139**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

* Prodotto su richiesta

	IMPIANTI Ø3.0/3.4/3.8 PIATTAFORMA Ø3.0	IMPIANTI Ø3.8/4.6 PIATTAFORMA Ø3.5	IMPIANTI Ø4.6/5.8 PIATTAFORMA Ø4.5	IMPIANTI Ø5.8 PIATTAFORMA Ø5.7
BASE FOR PRESS ROTANTE	-	AN2604	-	-
BASE FOR PRESS NON ROTANTE	-	AN2603	-	-
COMBY CHROME ROTANTE	AN3694	AN1836	AN1838	AN1879
COMBY CHROME NON ROTANTE	AN3693	AN1835	AN1837	AN1880
DUAL SISTEM ROTANTE - H 0.5 mm	AN2750	AN1331	AN1353	AN1964
DUAL SISTEM ROTANTE - H 1.5 mm	AN4945	AN2448	AN2457	-
DUAL SISTEM ROTANTE - H 2.5 mm	AN4947	AN2454	AN2458	-
CALCINABILE ROTANTE	AN5526	AN3101	AN3102	AN3103
DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 0.5 mm	AN2751	AN1429	AN1430	AN1431
DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 1.5 mm	AN4946	AN2459	AN2819	-
DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 2.5 mm	AN4948	AN2461	AN2820	-
CALCINABILE NON ROTANTE	AN5526	AN3098	AN3099	AN3100
SCANBODY ROTANTE	SCAN S-R	SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN W-R
SCANBODY NON ROTANTE	SCAN S	SCAN N	SCAN R	SCAN W
INTRAORAL SCAN	SCAN1023	SCAN1004	SCAN1006	SCAN1025
MONCONE CONNECTOR H 1.0 mm	-	AN2482	AN2636	-
MONCONE CONNECTOR H 2.0 mm	-	AN2483	AN2637	-
MONCONE CONNECTOR H 3.0 mm	-	AN2484	AN2638	-
MONCONE CONNECTOR H 4.0 mm	-	AN2485	AN2639	-
MONCONE CONNECTOR H 5.0 mm	-	AN2486	AN2640	-
MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm	AN3902 (R)	AN1093	AN3771 (R)	AN3916 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm	AN3903 (R)	AN1092	AN3772 (R)	AN3917 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm	AN3904 (R)	AN1125	AN3773 (R)	AN3918 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm	AN3905 (R)	AN1126	AN3774 (R)	AN3919 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm	AN3906 (R)	AN1234	AN3775 (R)	AN3920 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm	AN3907 (R)	AN3892	AN3893 (R)	AN3921 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm	AN3895 (R)	AN3764 (R)	AN3781 (R)	AN3924 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm	AN3896 (R)	AN3765 (R)	AN3782 (R)	AN3925 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm	AN3897 (R)	AN3766 (R)	AN3783 (R)	AN3926 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm	AN3898 (R)	AN3767 (R)	AN3784 (R)	AN3927 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm	AN3899 (R)	AN3768 (R)	AN3785 (R)	AN3928 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm	AN3900 (R)	AN3769 (R)	AN3786 (R)	AN3929 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm	AN3901 (R)	AN3770 (R)	AN3787 (R)	AN3930 (R)

	Ø3.0	Ø3.5	Ø4.5	Ø5.7	M.U.A.
	N.cm 25	N.cm 30	N.cm 30	N.cm 30	N.cm 15
	M 1.8	M 1.8	M 1.8	M 1.8	M 1.4
	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm

Chiavi inserimento m.u.a.



M.U.A. DRIVER for RATCHET LUNGO ST1106

M.U.A. DRIVER for RATCHET CORTO ST1107




M.U.A. DRIVER ST1001

SERRAGGIO

Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

ABUTMENT PROTESI AVVITATA



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm
M.U.A. DRITTO H 2.0 mm
M.U.A. DRITTO H 3.0 mm
M.U.A. DRITTO H 4.0 mm
M.U.A. DRITTO H 5.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.5 mm
M.U.A. 17° H 3.5 mm
M.U.A. 17° H 4.5 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.5 mm
M.U.A. 30° H 4.5 mm
M.U.A. 30° H 5.5 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 45° H 3.5 mm

Titanio grado 5



VITE M.U.A. ANGOLATO

Titanio grado 5

IMPIANTI Ø3.0/3.4/3.8	IMPIANTI Ø3.8/4.6	IMPIANTI Ø4.6/5.8	IMPIANTI Ø5.8
PIATTAFORMA Ø3.0	PIATTAFORMA Ø3.5	PIATTAFORMA Ø4.5	PIATTAFORMA Ø5.7
AN3731	AN1615	AN1614	-
AN3732	AN1616	AN1362	-
AN3733	AN1617	AN1856	-
-	AN1336	AN1333	-
AN3734	AN1536	AN1858	-
AN3735	AN1012	AN4943	-
AN4940	AN1356	AN4949	-
-	AN1013	-	-
AN3736	AN1207	AN4944	-
AN4941	AN1144	AN4950	-
-	AN1334	-	-
-	AN2749	AN2749	-
AN1720	AN1720	AN1720	AN1720



ANALOGO M.U.A.

Acciaio

AN1604



TRANSFER M.U.A.

Titanio grado 5

AN1318



MONCONE PROVVISORIO M.U.A.

Titanio grado 5

AN1226



MONCONE CALCINABILE M.U.A.

Polimetilmetacrilato

AN1253



MONCONE SALDATURA M.U.A.

Titanio grado 5

AN2774



COMBY CHROME M.U.A.

Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato

AN2327



ANALOGO PROTEZIONE M.U.A.

Acciaio

AN2275



DUAL SISTEM M.U.A.

Titanio grado 5

AN1332

CALCINABILE M.U.A.

Polimetilmetacrilato

AN3106



MICROVITE M.U.A.

AN2330

VITE TRANSFER M.U.A.

AN2536

MICROVITE D.I.S. e (Esagono)

AN3290

MICROVITE D.I.S. t (Torx)

AN3894

Titanio grado 5



VITE CERATURA M.U.A. CORTA

AN1423

VITE CERATURA M.U.A. LUNGA

AN2776

Titanio grado 5



INTRAORAL SCAN M.U.A.

SCAN1001

Titanio grado 4



SCANBODY M.U.A.

Alluminio Ergal Mediale

SCAN-M-BH




VITE PROTEZIONE M.U.A H 4.0 mm

AN2258

Titanio grado 5


NOTE LEGALI

BioHorizons®, Laser-Lok®, MinerOss®, AutoTac®, Mem-Lok® and TeethXpress™ sono marchi registrati da BioHorizons®
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

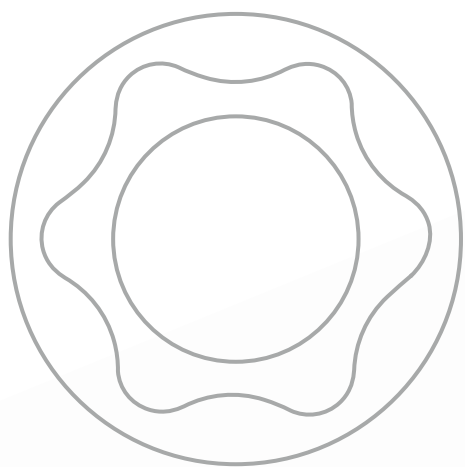

BTSerie



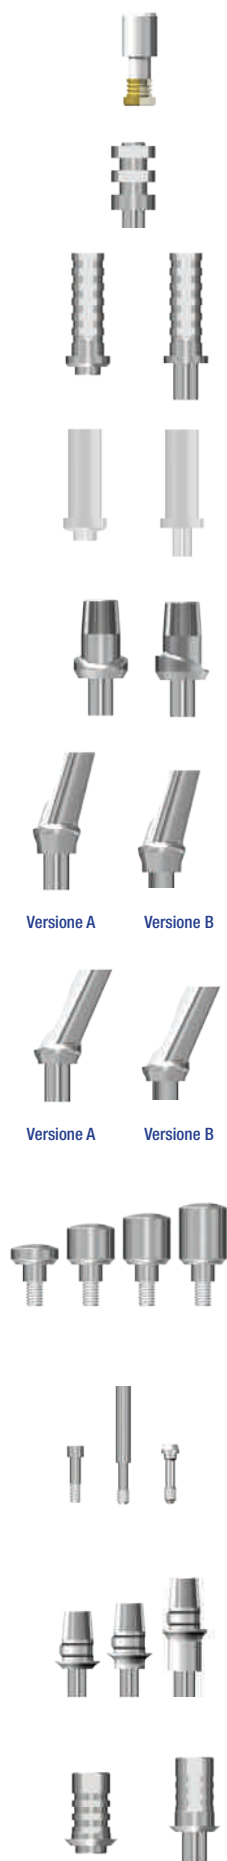

	IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø3.5 / Ø4.0 Ø4.5 / Ø5.5
	PIATTAFORMA Ø3.5	PIATTAFORMA Ø4.0
ANALOGO Acciaio	AN1993	AN2051
TRANSFER OPEN TRAY Titanio grado 5	-	AN2654
MONCONE PROVVISORIO ROTANTE - H 1.5 mm	-	AN2500
MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE - H 1.5 mm	-	AN2499
Titanio grado 5		
MONCONE CALCINABILE ROTANTE	-	AN2145
MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	-	AN2144
Polimetilmetacrilato		
MONCONE DRITTO H 1.5 mm - P.E. 5.2	-	AN1085
MONCONE DRITTO H 3.0 mm - P.E. 5.2	-	AN1086
Titanio grado 5		
MONCONE 15° H 2.0 mm - P.E. 5.2 versione "A"	-	AN1087
MONCONE 15° H 2.0 mm - P.E. 5.2 versione "B"	-	AN1090
Titanio grado 5		
MONCONE 25° H 2.0 mm - P.E. 5.2 versione "A"	-	AN2511
MONCONE 25° H 2.0 mm - P.E. 5.2 versione "B"	-	AN2513
Titanio grado 5		
VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 5.5	-	AN2434
VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 5.5	-	AN2433
VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 5.5	-	AN3111
VITE GUARIGIONE H 6.0 mm - P.E. 5.5	-	AN2432
Titanio grado 5		
VITE PROTESICA	AN1088	AN1088
VITE TRANSFER	AN2655	AN2655
VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3335	AN3335
VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN3931	AN3931
Titanio grado 5		
SIRONA® CEREC® I-BASE NON ROTANTE H 0.7 mm	-	AN3670
SIRONA® CEREC® I-BASE NON ROTANTE H 1.5 mm	-	AN3671
SIRONA® CEREC® I-BASE NON ROTANTE H 2.5 mm	-	AN3672
SCANPOST I-BASE	-	-
Titanio grado 5		
BASE "FOR PRESS" ROTANTE	-	AN2752
BASE "FOR PRESS" NON ROTANTE	-	AN2753
Titanio grado 5		



COMBY CHROME ROTANTE
COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato



DUAL SISTEM ROTANTE - H 0.5 mm
DUAL SISTEM ROTANTE - H 1.5 mm
CALCINABILE ROTANTE
DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 0.5 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 1.5 mm
CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE
SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 139**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø3.5 / Ø4.0 Ø4.5 / Ø5.5
PIATTAFORMA Ø3.5	PIATTAFORMA Ø4.0
-	AN2049
-	AN2050
-	AN1967
-	AN2656
-	AN3102
-	AN1084
-	AN2532
-	AN3099
SCAN N-R	SCAN R-R
SCAN N	SCAN R
SCAN1095	SCAN1026
-	AN2657
-	AN2658
-	AN2659
-	AN2660
-	AN2661
AN3933 (R)	AN3945 (R)
AN3934 (R)	AN3946 (R)
AN3935 (R)	AN3947 (R)
AN3936 (R)	AN3948 (R)
AN3937 (R)	AN3949 (R)
AN3950 (R)	AN3938 (R)
AN3951 (R)	AN3939 (R)
AN3952 (R)	AN3940 (R)
AN3953 (R)	AN3941 (R)
AN3954 (R)	AN3942 (R)
AN3955 (R)	AN3943 (R)
AN3956 (R)	AN3944 (R)

	Ø3.5	Ø4.0	M.U.A.
	N.cm 20	N.cm 20	N.cm 5
	M 1.8	M 1.8	M 1.4
	TX 6.0	TX 6.0	TX 6.0

Chiavi inserimento m.u.a.



M.U.A. DRIVER for RATCHET **LUNGO** ST1106

M.U.A. DRIVER for RATCHET **CORTO** ST1107




M.U.A. DRIVER ST1001

SERRAGGIO

Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

ABUTMENT PROTESI AVVITATA

IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø3.5 / Ø4.0 Ø4.5 / Ø5.5
PIATTAFORMA Ø3.5	PIATTAFORMA Ø4.0
-	AN2406
-	AN2407
-	AN2408
-	AN2409
-	AN2410
-	AN2464
-	AN2465
-	AN2462
-	AN2463
-	AN2460



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm
M.U.A. DRITTO H 2.0 mm
M.U.A. DRITTO H 3.0 mm
M.U.A. DRITTO H 4.0 mm
M.U.A. DRITTO H 5.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.5 mm
M.U.A. 17° H 3.5 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.5 mm
M.U.A. 30° H 4.5 mm

Titanio grado 5



VITE M.U.A. ANGOLATO

Titanio grado 5



ANALOGO M.U.A.

Acciaio

AN1604



TRANSFER M.U.A.

Titanio grado 5

AN2436



MONCONE PROVVISORIO M.U.A.

Titanio grado 5

AN2437



MONCONE CALCINABILE M.U.A.

Polimetilmetacrilato

AN2512



MONCONE SALDATURA M.U.A.

Titanio grado 5

AN2779



COMBY CHROME M.U.A.

Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato

AN3344



ANALOGO PROTEZIONE M.U.A.

Acciaio

AN2275



**DUAL SISTEM M.U.A.
CALCINABILE M.U.A.**

Titanio grado 5
Polimetilmetacrilato

AN2780

AN3106



MICROVITE M.U.A.

AN1247

VITE TRANSFER M.U.A.

AN2781

MICROVITE D.I.S. e (Esagono)

AN3290

MICROVITE D.I.S. t (Torx)

AN3894

Titanio grado 5



VITE CERATURA M.U.A. CORTO

AN2781

VITE CERATURA M.U.A. LUNGO

AN2782

Titanio grado 5



INTRAORAL SCAN M.U.A.

Titanio grado 4

SCAN1003



SCANBODY M.U.A.

Alluminio Ergal Mediale

SCAN-M-BT




VITE PROTEZIONE M.U.A H 4.0 mm

Titanio grado 5

AN2435

NOTE LEGALI

Bredent® è un marchio registrato da Bredent GmbH & Co. KG, Weißenhorner 2, 89250 Senden GERMANY.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

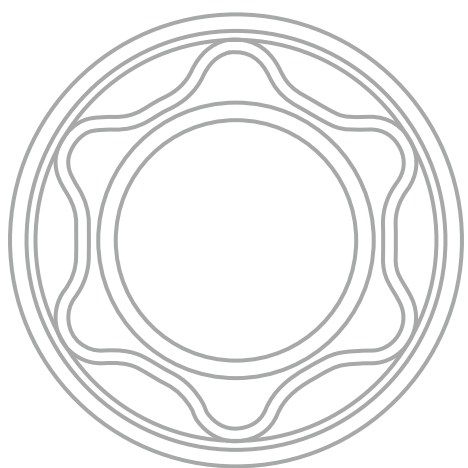

BXSerie

Compatibile **STRAUMANN®**
BLX®




	IMPIANTI Ø3.5 - Ø3.75 Ø4.0 - Ø4.5	IMPIANTI Ø5.0 - Ø5.5 Ø6.0
	PIATTAFORMA RB	PIATTAFORMA WB



ANALOG

Acciaio




A. TRANSFER OPEN TRAY

B. TRANSFER ROTANTE

C. UNIVERSAL IMPRESSION CAP

Titanio grado 5



MONCONE PROVVISORIO ROTANTE - H 1.5 mm

MONCONE PROVVISORIO ROTANTE - H 2.5 mm

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE - H 1.5 mm

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE - H 1.5 mm

Titanio grado 5



MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.5 mm - P.E. 4.5

MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.5 mm - P.E. 6.0

MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.5 mm - P.E. 4.5

MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.5 mm - P.E. 6.0

Titanio grado 5



MONCONE 17° H 2.5 mm - P.E. 6.0

MONCONE 17° H 3.5 mm - P.E. 6.0

Titanio grado 5



MONCONE GUARIGIONE H 1.5 mm - P.E. 3.8

MONCONE GUARIGIONE H 2.5 mm - P.E. 3.8

MONCONE GUARIGIONE H 3.5 mm - P.E. 3.8

MONCONE GUARIGIONE H 1.5 mm - P.E. 4.5

MONCONE GUARIGIONE H 2.5 mm - P.E. 4.5

MONCONE GUARIGIONE H 3.5 mm - P.E. 4.5

Titanio grado 5



VITE PROTESICA

VITE TRANSFER

VITE PROTESICA D.I.S. e (Esa)

VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)

Titanio grado 5



COMBY CHROME ROTANTE

COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.

Polimetilmetacrilato



DUAL SISTEM ROTANTE - H 0.75 mm

DUAL SISTEM ROTANTE - H 1.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE - H 2.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE - H 3.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 0.75 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 1.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 2.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 3.5 mm

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4



MONCONE CONNEKTOR H 1.5 mm

MONCONE CONNEKTOR H 2.5 mm

MONCONE CONNEKTOR H 3.5 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.5 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.5 mm

MONCONE CONNEKTOR H 6.5 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 139**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

IMPIANTI Ø3.5 - Ø3.75 Ø4.0 - Ø4.5	IMPIANTI Ø5.0 - Ø5.5 Ø6.0
PIATTAFORMA RB	PIATTAFORMA WB
AN5092	AN5105
AN5093	AN5106
AN5094	-
AN5095	-
AN5101	AN5107
AN5102	AN5108
AN5103	-
AN5104	-
SCAN N-R	SCAN W-R
SCAN N	SCAN W
SCAN1099	SCAN1099
AN5600	-
AN5601	-
AN5602	-
AN5603	-
AN5604	-
AN5605	-
AN5114	-
AN5115	-
AN5116	-
AN5117	-
AN5118	-
AN5119	-
AN5120	-
AN5121	-
AN5122	-
AN5123	-
AN5124	-
AN5125	-

	Ø2.9 (SC)	Ø3.3 (NC)	Ø4.1/4.8 (RP)	MULTI-BASE
	N.cm 20	N.cm 32	N.cm 35	N.cm 5
	M 1.6	M 1.6	M 1.6	M 1.4
	TX 6.0	TX 6.0	TX 6.0	TX 6.0

ABUTMENT PROTESI AVVITATA

IMPIANTI Ø3.5 - Ø3.75 Ø4.0 - Ø4.5	IMPIANTI Ø5.0 - Ø5.5 Ø6.0
PIATTAFORMA RB	PIATTAFORMA WB
AN5078	AN5078*
AN5079	AN5079*
AN5080	AN5080*
AN5081	AN5081*
AN5082	AN5082*
AN5083	AN5083*
AN5084	AN5084*
AN5085	AN5085*
AN5086	AN5086*
AN5087	AN5087*
AN5091	AN5091



MULTI-BASE DRITTO H 1.5 mm

MULTI-BASE DRITTO H 2.5 mm

MULTI-BASE DRITTO H 3.5 mm

MULTI-BASE DRITTO H 4.5 mm

Titanio grado 5

* nei diametri WB possono essere utilizzati i diametri minori RB creando platform switching



MULTI-BASE 17° H 3.5 mm

MULTI-BASE 17° H 4.5 mm

MULTI-BASE 17° H 5.5 mm

Titanio grado 5

* nei diametri WB possono essere utilizzati i diametri minori RB creando platform switching



MULTI-BASE 30° H 3.5 mm

MULTI-BASE 30° H 4.5 mm

MULTI-BASE 30° H 5.5 mm

Titanio grado 5



VITE MULTI-BASE ANGOLATO

Titanio grado 5



ANALOGO MULTI-BASE

AN1297

Acciaio



**MONCONE PROVVISORIO
MULTI-BASE**

AN1066

Titanio grado 5



**ANALOGO PROTEZIONE
MULTI-BASE**

AN2275

Acciaio



DUAL SISTEM MULTI-BASE

AN1330

CALCINABILE MULTI-BASE

AN3106

Titanio grado 5

Polimetilmetacrilato



MICROVITE MULTI-BASE

AN5595

VITE TRANSFER MULTI-BASE

AN1254

MICROVITE D.I.S. t (Torx)

AN1884

Titanio grado 5



INTRAORAL SCAN MULTI-BASE

SCAN1084

Titanio grado 4



VITE PROTEZIONE MULTI-BASE H 4.0

AN1708

Titanio grado 5



A. TRANSFER M.U.A. OPEN TRAY

AN1690

B. TRANSFER M.U.A. CLOSED TRAY

AN5145

C. IMPRESSION CAP M.U.A.

TPM2

Titanio grado 5



**MONCONE CALCINABILE
MULTI-BASE**

AN1524

Polimetilmetacrilato



**COMBY CHROME
MULTI-BASE**

AN1341

Lega Cr.Co.

Polimetilmetacrilato



VITE CERATURA SHORT

AN2781

VITE CERATURA LONG

AN2782

Titanio grado 5



SCANBODY MULTI-BASE LAB.

SCAN-M-D

Alluminio Ergal Medicale



**MONCONE CONNETTOR
MULTI-BASE**

AN5285

Titanio grado 5



MONCONE SFERA MULTI-BASE

AN5286

Titanio grado 5

NOTE LEGALI



Straumann®, BLX® marchi registrati da Straumann Holding AG, Svizzera.



Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.



CSerie



		IMPIANTI 4/3mmP IMPIANTI 3.25mmD	IMPIANTI 5/4mmP IMPIANTI 4mmD	IMPIANTI 6/5mmP IMPIANTI 5mmD
		PIATTAFORMA Ø3.4	PIATTAFORMA Ø4.1	PIATTAFORMA Ø5.0
	ANALOGO	AN1405	AN1406	AN1407
	Acciaio			
	TRANSFER OPEN TRAY - LUNGO	AN1408	AN1008	AN1202
	TRANSFER OPEN TRAY - CORTO	-	AN1009	-
	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE - H 1.5 mm	AN1204	AN1203	AN1205
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE - H 1.5 mm	AN1572	AN1635	AN1636
	MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN1393	AN1394	AN1395
	MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	AN1396	AN1397	AN1398
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm - P.E. 3.8	AN1006	-	-
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm - P.E. 5.0	-	AN1390	-
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm - P.E. 6.0	-	-	AN1392
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 4.0 mm - P.E. 3.8	AN1235	-	-
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 4.0 mm - P.E. 5.0	-	AN1391	-
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 4.0 mm - P.E. 6.0	-	-	AN1649
	MONCONE FRESABILE	AN1650	AN1651	AN1652
	MONCONE 15° H 2.0 mm - P.E. 3.8	AN1437	-	-
	MONCONE 15° H 2.0 mm - P.E. 5.0	-	AN1439	AN1441
	MONCONE 15° H 4.0 mm - P.E. 3.8	AN1438	-	-
	MONCONE 15° H 4.0 mm - P.E. 5.0	-	AN1440	AN1442
	MONCONE 25° H 2.0 mm - P.E. 3.8	AN1473	-	-
	MONCONE 25° H 2.0 mm - P.E. 5.0	-	AN1475	-
	MONCONE 25° H 4.0 mm - P.E. 3.8	AN1474	-	-
	MONCONE 25° H 4.0 mm - P.E. 5.0	-	AN1476	-
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 2.0 mm - P.E. 3.8	AN1399	-	-
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 2.0 mm - P.E. 5.0	-	AN1401	-
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 2.0 mm - P.E. 5.6	-	-	1403
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 3.0 mm - P.E. 5.0	-	AN1607	-
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 4.0 mm - P.E. 3.8	AN1400	-	-
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 4.0 mm - P.E. 5.0	-	AN1402	-
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 4.0 mm - P.E. 5.6	-	-	AN1404
	VITE PROTESICA	AN1345	AN1345	AN1345
	VITE PROTESICA TESTA Ø2.25	AN2417	AN2417	AN2417
	VITE TRANSFER CORTA	-	AN1011	-
	VITE TRANSFER LUNGA	AN1662	AN1662	AN1662
	VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3273	AN3273	AN3273
	PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN2952	AN2952	AN2952
				



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

BASE "FOR PRESS" NON ROTANTE

Titanio grado 5

COMBY CHROME ROTANTE

COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato

DUAL SISTEM ROTANTE - H 0.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE - H 1.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE - H 2.5 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 0.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 1.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 2.5 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **C** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"

SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone

INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4

MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 139**

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

IMPIANTI 4/3mmP
IMPIANTI 3.25mmD
**PIATTAFORMA
Ø3.4**

IMPIANTI 5/4mmP
IMPIANTI 4mmD
**PIATTAFORMA
Ø4.1**

IMPIANTI 6/5mmP
IMPIANTI 5mmD
**PIATTAFORMA
Ø5.0**

AN2619

AN2620

-

AN1646

AN1647

AN1648

AN1643

AN1644

AN1645

AN1954

AN1955

AN1956

AN2605

AN2607

AN2609

AN2606

AN2608

AN2610

AN3101

AN3102

AN3103

AN1003

AN1540

AN1005

AN2611

AN2613

AN2615

AN2612

AN2614

AN2616

AN3098

AN3099

AN3100

SCAN N-R

SCAN R-R

SCAN W-R

SCAN N

SCAN R

SCAN W

SCAN1027

SCAN1028

SCAN1028

AN2621

AN2626

-

AN2622

AN2627

-

AN2623

AN2628

-

AN2624

AN2629

-

AN2625

AN2630

-

AN3957 (R)

AN3981 (R)

AN3969 (R)

AN3958 (R)

AN3982 (R)

AN3970 (R)

AN3959 (R)

AN3983 (R)

AN3971 (R)

AN3960 (R)

AN3984 (R)

AN3972 (R)

AN3961 (R)

AN3985 (R)

AN3973 (R)

AN3986 (R)

AN3974 (R)

AN3962 (R)

AN3987 (R)

AN3975 (R)

AN3963 (R)

AN3988 (R)

AN3976 (R)

AN3964 (R)

AN3989 (R)

AN3977 (R)

AN3965 (R)

AN3990 (R)

AN3978 (R)

AN3966 (R)

AN3991 (R)

AN3979 (R)

AN3967 (R)

AN3992 (R)

AN3980 (R)

AN3968 (R)

	Ø3.4 (NP)	Ø4.1 (RP)	Ø5.0 (WP)	M.U.A.
	N.cm 25	N.cm 25	N.cm 25	N.cm 15
	M 1.6	M 1.6	M 1.6	M 1.4
	ES 1.2 mm	ES 1.2 mm	ES 1.2 mm	ES 1.2 mm

Chiavi inserimento m.u.a.



M.U.A. DRIVER for RATCHET **LUNGO ST1106**

M.U.A. DRIVER for RATCHET **CORTO ST1107**




M.U.A. DRIVER ST1001

SERRAGGIO

Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

ABUTMENT PROTESI AVVITATA



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm
M.U.A. DRITTO H 2.0 mm
M.U.A. DRITTO H 3.0 mm
M.U.A. DRITTO H 4.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.0 mm
M.U.A. 17° H 3.0 mm
M.U.A. 17° H 4.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.0 mm
M.U.A. 30° H 4.0 mm

Titanio grado 5



VITE M.U.A. ANGOLATO

Titanio grado 5

IMPIANTI 4/3mmP IMPIANTI 3.25mmD	IMPIANTI 5/4mmP IMPIANTI 4mmD	IMPIANTI 6/5mmP IMPIANTI 5mmD
PIATTAFORMA Ø3.4	PIATTAFORMA Ø4.1	PIATTAFORMA Ø5.0
AN1653	AN1656	AN1660
AN1654	AN1657	AN1661
AN1655	AN1658	AN2442
AN1206	AN1659	-
AN1945	AN1482	-
AN1946	AN1007	-
AN1947	AN1369	-
AN2272	AN1281	-
AN2273	AN1282	-
AN1143	AN1143	AN1143



ANALOGO M.U.A.

Acciaio

AN1604



TRANSFER M.U.A.

Titanio grado 5

AN2098



MONCONE PROVVISORIO M.U.A.

Titanio grado 5

AN2101



MONCONE CALCINABILE M.U.A.

Polimetilmetacrilato

AN2099



MONCONE SALDATURA M.U.A.

Titanio grado 5

AN2777



COMBY CHROME M.U.A.

Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato

AN1157



ANALOGO PROTEZIONE M.U.A.

Acciaio

AN2275



**DUAL SISTEM M.U.A.
CALCINABILE M.U.A.**

Titanio grado 5
Polimetilmetacrilato

AN1156

AN3106



MICROVITE M.U.A.

AN1360

VITE TRANSFER M.U.A.

AN1663

MICROVITE D.I.S. e (Esagono)

AN3290

MICROVITE D.I.S. t (Torx)

AN3894

Titanio grado 5



**VITE CERATURA M.U.A. SHORT
VITE CERATURA M.U.A. LONG**

Titanio grado 5

AN1663

AN2778



INTRAORAL SCAN M.U.A.

Titanio grado 4

SCAN1002



SCANBODY M.U.A.

Alluminio Ergal Mediale

SCAN-M-C




VITE PROTEZIONE M.U.A H 4.0 mm

Titanio grado 5

AN2267

NOTE LEGALI

3i®, 3i® Certain® e Biomet 3i® sono marchi registrati da Biomet 3i LLC Ltd.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

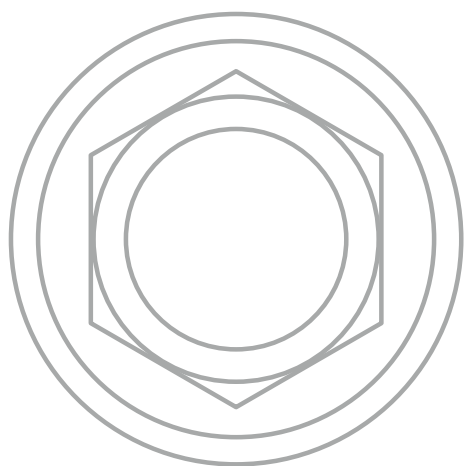

CI Serie



IMPIANTI 3.8mm
IMPIANTI 4.4mm
IMPIANTI 5.0mm

PIATTAFORMA
Ø4.0




ANALOGO
Acciaio

AN4717



VITE PROTESICA
VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)
PROTESICA D.I.S. t (Torx)
Titanio grado 5

AN4722
AN4723
AN4724



DUAL SISTEM ROTANTE H 0.8 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 2.0 mm
CALCINABILE ROTANTE
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.8 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.0 mm
CALCINABILE NON ROTANTE

AN4718
AN4719
AN3101
AN4720
AN4721
AN3098

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE
SCANBODY NON ROTANTE
Poli-Eter-Eter-Chetone

SCAN N-R
SCAN N



INTRAORAL SCAN
Titanio grado 4

SCAN1098



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

AN4704 (R)
AN4705 (R)
AN4706 (R)
AN4707 (R)
AN4708 (R)
AN4709 (R)

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm


AN4710 (R)
AN4711 (R)
AN4712 (R)
AN4713 (R)
AN4714 (R)
AN4715 (R)
AN4716 (R)

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

	Ø4.0
	N.cm 30
	M 1.6
	ESAGONO

NOTE LEGALI

Megagen® Anyridge® è un marchio registrato da MegaGen Implant Co., Ltd. 377-2, Kyochon-Ri, Jain-Myun, Gyeong-san - Gyeongbuk 712-852 Korea.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

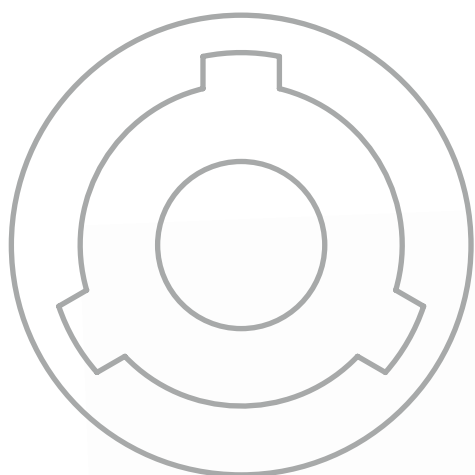

CLSerie





ANALOGO

Acciaio

MONCONE PROVVISORIO ROTANTE - H 1.5 mm

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE - H 1.5 mm

Titanio grado 5

MONCONE CALCINABILE ROTANTE

MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

Polimetilmetacrilato

MONCONE FRESABILE

Titanio grado 5

VITE PROTESICA

Titanio grado 5

DUAL SISTEM ROTANTE - H 0.5 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 0.5 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"

SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone

INTRAORAL SCAN BODY

Titanio grado 4

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**


IMPIANTI Ø3.8	IMPIANTI Ø4.3	IMPIANTI Ø5.0
PIATTAFORMA Ø3.8	PIATTAFORMA Ø4.3	PIATTAFORMA Ø5.0
AN2352	AN2353	AN2354
AN2641	AN2642	-
AN2643	AN2644	-
AN2355	AN2356	-
AN2645	AN2646	-
AN2357	AN2647	-
AN2649	AN2649	AN2650
AN2358	AN2359	AN2360
AN3101	AN3102	AN3103
AN2651	AN2652	AN2653
AN3098	AN3099	AN3100
PIAZZA VITE. Pentagonale K		
SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN W-R
SCAN N	SCAN R	SCAN W
SCAN 1030	SCAN 1031	SCAN 1032
AN4005 (R)	AN4017 (R)	AN3993 (R)
AN4006 (R)	AN4018 (R)	AN3994 (R)
AN4007 (R)	AN4019 (R)	AN3995 (R)
AN4008 (R)	AN4020 (R)	AN3996 (R)
AN4009 (R)	AN4021 (R)	AN3997 (R)
AN3998 (R)	AN4022 (R)	AN4010 (R)
AN3999 (R)	AN4023 (R)	AN4011 (R)
AN4000 (R)	AN4024 (R)	AN4012 (R)
AN4001 (R)	AN4025 (R)	AN4013 (R)
AN4002 (R)	AN4026 (R)	AN4014 (R)
AN4003 (R)	AN4027 (R)	AN4015 (R)
AN4004 (R)	AN4028 (R)	AN4016 (R)

	Ø3.8 (SD)	Ø4.3 (RD)	Ø5.0 (WD)
	N.cm 25	N.cm 25	N.cm 25
	M 1.6	M 1.6	M 2.0
	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm

NOTE LEGALI

Camlog® è un marchio registrato da Camlog Biotechnologies AG, Germania.

Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

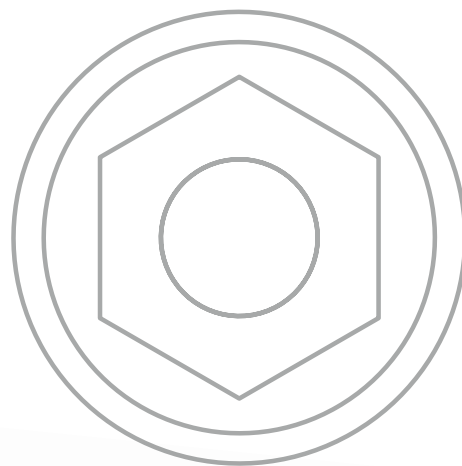

CXSerie
compatibile MEDENTIS ICX®

PIATTAFORMA
Ø4.0



ANALOGO

Acciaio

AN4669



VITE PROTESICA

AN4676


VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)

AN4680

PROTESICA D.I.S. t (Torx)

AN4681

Titanio grado 5



DUAL SISTEM ROTANTE H 0.75 mm

AN4670

DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm

AN4671

DUAL SISTEM ROTANTE H 2.5 mm

AN4682

CALCINABILE ROTANTE

AN3101

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.75 mm

AN4672

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm

AN4673

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.5 mm

AN4683

CALCINABILE NON ROTANTE

AN3098

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCAN N-R

SCANBODY NON ROTANTE

SCAN N

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN

SCAN1071

Titanio grado 4



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

AN4684 (R)

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

AN4685 (R)

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

AN4686 (R)

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

AN4687 (R)

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

AN4688 (R)

MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

AN4689 (R)

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

AN4690 (R)

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

AN4691 (R)

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

AN4692 (R)

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

AN4693 (R)

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

AN4694 (R)

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

AN4695 (R)

MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

AN4696 (R)


Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

	Ø4.0	M.U.A.
	N.cm 30	N.cm 15
	M 1.8	M 1.4
	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm

NOTE LEGALI


Medentis® ICX® - Medentis Medical GmbH, Walporzheimer Str. 48-52, 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler, GERMANY


Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

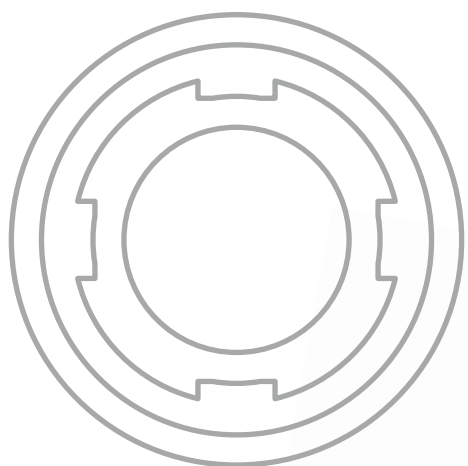

D Serie



		IMPIANTI Ø2.9	IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø4.1	IMPIANTI Ø4.8
		PIATTAFORMA SC	PIATTAFORMA NC	PIATTAFORMA RC	PIATTAFORMA RC
	ANALOGO	AN1146	AN1245	AN1388	AN1388
	Acciaio				
	TRANSFER OPEN TRAY	AN1800	AN1691	AN1692	AN1692
	TRANSFER ROTANTE	-	AN2114	AN2115	AN2115
	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE - H 1.5 mm	AN1864	AN1154	AN1151	AN1151
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE - H 1.5 mm	AN1865	AN1153	AN1150	AN1150
	MONCONE CALCINABILE ROTANTE	-	AN1576	AN1479	AN1479
	MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	-	AN1577	AN1480	AN1480
	MONCONE DRITTO H 2.0 mm - P.E. 4.0	-	AN1459	-	-
	MONCONE DRITTO H 2.0 mm - P.E. 5.0	-	-	AN1461	AN1461
	MONCONE DRITTO H 3.5 mm - P.E. 4.0	-	AN1460	-	-
	MONCONE DRITTO H 3.5 mm - P.E. 5.0	-	-	AN1462	AN1462
	MONCONE FRESABILE	-	AN1470	AN1471	AN1471
	Titanio grado 5				
	MONCONE 15° H 3.5 mm - P.E. 4.0 versione "A"	-	AN1464	-	-
	MONCONE 15° H 3.5 mm - P.E. 4.0 versione "B"	-	AN1535	-	-
	MONCONE 15° H 3.5 mm - P.E. 5.0 versione "A"	-	-	AN1463	AN1463
	MONCONE 15° H 3.5 mm - P.E. 5.0 versione "B"	-	-	AN1466	AN1466
	MONCONE 25° H 3.5 mm - P.E. 4.0 versione "A"	-	AN1610	-	-
	MONCONE 25° H 3.5 mm - P.E. 4.0 versione "B"	-	AN1611	-	-
	MONCONE 25° H 3.5 mm - P.E. 5.0 versione "A"	-	-	AN1472	AN1472
	MONCONE 25° H 3.5 mm - P.E. 5.0 versione "B"	-	-	N1481	N1481
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 2.0 mm	AN1871	-	-	-
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 2.0 mm - P.E. 4.5	-	AN1702	AN1704	AN1704
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 2.0 mm- P.E. 5.5	-	-	AN2537	AN2537
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 3.5 mm	AN1872	-	-	-
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 4.0 mm- P.E. 4.5	-	AN1706	AN1707	AN1707
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 4.0 mm- P.E. 5.5	-	-	AN2538	AN2538
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 5.0 mm	AN1873	-	-	-
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 6.0 mm- P.E. 4.5	-	AN1710	AN1711	AN1711
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 6.0 mm- P.E. 5.5	-	-	AN2539	AN2539
	VITE COPERTURA IMPIANTO	-	AN2524	AN2523	AN2523
	VITE PROTESICA	AN1866	AN1239	AN1239	AN1239
	VITE TRANSFER	AN1881	AN1713	AN1713	AN1713
	VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN2930	AN3230	AN3230	AN3230
	VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN2451	AN2455	AN2455	AN2455
	Titanio grado 5				



DUAL SISTEM ROTANTE - H 1.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE - H 2.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE - H 3.5 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 1.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 2.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 3.5 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



COMBY CHROME ROTANTE

COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.

Polimetilmetacrilato



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 139**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

IMPIANTI Ø2.9	IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø4.1	IMPIANTI Ø4.8
PIATTAFORMA SC	PIATTAFORMA NC	PIATTAFORMA RC	PIATTAFORMA RC
AN2025	AN1976	AN1977	AN1977
AN2026	AN2821	AN2825	AN2825
AN2027	AN2822	AN2826	AN2826
AN5526	AN3101	AN3101	AN3101
AN2028	AN1106	AN1116	AN1116
AN2030	AN2823	AN2827	AN2827
AN2031	AN2824	AN2828	AN2828
AN5526	AN3098	AN3098	AN3098
SCAN1029	SCAN1009	SCAN1010	SCAN1010
SCAN S-R	SCAN N-R	SCAN N-R	SCAN N-R
SCAN S	SCAN N	SCAN N	SCAN N
-	AN1698	AN1700	AN1700
-	AN1697	AN1699	AN1699
-	AN2833	AN2838	AN2838
-	AN2834	AN2839	AN2839
-	AN2835	AN2840	AN2840
-	AN2836	AN2841	AN2841
-	AN2837	AN2842	AN2842
AN4029 (R)	AN4040 (R)	AN4051 (R)	AN4051 (R)
AN4030 (R)	AN4041 (R)	AN4052 (R)	AN4052 (R)
AN4031 (R)	AN4042 (R)	AN4053 (R)	AN4053 (R)
AN4032 (R)	AN4043 (R)	AN4054 (R)	AN4054 (R)
AN4033 (R)	AN4044 (R)	AN4055 (R)	AN4055 (R)
AN4697 (R)	AN4034 (R)	AN4045 (R)	AN4045 (R)
AN4698 (R)	AN4035 (R)	AN4046 (R)	AN4046 (R)
AN4699 (R)	AN4036 (R)	AN4047 (R)	AN4047 (R)
AN4700 (R)	AN4037 (R)	AN4048 (R)	AN4048 (R)
AN4701 (R)	AN4038 (R)	AN4049 (R)	AN4049 (R)
AN4702 (R)	AN4039 (R)	AN4050 (R)	AN4050 (R)

	Ø2.9 (SC)	Ø3.3 (NC)	Ø4.1/4.8 (RP)	MULTI-BASE
	N.cm 20	N.cm 32	N.cm 35	N.cm 5
	M 1.6	M 1.6	M 1.6	M 1.4
	TX 6.0	TX 6.0	TX 6.0	TX 6.0

ABUTMENT PROTESI AVVITATA



MULTI-BASE DRITTO H 1.0 mm

MULTI-BASE DRITTO H 2.5 mm

MULTI-BASE DRITTO H 4.0 mm

Titanio grado 5



VERSIONE A



VERSIONE B

MULTI-BASE 17° H 2.5 mm - Versione "A"

MULTI-BASE 17° H 2.5 mm - Versione "B"

MULTI-BASE 17° H 4.0 mm - Versione "A"

MULTI-BASE 17° H 4.0 mm - Versione "B"

Titanio grado 5



VERSIONE A



VERSIONE B

MULTI-BASE 30° H 3.5 mm - Versione "A"

MULTI-BASE 30° H 3.5 mm - Versione "B"

MULTI-BASE 30° H 4.5 mm - Versione "A"

MULTI-BASE 30° H 4.5 mm - Versione "B"

Titanio grado 5



VITE MULTI-BASE ANGOLATO

Titanio grado 5

IMPIANTI Ø2.9	IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø4.1	IMPIANTI Ø4.8
PIATTAFORMA SC	PIATTAFORMA NC	PIATTAFORMA RC	PIATTAFORMA RC
-	AN1287	AN1293	AN1293
-	AN1701	AN1703	AN1703
-	AN1693	AN1695	AN1695
-	AN1182	AN1714	AN1714
-	AN1183	AN1715	AN1715
-	AN1184	AN1716	AN1716
-	AN1185	AN1717	AN1717
-	AN1718	AN1289	AN1289
-	AN1719	AN1290	AN1290
-	AN1299	AN1291	AN1291
-	AN1300	AN1292	AN1292
-	AN1689	AN1689	AN1689



ANALOGO MULTI-BASE

Acciaio

AN1297



TRANSFER MULTI-BASE

Titanio grado 5

AN1690



**MONCONE PROVVISORIO
MULTI-BASE**

Titanio grado 5

AN1066



**MONCONE CALCINABILE
MULTI-BASE**

Polimetilmetacrilato

AN1524



**DUAL SISTEM MULTI-BASE
CALCINABILE MULTI-BASE**

Titanio grado 5
Polimetilmetacrilato

AN1330

AN3106



**COMBY CHROME
MULTI-BASE**

Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato

AN1341



MICROVITE MULTI-BASE

AN5595

TRANSFER MULTI-BASE

AN1254

MICROVITE D.I.S. e (Esagono) MULTI-BASE

AN1875

MICROVITE D.I.S. t (Torx) MULTI-BASE

AN1884

Titanio grado 5



VITE CERATURA SHORT

AN2781

VITE CERATURA LONG

AN2782

Titanio grado 5



INTRAORAL SCAN MULTI-BASE

SCAN1084

Titanio grado 4



SCANBODY MULTI-BASE LAB.

SCAN-M-D

Alluminio Ergal Mediale



VITE PROTEZIONE MULTI-BASE H 4.0 mm


AN1708

Titanio grado 5


NOTE LEGALI

ITI®, Straumann®, Bone Level® marchi registrati da Straumann Holding AG, Svizzera.

Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

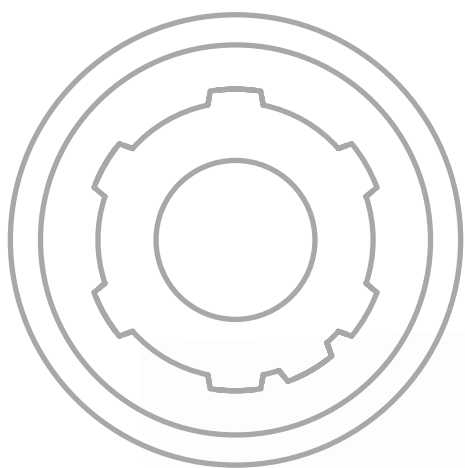

EVSerie

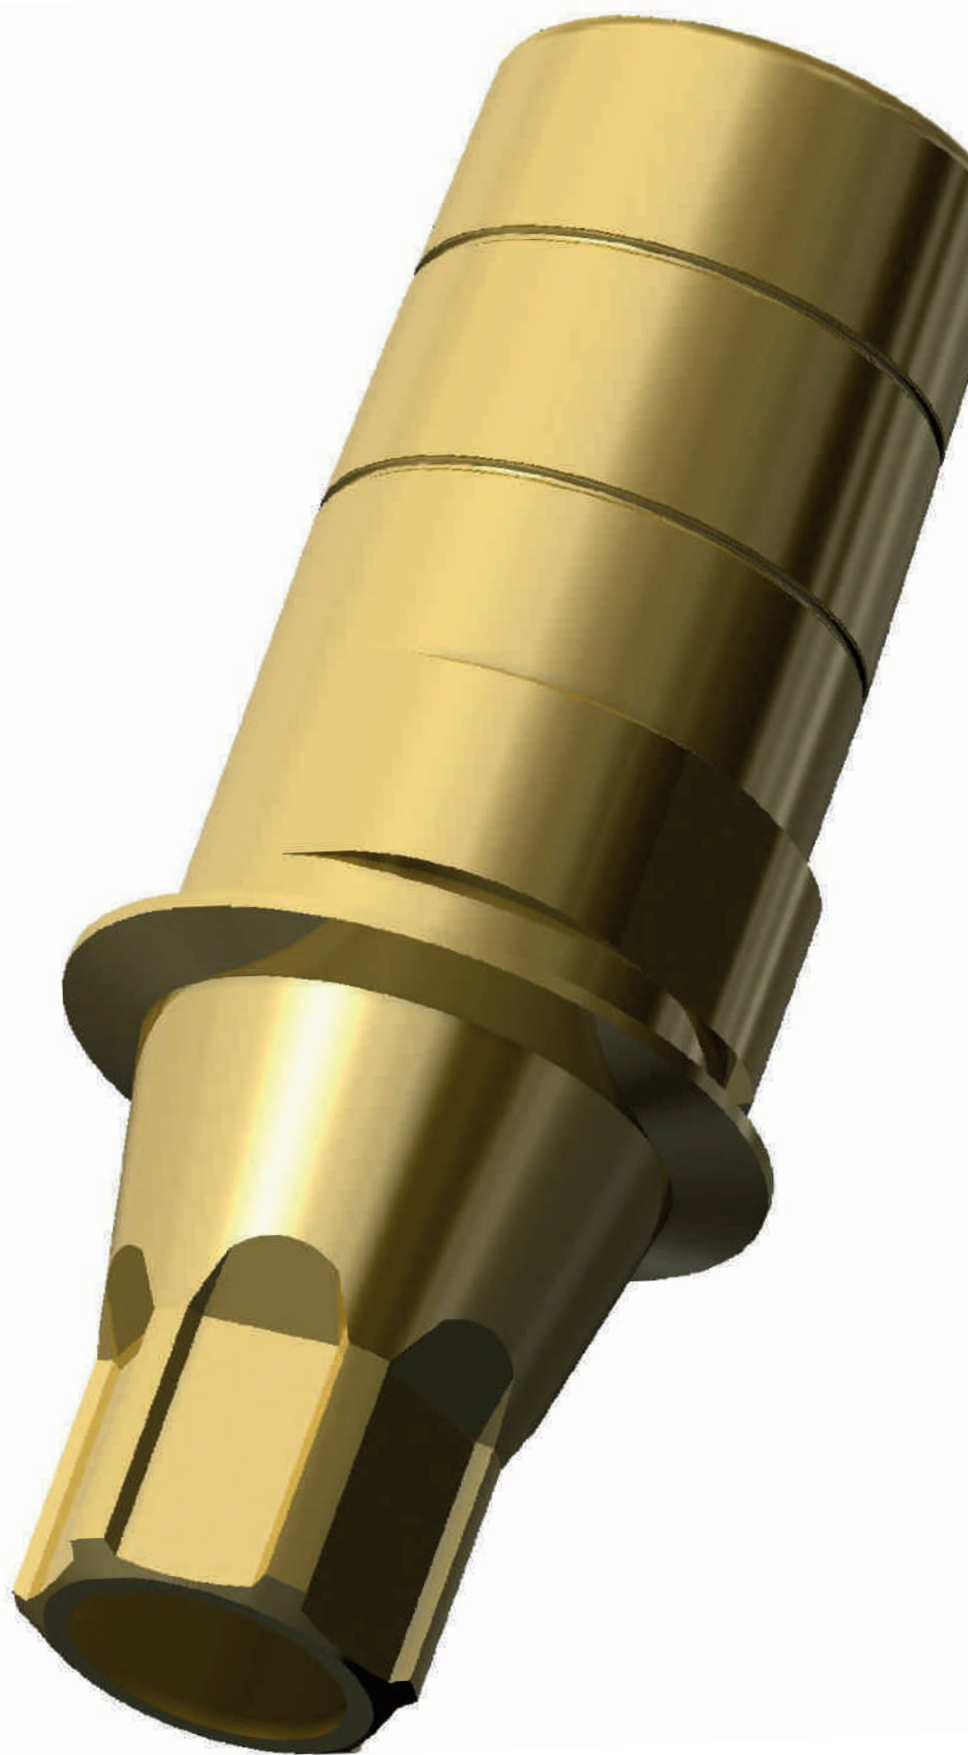



ANALOGO
Acciaio

IMPIANTI
Ø3.6

PIATTAFORMA
Ø3.6

AN3648

IMPIANTI
Ø4.2

PIATTAFORMA
Ø4.2

AN3649

IMPIANTI
Ø4.8

PIATTAFORMA
Ø4.8

AN3376




TRANSFER OPEN TRAY
Titanio grado 5

AN3630

ANN3631

AN3632



MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm
MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm
Titanio grado 5

AN2159

AN2164

AN2170

AN2160

AN2165

AN2171



MONCONE CALCINABILE ROTANTE
Polimetilmetacrilato

AN4951

AN4952

AN4953



VITE PROTESICA
VITE TRANSFER OPEN TRAY
VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)
VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)
Titanio grado 5

AN3214

AN3215

AN3633

AN1201

AN1043

AN1627

AN5287

AN5288

AN5289

AN5290

AN5291

AN5292



SIRONA CEREC I-BASE H 1.0mm
SIRONA CEREC I-BASE H 2.0mm
Titanio grado 5

AN2931

AN2037

AN2039

AN2932

AN2038

AN2045



COMBY CHROME ROTANTE
COMBY CHROME NON ROTANTE
Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato

AN5530

AN5531

AN5532

AN5533

AN5534

AN5535



DUAL SISTEM ROTANTE H 0,75 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 2.5 mm
CALCINABILE ROTANTE
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.75 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.5 mm
CALCINABILE NON ROTANTE
Titanio grado 5

AN3208

AN3218

AN3627

AN3209

AN3219

AN3629

AN3638

AN2951

-

AN3101

AN3101

AN3102

AN3206

AN3216

AN3626

AN3207

AN3217

AN3628

AN3637

AN3642

-

AN3098

AN3098

AN3099

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE
SCANBODY NON ROTANTE
Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN
Titanio grado 4



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA H 2.0 mm
MONCONE SFERA H 3.0 mm
MONCONE SFERA H 4.0 mm
MONCONE SFERA H 5.0 mm
MONCONE SFERA H 6.0 mm
Titanio grado 5 *Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN*



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm
Titanio grado 5 *Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE*

IMPIANTI Ø3.6	IMPIANTI Ø4.2	IMPIANTI Ø4.8
PIATTAFORMA Ø3.6	PIATTAFORMA Ø4.2	PIATTAFORMA Ø4.8
SCAN N-R	SCAN N-R	SCAN R-R
SCAN N	SCAN N	SCAN R
SCAN1067	SCAN1068	SCAN1069
AN4084 (R)	AN4073 (R)	AN4062 (R)
AN4085 (R)	AN4074 (R)	AN4063 (R)
AN4086 (R)	AN4075 (R)	AN4064 (R)
AN4087 (R)	AN4076 (R)	AN4065 (R)
AN4088 (R)	AN4077 (R)	AN4066 (R)
AN4067 (R)	AN4056 (R)	AN4078 (R)
AN4068 (R)	AN4057 (R)	AN4079 (R)
AN4069 (R)	AN4058 (R)	AN4080 (R)
AN4070 (R)	AN4059 (R)	AN4081 (R)
AN4071 (R)	AN4060 (R)	AN4082 (R)
AN4072 (R)	AN4061 (R)	AN4083 (R)

	Ø3.6	Ø4.2	Ø4.8	UNI 33°	SMART FIX
	N. cm 20	N. cm 25	N. cm 32	N. cm 15	N. cm 15
	M 1.6	M 1.8	M 2.0	M 1.8	M 1.4
	Es 1.27 mm	Es 1.27 mm	Es 1.27 mm	Es 1.27 mm	Es 1.27 mm

Chiavi inserimento Multi Base



M.U.A. DRIVER for RATCHET LONG ST1106

M.U.A. DRIVER for RATCHET SHORT ST1107



M.U.A. DRIVER ST1001

SERRAGGIO
Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

COMPONENTISTICA PER PROTESI AVVITATA




UNI 33° H 2.0 mm

UNI 33° H 3.0 mm

UNI 33° H 4.0 mm

Titanio grado 5



MULTIBASE DRITTO H 1.5 mm

MULTIBASE DRITTO H 2.5 mm

MULTIBASE DRITTO H 3.5 mm

Titanio grado 5



SMARTFIX 17° H 2.5 mm

SMARTFIX 17° H 3.5 mm

Titanio grado 5



SMARTFIX 30° H 3.5 mm

SMARTFIX 30° H 4.5 mm

Titanio grado 5



VITE MULTIBASE ANGOLATO H 1.6 mm

VITE MULTIBASE ANGOLATO H 1.8 mm

VITE MULTIBASE ANGOLATO H 2.0 mm

Titanio grado 5



A. ANALOGO M.U.A.

AN1604

B. ANALOGO UNI 33°

AN1538

Acciaio



A. MONCONE PROVVISORIO M.U.A.

AN1371

B. MONCONE PROVVISORIO UNI 33°

AN3647

Titanio grado 5



MONCONE SALDATURA SMARTFIX

AN2774

MONCONE SALDATURA UNI 33°

AN3308

Titanio grado 5



ANALOGO PROTEZIONE M.U.A.

AN2275

Acciaio



SCANBODY M.U.A.

SCAN-M-A

SCANBODY UNI 33°

SCAN-U-33

Alluminio Ergal Mediale



MICROVITE M.U.A.

AN1274

VITE TRANSFER M.U.A.

AN1423

MICROVITE UNI 33°

AN3358

VITE TRANSFER UNI 33°

AN3307

MICROVITE MULTIUNIT D.I.S. e (Esagono)

AN3290

MICROVITE MULTIUNIT D.I.S. t (Torx)

AN3894

MICROVITE UNI 33° D.I.S. e (Esagono)

AN2149

MICROVITE UNI 33° D.I.S. t (Torx)

AN2152

Titanio grado 5



VITE PROTEZIONE M.U.A.

AN1258

VITE PROTEZIONE UNI 33°

AN2146

Titanio grado 5

IMPIANTI Ø3.6	IMPIANTI Ø4.2	IMPIANTI Ø4.8
PIATTAFORMA Ø3.6	PIATTAFORMA Ø4.2	PIATTAFORMA Ø4.8
AN3634 (R)	AN3639 (R)	AN3643 (R)
AN3635 (R)	AN3640 (R)	AN3644 (R)
AN3636 (R)	AN3641 (R)	AN3645 (R)
AN2046	AN2058	AN2061
AN2047	AN2059	AN2062
AN2048	AN2060	AN2069
AN2071 (R)	AN2096 (R)	-
AN2072 (R)	AN2097 (R)	-
AN2086 (R)	AN2157 (R)	-
AN2087 (R)	AN2158 (R)	-
AN2192	-	-
-	AN1720	-
-	-	-



A. TRANSFER M.U.A.

AN1722

B. TRANSFER UNI 33°

AN3646

Titanio grado 5



A. MONCONE CALCINABILE M.U.A.

AN1216

B. MONCONE CALCINABILE UNI 33°

AN2083

Polimetilmetacrilato



COMBY CHROME M.U.A.

AN2317

COMBY CHROME UNI 33°

AN2127

Lega Cr.Co.

Polimetilmetacrilato



I-SCAN M.U.A.

SCAN1001

I-SCAN UNI 33°

SCAN1081

Titanio grado 4



DUAL SISTEM M.U.A.

AN1337

DUAL SISTEM UNI 33°

AN3414

CALCINABILE M.U.A.

AN3106

CALCINABILE UNI 33°

AN3102

Titanio grado 5

Polimetilmetacrilato



VITE SHORT MULTIBASE

AN1723

VITE LONG MULTIBASE


AN2776

Titanio grado 5

NOTE LEGALI

Astra® è un marchio registrato da Dentsply International Inc., USA.


Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

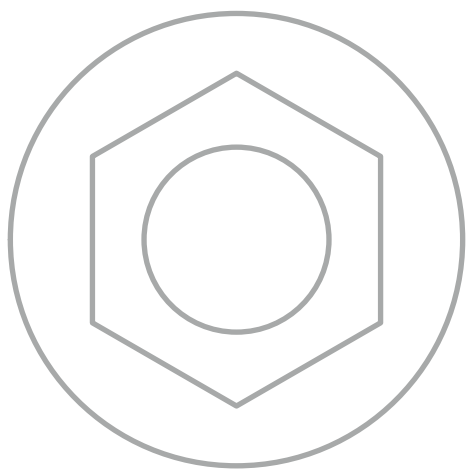

FXSerie



		IMPIANTI Ø3.4	IMPIANTI Ø3.8	IMPIANTI Ø4.5
		PIATTAFORMA SILVER	PIATTAFORMA YELLOW	PIATTAFORMA BLUE
	ANALOGO	AN1802	AN2032	AN2033
	Acciaio			
	TRANSFER OPEN TRAY	AN2361	AN2362	AN1014
	Titanio grado 5			
	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN2363	AN2364	AN1059
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm	AN1060	AN1061	AN1063
	MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN1052	AN1053	AN1064
	MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	AN2014	AN2013	AN2012
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm	AN1513	AN1514	AN1522
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 4.0 mm	AN1523	AN1525	AN1526
	MONCONE FRESABILE	AN2015	AN2016	AN2017
	Titanio grado 5			
	MONCONE 15° - H 2.0 mm	AN1517	AN1515	AN1520
	MONCONE 15° - H 4.0 mm	AN1518	AN1516	AN1521
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 2.0 mm	AN2298	AN2301	AN2304
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 3.0 mm	AN2299	AN2302	AN2305
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 5.0 mm	AN2300	AN2303	AN2306
	Titanio grado 5			
	VITE PROTESICA	AN1351	AN1351	AN1351
	VITE TRANSFER	AN1327	AN1327	AN1327
	VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3341	AN3341	AN3341
	VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN2191	AN2191	AN2191
	SIRONA CEREC I-BASE H 0.3 mm	AN3187	AN3185	AN3192
	SIRONA CEREC I-BASE H 1.5 mm	AN3191	AN3186	AN3193
	BASE "FOR PRESS" ROTANTE	AN2849 (E)	AN2850 (E)	AN2851 (E)
	BASE "FOR PRESS" NON ROTANTE	AN2852 (E)	AN2853 (E)	AN2854 (E)
	Titanio grado 5			



COMBY CHROME ROTANTE
COMBY CHROME NON ROTANTE
Lega Cr.Co.



DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm
CALCINABILE ROTANTE
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm
CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE
SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone




INTRAORAL SCAN



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 139**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

IMPLANTS Ø3.4	IMPLANTS Ø3.8	IMPLANTS Ø4.5
PLATFORM SILVER	PLATFORM YELLOW	PLATFORM BLUE
AN1630	AN1240	AN1971
AN1435	AN2153	AN2154
AN1968	AN1969	AN1970
AN2846	AN2847	AN2848
AN3101	AN3101	AN3102
AN1432	AN1433	AN1434
AN2843	AN2844	AN2845
AN3098	AN3098	AN3099
SCAN N-R	SCAN N-R	SCAN R-R
SCAN N	SCAN N	SCAN R
SCAN1033	SCAN1034	SCAN1035
AN2855	AN2860	AN2865
AN2856	AN2861	AN2866
AN2857	AN2862	AN2867
AN2858	AN2863	AN2868
AN2859	AN2864	AN2869
AN4109 (R)	AN4096 (R)	AN4122 (R)
AN4110 (R)	AN4097 (R)	AN4123 (R)
AN4111 (R)	AN4098 (R)	AN4124 (R)
AN4112 (R)	AN4099 (R)	AN4125 (R)
AN4113 (R)	AN4100 (R)	AN4126 (R)
AN4114 (R)	AN4101 (R)	AN4127 (R)
AN4089 (R)	AN4115 (R)	AN4102 (R)
AN4090 (R)	AN4116 (R)	AN4103 (R)
AN4091 (R)	AN4117 (R)	AN4104 (R)
AN4092 (R)	AN4118 (R)	AN4105 (R)
AN4093 (R)	AN4119 (R)	AN4106 (R)
AN4094 (R)	AN4120 (R)	AN4107 (R)
AN4095 (R)	AN4121 (R)	AN4108 (R)

	Ø 3.4	Ø 3.8	Ø 4.5	MP	M.U.A.
	N.CM 25	N.CM 25	N.CM 25	N.CM 25	N.CM 15
	M1.6	M1.6	M1.6	M1.6	M1.4
	ES 2.2 MM	ES 2.5 MM	ES 2.5 MM	-	-

Chiavi inserimento m.u.a.



M.U.A. DRIVER for RATCHET LONG ST1106

M.U.A. DRIVER for RATCHET SHORT ST1107




M.U.A. DRIVER ST1001

SERRAGGIO

Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.

Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

ABUTMENT PROTESI AVVITATA



MONCONE M.U.A. DRITTO H 1.0 mm
MONCONE M.U.A. DRITTO H 2.0 mm
MONCONE M.U.A. DRITTO H 3.0 mm
MONCONE M.U.A. DRITTO H 5.0 mm

Titanio grado 5



MONCONE M.U.A. 17° H 2.0 mm
MONCONE M.U.A. 17° H 3.0 mm

Titanio grado 5



MONCONE M.U.A. 30° H 3.0 mm
MONCONE M.U.A. 30° H 4.0 mm

Titanio grado 5

IMPLANTS Ø3.4	IMPLANTS Ø3.8	IMPLANTS Ø4.5
PLATFORM SILVER	PLATFORM YELLOW	PLATFORM BLUE
AN2034	AN2205	AN2209
AN2035	AN2206	AN2210
AN2203	AN2207	AN2211
AN2204	AN2208	-
AN5046 (R)	AN5050 (R)	AN5054 (R)
AN5047 (R)	AN5051 (R)	AN5055 (R)
AN5048 (R)	AN5052 (R)	AN5056 (R)
AN5049 (R)	AN5053 (R)	AN5057 (R)



A



B

A. ANALOGO M.U.A. AN1604
B. M.P. Ø 3.4/3.8 AN1487
B. MP Ø 4.5 AN1488

Acciaio



TRANSFER M.U.A. AN2098
 Titanio grado 5



A



B

A. MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN1226
B. M.P. Ø 3.4/3.8 AN1361
B. MP Ø 4.5 AN1352

Titanio grado 5



A

B

A. CALCINABILE M.U.A. AN2099
B. CALCINABILE M.P. AN1045
 Polimetilmetacrilato



A



B

A. MONCONE M.U.A.SALDATURA AN2777
B. M.P. Ø 3.4/3.8 AN1001
B. MP Ø 4.5 AN1002

Titanio grado 5



COMBY CHROME M.U.A. AN1157
 Lega Cr.Co.
 Polimetilmetacrilato



DUAL SISTEM M.U.A. AN1156
CALCINABILE M.U.A. AN3106

Titanio grado 5
 Polimetilmetacrilato



VITE CERATURA M.U.A. CORTA AN1663
VITE CERATURA M.U.A. LUNGA AN2778
 Titanio grado 5



SCANBODY M.U.A. SCAN-M-FX
SCANBODY M.P. SCAN-M-P

Alluminio ergal medicale



A.

B.

MONCONE SFERA TG/MP
A. H 3.0 mm AN1100
B. H 5.0 mm AN2036
 Titanio grado 5



I-SCAN M.U.A. SCAN1002
I-SCAN M.P. SCAN1088
 Titanio grado 4



MICROVITE M.U.A. AN1360
VITE TRANSFER M.U.A. AN1663
MICROVITE M.P. AN1348
MICROVITE D.I.S. e (Esagono) AN3290
MICROVITE D.I.S. t (Torx) AN3894
MICROVITE D.I.S. M.P. e (Esagono) AN2193
MICROVITE D.I.S. M.P. t (Torx) AN2188

Titanio grado 5




VITE PROTEZIONE M.U.A. H 4.0 mm AN2267
 Titanio grado 5



ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. H 4.0 mm AN2275
 Titanio grado 5

NOTE LEGALI

Ankylos®, Friallit® and XIVE® sono un marchi registrati da Dentsply® International Inc., USA.
 Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

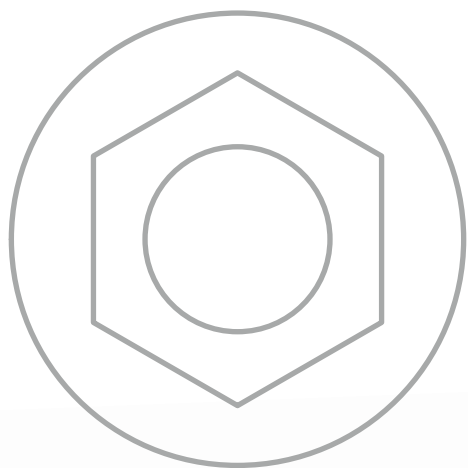

I Serie

compatibile **IDI EVOLUTION®**





ANALOGO

Acciaio

IMPIANTI
Ø3.75
Ø4.0

PIATTAFORMA

Ø4.0

AN3147

TRANSFER OPEN TRAY

Titanio grado 5

AN2405

MONCONE PROVVISORIO ROTANTE - H 1.5 mm

AN3149

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE - H 1.5 mm

AN3148

Titanio grado 5

MONCONE CALCINABILE ROTANTE

AN3150

MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

AN3151

Polimetilmetacrilato

MONCONE FRESABILE CILINDRICO P.E. 4.2

AN2540

Titanio grado 5

MONCONE 15° H 2.0 mm - P.E. 4.5

AN3334

MONCONE 15° H 4.0 mm - P.E. 4.5

AN3718

Titanio grado 5

VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 4.0

AN2424

VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 4.0

AN2425

VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 4.0

AN2426

VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 5.0

AN2427

VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 5.0

AN2428

VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 5.0

AN2429

Titanio grado 5

VITE PROTESICA

AN2321

VITE TRANSFER

AN2403

VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)

AN3717

VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)

AN2182

Titanio grado 5

DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm

AN4811

DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm

AN3715

CALCINABILE ROTANTE

AN3101

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm

AN3333

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm

AN3716

CALCINABILE NON ROTANTE

AN3098

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"

I-BASE

AN3312

Titanio grado 5

SCANBODY ROTANTE

SCAN N-R

SCANBODY NON ROTANTE

SCAN N

Poli-Eter-Eter-Chetone

INTRAORAL SCAN

SCAN1036

Titanio grado 4

	Ø 3.8 (SD)	Ø 4.3 (RD)	Ø 3.8 (WD)
	N.CM 25	N.CM 25	N.CM 25
	M 1.6	M 1.6	M 1.8
	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm

ABUTMENT PROTESI AVVITATA



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**

IMPIANTI
Ø3.75
Ø4.0

PIATTAFORMA
Ø4.0

AN4135 (R)
AN4136 (R)
AN4137 (R)
AN4138 (R)
AN4139 (R)
AN4140 (R)




SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

AN4128 (R)
AN4129 (R)
AN4130 (R)
AN4131 (R)
AN4132 (R)
AN4133 (R)
AN4134 (R)



MULTI UNIT DRITTO H 1.0 mm
MULTI UNIT DRITTO H 2.0 mm
MULTI UNIT DRITTO H 3.0 mm

Titanio grado 5

AN2320
AN2324
AN2328



MULTI UNIT 17° H 2.5 mm

Titanio grado 5

AN2322



MULTI UNIT 30° H 3.5 mm

Titanio grado 5

AN2323



VITE MULTI UNIT ANGOLATO

Titanio grado 5

AN2321



ANALOGO MULTI UNIT

Acciaio

AN1257



TRANSFER MULTI UNIT

Titanio grado 5

AN1307



**MONCONE PROVVISORIO
MULTI UNIT**

Titanio grado 5

AN3297



**MONCONE CALCINABILE
MULTI UNIT**

Polimetilmetacrilato

AN3292



**MONCONE SALDATURA
MULTI UNIT**

Titanio grado 5

AN3353



**COMBY CHROME
MULTI UNIT**

Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato

AN1828



**VITE PROTEZIONE
MULTI UNIT** H 4.0 mm

Titanio grado 5

AN2325



MICROVITE MULTI UNIT
VITE TRANSFER MULTI UNIT
VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)
VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)

Titanio grado 5

AN2330
AN2536
AN3719
AN2183



**DUAL SISTEM MULTI UNIT
CALCINABILE MULTI UNIT**

Titanio grado 5
Polimetilmetacrilato

AN2329
AN3106



INTRAORAL SCAN MULTI UNIT

Titanio grado 4

SCAN 1086




**SCANBODY
MULTI UNIT**

Alluminio Ergal Medicafe

SCAN-M-I

NOTE LEGALI

IDI Evolution® è un marchio registrato da IDI Evolution® Srl, Italia.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali, Anteea S.r.l.

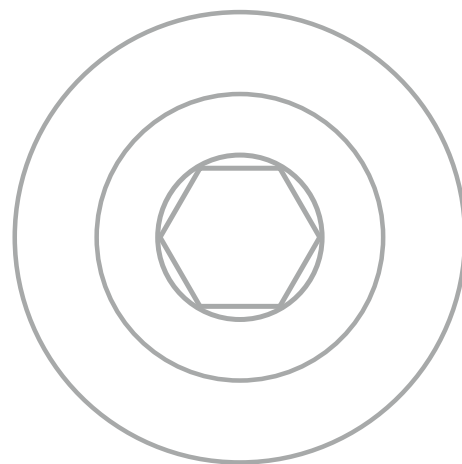

LESerie
compatibile **LEONE®**



ANALOGO
Acciaio

IMPIANTI
Ø3.3

PIATTAFORMA
Ø3.3

AN1859

IMPIANTI
Ø4.1/4.8

PIATTAFORMA
Ø4.1

AN1860

IMPIANTI
Ø4.8*

PIATTAFORMA
Ø4.8

AN1861 (E)



MONCONE FRESABILE CILINDRICO
Titanio grado 5

AN1319

AN1039

AN1370 (E)



MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm
Titanio grado 5

AN1868

AN1869

AN1870 (E)



MONCONE 15° H 1.5 mm
Titanio grado 5

AN2879

AN2880

AN2881 (E)




MONCONE 25° H 1.5 mm
Titanio grado 5

AN2882

AN2883

AN2884 (E)



DUAL SISTEM H 1.0 mm

AN1876

AN1877

AN1878 (E)

DUAL SISTEM H 2.0 mm

AN2885

AN2886

AN2887 (E)

CALCINABILE

AN3101

AN3102

AN3101

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCAN N-R

SCAN R-R

SCAN R-R

SCANBODY NON ROTANTE

SCAN N

SCAN R

SCAN R

Poli-Eter-Eter-Chetone



MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

AN4141 (R)

AN4144 (R)

-

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

AN4142 (R)

AN4145 (R)

-

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

AN4143 (R)

AN4146 (R)

-


Titanio grado 5

Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN

SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

NOTE LEGALI

Leone® è un marchio registrato da Leone S.P.A. ITALIA.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

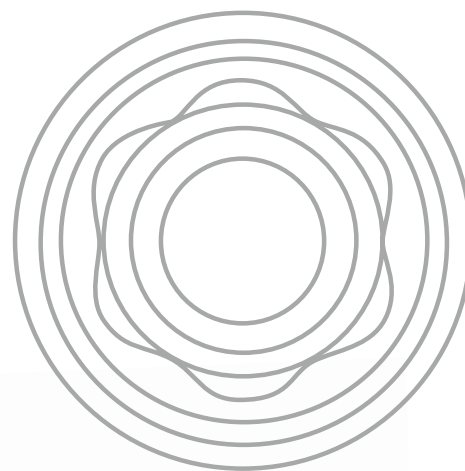

LPSerie



ANALOGO
Acciaio



MONCONE CALCINABILE ROTANTE
MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE
Polimetilmetacrilato



VITE PROTESICA
VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)
VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)
Titanio grado 5



DUAL SISTEM ROTANTE - H 1.0 mm
CALCINABILE ROTANTE
DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 1.0 mm
CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5
ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE
SCANBODY NON ROTANTE
Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN
Titanio grado 4



COMBY CHROME ROTANTE
COMBY CHROME NON ROTANTE
Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm	AN4167 (R)	AN4154 (R)	AN4180 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm	AN4168 (R)	AN4155 (R)	AN4181 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm	AN4169 (R)	AN4156 (R)	AN4182 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm	AN4170 (R)	AN4157 (R)	AN4183 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm	AN4171 (R)	AN4158 (R)	AN4184 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm	AN4172 (R)	AN4159 (R)	AN4185 (R)

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE


MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm	AN4147 (R)	AN4173 (R)	AN4160 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm	AN4148 (R)	AN4174 (R)	AN4161 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm	AN4149 (R)	AN4175 (R)	AN4162 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm	AN4150 (R)	AN4176 (R)	AN4163 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm	AN4151 (R)	AN4177 (R)	AN4164 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm	AN4152 (R)	AN4178 (R)	AN4165 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm	AN4153 (R)	AN4179 (R)	AN4166 (R)

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

	IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø4.1	IMPIANTI Ø5.0
	PIATTAFORMA (SD)	PIATTAFORMA (RD)	PIATTAFORMA (WD)
	AN2365	AN2366	AN2367
	AN2368	AN2369	AN2370
	AN2019	AN2020	AN2021
	AN2022	AN2022	AN2022
	AN3229	AN3229	AN3229
	AN3923	AN3923	AN3923
	AN2371	AN2372	AN2373
	AN3101	AN3102	AN3103
	AN2063	AN2064	AN2065
	AN3098	AN3099	AN3100
	SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN W-R
	SCAN N	SCAN R	SCAN W
	SCAN 1039	SCAN 1040	SCAN 1041
	AN2447	AN2445	-
	AN2453	AN2446	-
	AN4167 (R)	AN4154 (R)	AN4180 (R)
	AN4168 (R)	AN4155 (R)	AN4181 (R)
	AN4169 (R)	AN4156 (R)	AN4182 (R)
	AN4170 (R)	AN4157 (R)	AN4183 (R)
	AN4171 (R)	AN4158 (R)	AN4184 (R)
	AN4172 (R)	AN4159 (R)	AN4185 (R)
	AN4147 (R)	AN4173 (R)	AN4160 (R)
	AN4148 (R)	AN4174 (R)	AN4161 (R)
	AN4149 (R)	AN4175 (R)	AN4162 (R)
	AN4150 (R)	AN4176 (R)	AN4163 (R)
	AN4151 (R)	AN4177 (R)	AN4164 (R)
	AN4152 (R)	AN4178 (R)	AN4165 (R)
	AN4153 (R)	AN4179 (R)	AN4166 (R)

	Ø 3.5 (SD)	Ø 4.1 (RD)	Ø 5.5 (WD)
	N.CM 30	N.CM 30	N.CM 30
	M1.8	M1.8	M1.8
	Q 1.3	Q 1.3	Q 1.3

NOTE LEGALI
PrimaConnex® è un marchio registrato da Lifecore® Biomedical Group.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

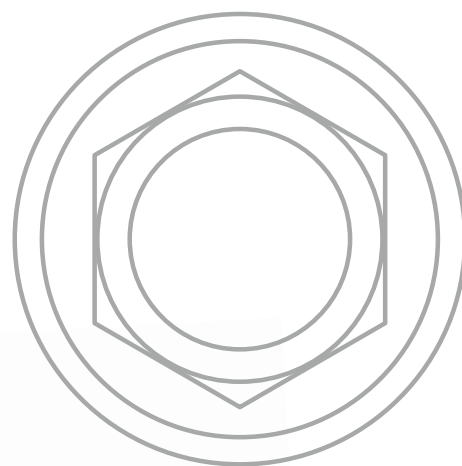

MOSerie

compatibile **MEGAGEN®/ANYONE®**



IMPIANTI									
Ø3.5	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.0	Ø5.5	Ø6.0	Ø6.5	Ø7.0	Ø7.5	Ø8.0
PIATTAFORMA									
Ø3.5 / Ø3.9									
AN2891									
AN2892									
AN2893									
AN2894									
AN2895									
AN2896									
AN2897									
AN2898									
AN2909									
AN2910									
AN2911									
AN2899									
AN2900									
AN2901									
AN2902									
AN2903									
AN2904									
AN2905									
AN2906									
AN2907									
AN2908									
AN2912									
AN2913									
AN2274									
AN2312									
AN3350									
AN3351									
AN3352									
AN2920									
AN2921									



ANALOGO
Acciaio



TRANSFER OPEN TRAY
Titanio grado 5



MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm
MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm
Titanio grado 5



MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 4.5
MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 5.5
MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.5 mm - P.E. 4.5
MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.5 mm - P.E. 5.5
Titanio grado 5



MONCONE FRESABILE P.E. 4.5
MONCONE FRESABILE P.E. 5.5
MONCONE FRESABILE P.E. 6.5
Titanio grado 5



MONCONE 15° H 2.5 mm - P.E. 4.5
MONCONE 15° H 4.5 mm - P.E. 4.5
Titanio grado 5



MONCONE 25° H 2.5 mm - P.E. 4.5
MONCONE 25° H 4.5 mm - P.E. 4.5
Titanio grado 5



VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 4.5
VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 4.5
VITE GUARIGIONE H 6.0 mm - P.E. 4.5
VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 5.5
VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 5.5
VITE GUARIGIONE H 6.0 mm - P.E. 5.5
Titanio grado 5




VITE PROTESICA
VITE TRANSFER
VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)
VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)
Titanio grado 5



I-BASE H 0.75 mm
I-BASE H 1.5 mm
I-BASE H 2.5 mm
Titanio grado 5



COMBY CHROME ROTANTE
COMBY CHROME NON ROTANTE
Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato



DUAL SISTEM ROTANTE H 0.75 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 2.5 mm
CALCINABILE ROTANTE
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.75 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.5 mm
CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE
SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN
 Titanio grado 4



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 139**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

	Ø4.0	M.U.A.
	N.cm 30	N.cm 15
	M 1.8	M 1.4
	ES 1.20 mm	-

Chiavi inserimento m.u.a.



M.U.A. DRIVER for RATCHET LONG ST1106

M.U.A. DRIVER for RATCHET SHORT ST1107




M.U.A. DRIVER ST11001

SERRAGGIO

Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
 Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

ABUTMENT PROTESI AVVITATA



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm
M.U.A. DRITTO H 2.0 mm
M.U.A. DRITTO H 3.0 mm
M.U.A. DRITTO H 4.0 mm
M.U.A. DRITTO H 5.0 mm
M.U.A. DRITTO H 6.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.5 mm
M.U.A. 17° H 3.5 mm
M.U.A. 17° H 4.5 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 2.5 mm
M.U.A. 30° H 3.5 mm
M.U.A. 30° H 4.5 mm

Titanio grado 5



VITE M.U.A. ANGOLATO

Titanio grado 5



ANALOGO M.U.A.

Acciaio

AN1604



MONCONE PROVVISORIO M.U.A.

Titanio grado 5

AN2101



MONCONE SALDATURA M.U.A.

Titanio grado 5

AN2777



ANALOGO PROTEZIONE M.U.A.

Acciaio

AN2275



MICROVITE M.U.A.
VITE TRANSFER M.U.A.
VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)
VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)

Titanio grado 5

AN1360
AN1663
AN3290
AN3894



INTRAORAL SCAN M.U.A.

Titanio grado 4

SCAN1002



VITE PROTEZIONE M.U.A H 4.0 mm

Titanio grado 5

AN2267

IMPIANTI
Ø3.5 Ø4.0 Ø4.5 Ø5.0 Ø5.5 Ø6.0 Ø6.5 Ø7.0 Ø7.5 Ø8.0

PIATTAFORMA
Ø3.5 / Ø3.9

AN2316

AN3142

AN3143

AN3144

AN3145

AN3167

AN5536

AN5537

AN5538

AN5539

AN5540

AN5541

AN3137



TRANSFER M.U.A.

Titanio grado 5

AN2098



MONCONE CALCINABILE M.U.A.

Polimetilmetacrilato

AN2099



COMBY CHROME M.U.A.

Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato

AN1157



DUAL SISTEM M.U.A.
CALCINABILE M.U.A.

Titanio grado 5
Polimetilmetacrilato

AN1156
AN3106



VITE CERATURA M.U.A. CORTA
VITE CERATURA M.U.A. LUNGA

Titanio grado 5

AN1663
AN2778




SCANBODY M.U.A.

Alluminio Ergal Mediale

SCAN-M-MO

NOTE LEGALI
Megagen® Anyone® è un marchio registrato da MegaGen Implant Co., Ltd. 377-2, Kyochon-Ri, Jain-Myun, Gyeongsan - Gyeongbuk 712-852 Korea.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

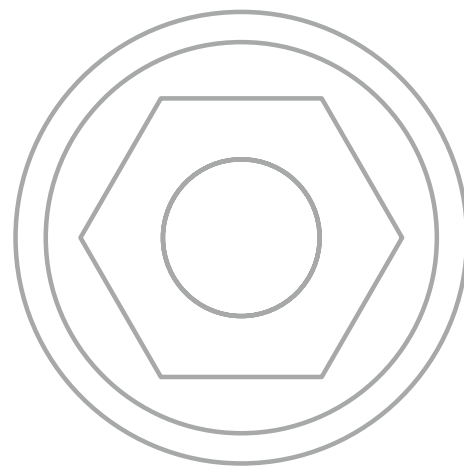

MGSerie

compatibile MEGAGEN®/ANYRIDGE®

IMPIANTI
Ø3.5 Ø4.0 Ø4.5 Ø5.0 Ø5.5 Ø6.0 Ø6.5 Ø7.0 Ø7.5 Ø8.0
PIATTAFORMA
Ø3.5




ANALOGO
Acciaio

AN1159



VITE PROTESICA
VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)
VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)
Titanio grado 5

AN2527
AN1186
AN2196



DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 2.5 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 3.5 mm
CALCINABILE ROTANTE
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.5 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.5 mm
CALCINABILE NON ROTANTE

AN3255
AN3256
AN3257
AN3101
AN2525
AN2526
AN2528
AN3098

Titanio grado 5
ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE
SCANBODY NON ROTANTE
Poli-Eter-Eter-Chetone

SCAN N-R
SCAN N



INTRAORAL SCAN
Titanio grado 4

SCAN1043



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

AN4206 (R)
AN4207 (R)
AN4208 (R)
AN4209 (R)
AN4210 (R)

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

AN4199 (R)
AN4200 (R)
AN4201 (R)
AN4202 (R)
AN4203 (R)
AN4204 (R)
AN4205 (R)

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

	Ø4.0	M.U.A.
	N.cm 30	N.cm 15
	M 1.8	M 1.4
	ES 1.20 mm	ES 1.20 mm


NOTE LEGALI
Megagen® Anyridge® è un marchio registrato da MegaGen Implant Co., Ltd. 377-2, Kyochon-Ri, Jain-Myun, Gyeongsan - Gyeongbuk 712-852 Korea.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

ABUTMENT PROTESI AVVITATA

IMPIANTI
Ø3.5 Ø4.0 Ø4.5 Ø5.0 Ø5.5 Ø6.0 Ø6.5 Ø7.0 Ø7.5 Ø8.0

PIATTAFORMA

Ø3.5



M.U.A. DRITTO H 1.5 mm

AN5556

M.U.A. DRITTO H 2.5 mm

AN5557

M.U.A. DRITTO H 3.5 mm

AN5558

M.U.A. DRITTO H 4.5 mm

AN5559

M.U.A. DRITTO H 5.5 mm

AN5560

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.5 mm

AN5550

M.U.A. 17° H 3.5 mm

AN5551

M.U.A. 17° H 4.5 mm

AN5552

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 2.5 mm

AN5553

M.U.A. 30° H 3.5 mm

AN5554

M.U.A. 30° H 4.5 mm

AN5555

Titanio grado 5



VITE M.U.A. ANGOLATO

AN3137

Titanio grado 5



ANALOGO M.U.A.

AN1604

Acciaio



TRANSFER M.U.A.

AN2098

Titanio grado 5



MONCONE PROVVISORIO M.U.A.

AN2101

Titanio grado 5



MONCONE CALCINABILE M.U.A.

AN2099

Polimetilmetacrilato



MONCONE SALDATURA M.U.A.

AN2777

Titanio grado 5



COMBY CHROME M.U.A.

AN1157

Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato



ANALOGO PROTEZIONE M.U.A.

AN2275

Acciaio



**DUAL SISTEM M.U.A.
CALCINABILE M.U.A.**

AN1156

AN3106

Titanio grado 5
Polimetilmetacrilato



MICROVITE M.U.A.

AN1360

VITE TRANSFER M.U.A.

AN1663

VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)

AN3290

VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)

AN3894

Titanio grado 5



**VITE CERATURA M.U.A. CORTA
VITE CERATURA M.U.A. LUNGA**

AN1663

AN2778

Titanio grado 5



INTRAORAL SCAN M.U.A.

SCAN1002

Titanio grado 4



SCANBODY M.U.A.

SCAN-M-MO

Alluminio Ergal Medicafe




VITE PROTEZIONE M.U.A H 4.0 mm

AN2267

Titanio grado 5

NOTE LEGALI

Megagen® Anyridge® è un marchio registrato da MegaGen Implant Co., Ltd. 377-2, Kyochon-Ri, Jain-Myun, Gyeongsan - Gyeongbuk 712-852 Korea. Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

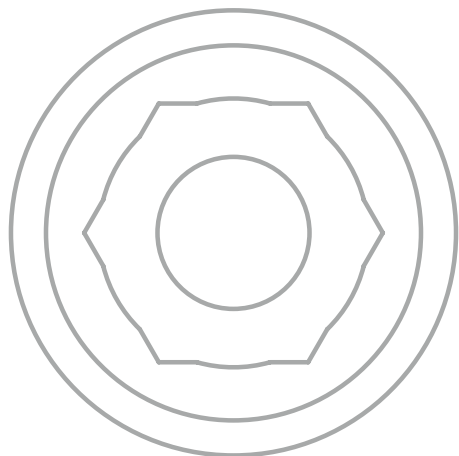

MSerie





ANALOGO

Acciaio

TRANSFER OPEN TRAY

Titanio grado 5

MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm

Titanio grado 5

MONCONE CALCINABILE ROTANTE

MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

Polimetilmetacrilato

MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 3,8

MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 4,5

MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 4,5

MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 5,5

MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 5,5

Titanio grado 5

MONCONE FRESABILE CILINDRICO P.E. 3,8

MONCONE FRESABILE CILINDRICO P.E. 4,5

MONCONE FRESABILE CILINDRICO P.E. 5,5

Titanio grado 5

MONCONE 15° H 2.0 mm

Titanio grado 5

MONCONE 25° H 2.0 mm

Titanio grado 5

VITE GUARIGIONE H 2.0 mm

VITE GUARIGIONE H 3.0 mm

VITE GUARIGIONE H 4.0 mm

VITE GUARIGIONE H 5.0 mm

VITE GUARIGIONE H 7.0 mm

Titanio grado 5

VITE PROTESICA

VITE TRANSFER

VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)

VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)

Titanio grado 5

I-BASE H 0.5 mm

I-BASE H 1.5 mm

I-BASE H 2.5 mm

SCANPOST

Titanio grado 5

BASE "FOR PRESS" ROTANTE

BASE "FOR PRESS" NON ROTANTE

Titanio grado 5

IMPIANTI
Ø3.3

PIATTAFORMA
NARROW

AN2439

-

AN2166

AN2167

AN2810

AN2811

AN2812

-

-

-

-

-

AN2813

-

-

AN2814

-

AN2168

-

AN2169

-

AN2197

AN2438

-

AN3761

AN2397

-

-

-

-

-

-

IMPIANTI
Ø3.75-Ø4.2

PIATTAFORMA
STANDARD

AN1169

AN1824

AN1224

AN1148

AN1831

AN1832

-

AN1839

AN1842

-

AN2595

-

AN1147

AN1829

AN1209

AN1155

AN1845

AN1867

AN1848

AN1853

AN1851

AN1075

AN1779

AN3229

AN3923

AN3172

AN3173

AN3174

AN3175

AN2604

AN2603

IMPIANTI
Ø5.0-Ø6.0

PIATTAFORMA
WIDE

AN1056

AN1825

AN1142

AN1098

AN1833

AN1834

-

-

-

AN1840

AN1843

-

AN1095

AN1152

AN1355

AN1094

-

AN1846

-

AN1849

AN1852

AN1075

AN1779

AN3229

AN3923

AN3309

AN3310

AN3311

-


-

-



COMBY CHROME ROTANTE
COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato



DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 2.5 mm
CALCINABILE ROTANTE
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.5 mm
CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **R** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE
SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN


Titanio grado 4



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 139**

* i diametri Ø 3.75/4.2 possono essere utilizzati nei diametri maggiori Ø 5.0/6.0 creando platform switching



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**

* i diametri Ø 3.75/4.2 possono essere utilizzati nei diametri maggiori Ø 5.0/6.0 creando platform switching



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

* Prodotto su richiesta

IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.75-Ø4.2	IMPIANTI Ø5.0-Ø6.0
PIATTAFORMA NARROW	PIATTAFORMA STANDARD	PIATTAFORMA WIDE
AN2441	AN1836	AN1838
AN2440	AN1835	AN1837
AN2815	AN1331	AN1353
AN2816	AN2448	AN2457
-	AN2454	AN2458
AN3101	AN3101	AN3102
AN2817	AN1429	AN1430
AN2818	AN2459	AN2819
-	AN2461	AN2820
AN3098	AN3098	AN3099
SCAN N-R	SCAN N-R	SCAN R-R
SCAN N	SCAN N	SCAN R
SCAN1092	SCAN1004	SCAN1006
-	AN2482	AN2636*
-	AN2483	AN2637*
-	AN2484	AN2638*
-	AN2485	AN2639*
-	AN2486	AN2640*
AN4218 (R)	AN1093 (R)	AN1093* (R)
AN4219 (R)	AN1092 (R)	AN1092* (R)
AN4220 (R)	AN1125 (R)	AN1125* (R)
AN4221 (R)	AN1126 (R)	AN1126* (R)
AN4222 (R)	AN1234 (R)	AN1234* (R)
AN4211 (R)	AN4230 (R)	AN4223 (R)
AN4212 (R)	AN4231 (R)	AN4224 (R)
AN4213 (R)	AN4232 (R)	AN4225 (R)
AN4214 (R)	AN4233 (R)	AN4226 (R)
AN4215 (R)	AN4234 (R)	AN4227 (R)
AN4216 (R)	AN4235 (R)	AN4228 (R)
AN4217 (R)	AN4236 (R)	AN4229 (R)

	Ø3.3	Ø3.75/4.2	Ø5.0/6.0	M.U.A.
	N.cm 25	N.cm 32	N.cm 30	N.cm 15
	M 1.6	M 1.8	M 1.8	M 1.4
	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm

Chiavi inserimento m.u.a.



M.U.A. DRIVER for RATCHET LONG ST1106


M.U.A. DRIVER for RATCHET SHORT ST1107



M.U.A. DRIVER ST11001

SERRAGGIO
Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

ABUTMENT PROTESI AVVITATA



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm
M.U.A. DRITTO H 2.0 mm
M.U.A. DRITTO H 3.0 mm
M.U.A. DRITTO H 4.0 mm
M.U.A. DRITTO H 5.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.5 mm
M.U.A. 17° H 3.5 mm
M.U.A. 17° H 4.5 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.5 mm
M.U.A. 30° H 4.5 mm
M.U.A. 30° H 5.5 mm

Titanio grado 5



VITE M.U.A. ANGOLATO

Titanio grado 5



ANALOGO M.U.A.

Acciaio

AN1604



MONCONE PROVVISORIO M.U.A.

Titanio grado 5

AN1226



MONCONE SALDATURA M.U.A.

Titanio grado 5

AN2774



ANALOGO PROTEZIONE M.U.A.

Acciaio

AN2275



MICROVITE M.U.A.

AN1274

VITE TRANSFER M.U.A.

AN1423

MICROVITE M.U.A. D.I.S. e (Esagono)

AN3290

MICROVITE M.U.A. D.I.S. t (Torx)

AN3894

Titanio grado 5



INTRAORAL SCAN M.U.A.

Titanio grado 4

SCAN1001



VITE PROTEZIONE M.U.A H 4.0 mm

Titanio grado 5

AN2258

IMPIANTI
Ø3.3

PIATTAFORMA
NARROW

IMPIANTI
Ø3.75-Ø4.2

PIATTAFORMA
STANDARD

IMPIANTI
Ø5.0-Ø6.0

PIATTAFORMA
WIDE

-

AN1615

AN1614

-

AN1616

AN1362

-

AN1617

AN1856

-

AN1336

AN1333

-

AN1536

AN1858

-

AN1012

-

-

AN1356

-

-

AN1013

-

-

AN1207

-

-

AN1144

-

-

AN1334

-

-

AN1720

-



TRANSFER M.U.A.

Titanio grado 5

AN1318



MONCONE CALCINABILE M.U.A.

Polimetilmetacrilato

AN1253



COMBY CHROME M.U.A.

Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato

AN2327



**DUAL SISTEM M.U.A.
CALCINABILE M.U.A.**

Titanio grado 5
Polimetilmetacrilato

AN1332

AN3106



VITE CERATURA M.U.A. CORTA

AN1423

VITE CERATURA M.U.A. LUNGA

AN2776

Titanio grado 5




SCANBODY M.U.A.

Alluminio Ergal Mediale

SCAN-M-MS

NOTE LEGALI

Mis® è un marchio registrato da MIS Corporation.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

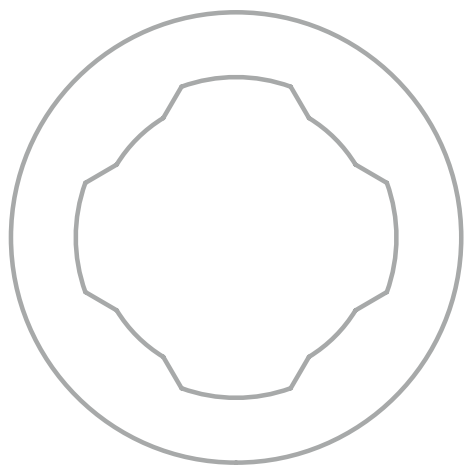

MSCSerie





ANALOGO

Acciaio




VITE PROTESICA

VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)

VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)

Titanio grado 5



DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 2.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 3.5 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.5 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**


IMPIANTI Ø3.30	IMPIANTI Ø3.75-Ø4.2	IMPIANTI Ø5.0
PIATTAFORMA NARROW	PIATTAFORMA STANDARD	PIATTAFORMA WIDE
AN4745	AN4738	AN4759
AN1754	AN1755	AN1756
AN3758	AN3759	AN3759
AN4808	AN4809	AN4810
AN4746	AN4739	AN4760
AN4747	AN4740	AN4761
AN4748	AN4741	AN4762
AN5526	AN3101	AN3103
AN4749	AN4742	AN4763
AN4750	AN4743	AN4764
AN4751	AN4744	AN4765
AN5526	AN3098	AN3100
SCAN S-R	SCAN N-R	SCAN W-R
SCAN S	SCAN N	SCAN W
SCAN1072	SCAN1073	SCAN1074
AN4766 (R)	AN4785 (R)	AN4772 (R)
AN4767 (R)	AN4786 (R)	AN4773 (R)
AN4768 (R)	AN4787 (R)	AN4774 (R)
AN4769 (R)	AN4788 (R)	AN4775 (R)
AN4770 (R)	AN4789 (R)	AN4776 (R)
AN4771 (R)	AN4790 (R)	AN4777 (R)
AN4778 (R)	AN4798 (R)	AN4791 (R)
AN4779 (R)	AN4799 (R)	AN4792 (R)
AN4780 (R)	AN4800 (R)	AN4793 (R)
AN4781 (R)	AN4801 (R)	AN4794 (R)
AN4782 (R)	AN4802 (R)	AN4795 (R)
AN4783 (R)	AN4803 (R)	AN4796 (R)
AN4784 (R)	AN4804 (R)	AN4797 (R)

	Ø3.3	Ø3.75/Ø4.2	Ø5.0
	N.cm 25	N.cm 25	N.cm 25
	M 1.8	M 1.8	M 1.8
	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm

NOTE LEGALI

Mis® è un marchio registrato da MIS Corporation.

Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

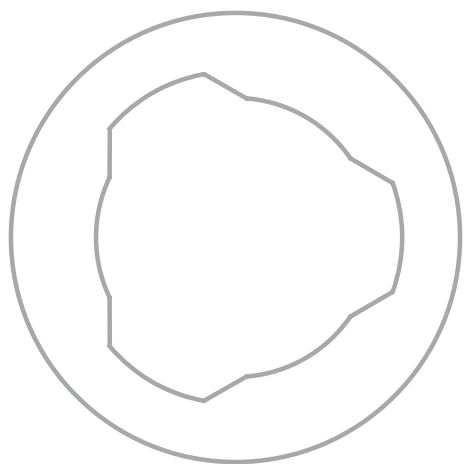

MSVSerie





ANALOGO

Acciaio




VITE PROTESICA

VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)

VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)

Titanio grado 5



DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 2.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 3.5 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.5 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**


IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.9-Ø4.3-Ø5.0
PIATTAFORMA NARROW	PIATTAFORMA STANDARD
AN4745	AN4738
AN1754	AN1755
AN3758	AN3759
AN4808	AN4809
AN4746	AN4739
AN4747	AN4740
AN4748	AN4741
AN5526	AN3101
AN4749	AN4742
AN4750	AN4743
AN4751	AN4744
AN5526	AN3098
SCAN S-R	SCAN N-R
SCAN S	SCAN N
SCAN1072	SCAN1073
AN4766 (R)	AN4785 (R)
AN4767 (R)	AN4786 (R)
AN4768 (R)	AN4787 (R)
AN4769 (R)	AN4788 (R)
AN4770 (R)	AN4789 (R)
AN4766 (R)	AN4790 (R)
AN4778 (R)	AN4798 (R)
AN4779 (R)	AN4799 (R)
AN4780 (R)	AN4800 (R)
AN4781 (R)	AN4801 (R)
AN4782 (R)	AN4802 (R)
AN4783 (R)	AN4803 (R)
AN4784 (R)	AN4804 (R)

	Ø3.3	Ø3.75/Ø4.2	Ø5.0
	N.cm 20	N.cm 25	N.cm 25
	M 1.8	M 1.8	M 1.8
	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm

NOTE LEGALI


Mis® è un marchio registrato da MIS Corporation.


Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

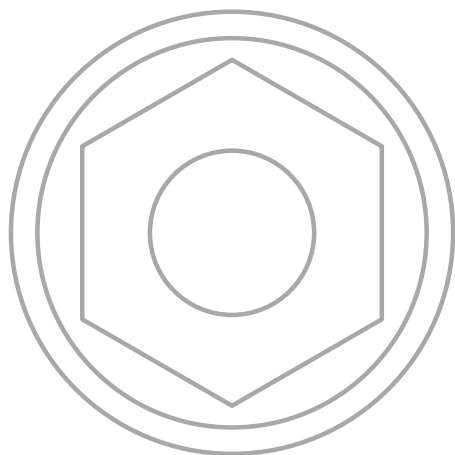

NSerie



	IMPIANTI Ø3.0	IMPIANTI Ø3.5-Ø3.75	IMPIANTI Ø4.3-Ø5.0	IMPIANTI Ø5.5
	PIATTAFORMA Ø3.0	PIATTAFORMA NP	PIATTAFORMA RP	PIATTAFORMA WP
 ANALOGO Acciaio	AN2955	AN1882	AN1883	AN2956
 TRANSFER OPEN TRAY Titanio grado 5	AN1888	AN1885	AN1886	AN1887
 MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN2957	AN1889	AN1893	AN2958
MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 3.0 mm	-	AN1891	AN1896	-
MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE - H 1.5 mm	-	AN1890	AN1894	-
MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE - H 3.0 mm	-	AN1892	AN1895	-
Titanio grado 5				
 MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN2965	AN1897	AN1899	AN2966
MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	AN2967	AN1898	AN1900	AN2968
Polimetilmetacrilato				
 MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 4.8	AN2959	AN1905	-	-
MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 5.5	-	-	AN1907	AN2960
MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 4.8	-	AN1906	-	-
MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 5.5	-	-	AN1908	-
Titanio grado 5				
 MONCONE 15° H 2.0 mm	AN2963	AN1909	AN1911	AN2964
MONCONE 15° H 4.0 mm	-	AN1910	AN1912	-
Titanio grado 5				
 MONCONE 25° H 2.0 mm	AN2969	AN1913	AN1915	-
MONCONE 25° H 4.0 mm	-	AN1914	AN1916	-
Titanio grado 5				
 VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 3.0 mm	AN2970	AN1917	AN1920	AN2973
VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 5.0 mm	AN2971	AN1918	AN1921	AN2974
VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 7.0 mm	AN2972	AN1919	AN1922	AN2975
Titanio grado 5				
 VITE PROTESICA	AN2976	AN1546	AN1545	AN1545
VITE TRANSFER	AN2977	AN2263	AN2264	AN2264
VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3280	AN3245	AN3244	AN3244
VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN2391	AN3863	AN3864	AN3864
Titanio grado 5				
 I-BASE H 0.5 mm	-	AN3247	AN3243	-
I-BASE H 1.5 mm	-	AN3248	AN3242	-
I-BASE H 2.5 mm	-	AN3249	AN3241	-
I-BASE H 3.5 mm	-	AN3251	AN3240	-
SCANPOST		AN4289	AN4290	
Titanio grado 5				
 COMBY CHROME ROTANTE	AN2984	AN1901	AN1903	AN2986
COMBY CHROME NON ROTANTE	AN2985	AN1902	AN1904	AN2987
Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato				



DUAL SISTEM ROTANTE H 0.75

DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5

DUAL SISTEM ROTANTE H 2.5

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.75

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.5

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **R** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 139**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

	IMPIANTI Ø3.0	IMPIANTI Ø3.5-Ø3.75	IMPIANTI Ø4.3-Ø5.0	IMPIANTI Ø5.5
	PIATTAFORMA Ø3.0	PIATTAFORMA NP	PIATTAFORMA RP	PIATTAFORMA WP
	-	AN2387	AN2381	-
	AN2978	AN1533	AN1972	AN2982
	-	AN2980	AN2981	-
	AN5526	AN3101	AN3102	AN3103
	-	AN2389	AN2382	-
	AN2979	AN1468	AN1543	AN2983
	-	AN2473	AN2472	-
	AN5526	AN3098	AN3099	AN3100
	SCAN S-R	SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN W-R
	SCAN S	SCAN N	SCAN R	SCAN W
	SCAN1044	SCAN1007	SCAN1008	SCAN1045
	-	AN2988	AN2993	-
	-	AN2989	AN2994	-
	-	AN2990	AN2995	-
	-	AN2991	AN2996	-
	-	AN2992	AN2997	-
	AN4270 (R)	AN4283 (R)	AN4257 (R)	AN4244 (R)
	AN4271 (R)	AN4284 (R)	AN4258 (R)	AN4245 (R)
	AN4272 (R)	AN4285 (R)	AN4259 (R)	AN4246 (R)
	AN 4273 (R)	AN 4286 (R)	AN 4260 (R)	AN 4247 (R)
	AN4274 (R)	AN4287 (R)	AN4261 (R)	AN4248 (R)
	AN4275 (R)	AN4288 (R)	AN4262 (R)	AN4249 (R)
	AN4237 (R)	AN4250 (R)	AN4276 (R)	AN4263 (R)
	AN4238 (R)	AN4251 (R)	AN4277 (R)	AN4264 (R)
	AN42739 (R)	AN4252 (R)	AN4278 (R)	AN4265 (R)
	AN 4240 (R)	AN 4253 (R)	AN 4279 (R)	AN 4266 (R)
	AN4241 (R)	AN4254 (R)	AN4280 (R)	AN4267 (R)
	AN4242 (R)	AN4255 (R)	AN4281 (R)	AN4268 (R)
	AN4243 (R)	AN4256 (R)	AN4282 (R)	AN4269 (R)

	Ø3.0	Ø3.5 (NP)	Ø4.3/5.0 (RP)	Ø5.5 (WP)	M.U.A.
	N.cm 15	N.cm 25	N.cm 35	N.cm 35	N.cm 15
	M 1.4	M 1.6	M 2.0	M 2.0	M 1.4
	TORX 5.5 mm	TORX 5.5 mm	TORX 5.5 mm	TORX 5.5 mm	TORX 5.5 mm

Chiavi inserimento m.u.a.



M.U.A. DRIVER for RATCHET LONG ST1106


M.U.A. DRIVER for RATCHET SHORT ST1107



M.U.A. DRIVER ST11001

SERRAGGIO
Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

ABUTMENT PROTESI AVVITATA



M.U.A. DRITTO H 1.5 mm

M.U.A. DRITTO H 2.5 mm

M.U.A. DRITTO H 3.5 mm

M.U.A. DRITTO H 4.5 mm

M.U.A. DRITTO H 5.5 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.5 mm

M.U.A. 17° H 3.5 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.5 mm

M.U.A. 30° H 4.5 mm

Titanio grado 5



VITE M.U.A. ANGOLATO

Titanio grado 5

IMPIANTI Ø3.0	IMPIANTI Ø3.5-Ø3.75	IMPIANTI Ø4.3-Ø5.0	IMPIANTI Ø5.5
PIATTAFORMA Ø3.0	PIATTAFORMA NP	PIATTAFORMA RP	PIATTAFORMA WP
-	AN2088	AN2092	AN2998
-	AN2089	AN2093	AN2999
-	AN2090	AN2094	AN2385
-	AN2091	AN2095	-
-	AN2383	AN2384	-
-	AN2084	AN2081	-
-	AN2085	AN2082	-
-	AN2189	AN2186	-
-	AN2190	AN2187	-
-	AN2261	AN2262	-



ANALOGO M.U.A.

Acciaio

AN1604



TRANSFER M.U.A.

Titanio grado 5

AN1603



MONCONE PROVVISORIO M.U.A.

Titanio grado 5

AN1601



MONCONE CALCINABILE M.U.A.

Polimetilmetacrilato

AN1602



MONCONE SALDATURA M.U.A.

Titanio grado 5

AN2783



COMBY CHROME M.U.A.

Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato

AN2029



ANALOGO PROTEZIONE M.U.A.

Acciaio

AN2275



**DUAL SISTEM M.U.A.
CALCINABILE M.U.A.**

Titanio grado 5
Polimetilmetacrilato

AN1105

AN3106



(RP) MICROVITE M.U.A.

AN1548

MICROVITE CAD/CAM

AN3300

VITE TRANSFER M.U.A.

AN1119

MICROVITE M.U.A. D.I.S. e (Esagono)

AN3290

MICROVITE M.U.A. D.I.S. t (Torx)

AN3894

Titanio grado 5



VITE CERATURA M.U.A. CORTA

AN1119

VITE CERATURA M.U.A. LUNGA

AN2784

Titanio grado 5



INTRAORAL SCAN M.U.A.

Titanio grado 4

SCAN1000



SCANBODY M.U.A.

Alluminio Ergal Mediale

SCAN-M-N




VITE PROTEZIONE M.U.A H 4.0 mm

Titanio grado 5

AN1279

NOTE LEGALI


Brånemark®, Replace® e Active® sono marchi registrati da Nobel Biocare, AB SWEDEN.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

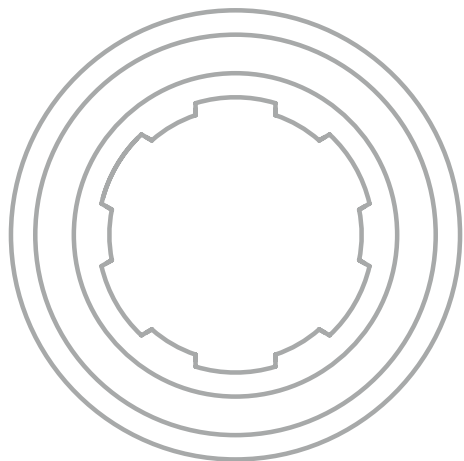

NESerie


compatibile **NEOSS®/PROACTIVE®**



		IMPIANTI Ø4.0
		PIATTAFORMA Ø4.0
	ANALOGO Acciaio	AN2375
	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN2292
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm	AN2376
	Titanio grado 5	
	MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN2377
	MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	AN1633
	Polimetilmetacrilato	
	MONCONE FRESABILE DRITTO Titanio grado 5	AN2378
	MONCONE 15° Titanio grado 5	AN1634
	VITE PROTESICA	AN1632
	VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3717
	VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN2182
	Titanio grado 5	
	DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm	AN2379
	CALCINABILE ROTANTE	AN3102
	DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm	AN2374
	CALCINABILE NON ROTANTE	AN3099
	Titanio grado 5	
	ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE. N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera e riceverete vite D.I.S. testa esagonale N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera t riceverete vite D.I.S. testa torx N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"	
	COMBY CHROME ROTANTE	AN2922
	COMBY CHROME NON ROTANTE	AN2923
	Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato	
	SCANBODY ROTANTE	SCAN R-R
	SCANBODY NON ROTANTE	SCAN R
	Poli-Eter-Eter-Chetone	
	INTRAORAL SCAN Titanio grado 4	SCAN1076
	MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm	AN4298 (R)
	MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm	AN4299 (R)
	MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm	AN4300 (R)
	MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm	AN4301 (R)
	MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm	AN4302 (R)
	MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm	AN4303 (R)
	Titanio grado 5 Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN	
	MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm	AN4291 (R)
	MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm	AN4292 (R)
	MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm	AN4293 (R)
	MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm	AN4294 (R)
	MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm	AN4295 (R)
	MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm	AN4296 (R)
	MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm	AN4297 (R)
	Titanio grado 5 Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE	

NOTE LEGALI

Neoss® è un marchio registrato da Neoss Limited, UK
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

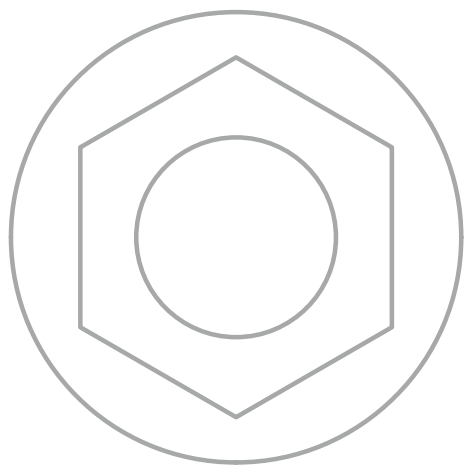

○Serie





LEGENDA - (E) Ad esaurimento **P.E.** Profilo di emergenza **H** Altezza trasmutosa **R** Su richiesta



I-BASE H 0.5 mm

I-BASE H 1.5 mm

I-BASE H 2.5 mm

Titanio grado 5



BASE "FOR PRESS" ROTANTE

BASE "FOR PRESS" NON ROTANTE

Titanio grado 5



COMBY CHROME ROTANTE

COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.

Polimetilmetacrilato



DUAL SISTEM ROTANTE H 1.0 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 2.0 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 3.0 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.0 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.0 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.0 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5

Kit riferimento pag. 139

* i diametri Ø 4.1 possono essere utilizzati nei diametri maggiori Ø 5.0 creando platform switching



MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

Titanio grado 5

Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN

SU RICHIESTA 5 GIORNI LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE



MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5

Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE

SU RICHIESTA 5 GIORNI LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

	Ø3.4	Ø4.1	Ø5.0	M.U.A.
	N.cm 30	N.cm 30	N.cm 30	N.cm 15
	M 2.0	M 2.0	M 2.0	M 1.4
	ES 1.20 mm	ES 1.20 mm	ES 1.20 mm	ES 1.20 mm

	IMPIANTI Ø3.25	IMPIANTI Ø3.75-Ø4.0	IMPIANTI Ø5.0
	PIATTAFORMA Ø3.4	PIATTAFORMA Ø4.1	PIATTAFORMA Ø5.0
I-BASE H 0.5 mm	AN3320	AN3673	AN3679
I-BASE H 1.5 mm	AN3321	AN3674	-
I-BASE H 2.5 mm	-	AN3675	-
BASE "FOR PRESS" ROTANTE	-	-	-
BASE "FOR PRESS" NON ROTANTE	-	AN2807	-
COMBY CHROME ROTANTE	AN1675	AN2105	AN1676
COMBY CHROME NON ROTANTE	AN1170	AN2162	AN1171
DUAL SISTEM ROTANTE H 1.0 mm	AN1957	AN1958	AN1959
DUAL SISTEM ROTANTE H 2.0 mm	AN2794	AN2796	AN2798
DUAL SISTEM ROTANTE H 3.0 mm	AN2795	AN2797	AN2799
CALCINABILE ROTANTE	AN3101	AN3102	AN3103
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.0 mm	AN1541	AN1004	AN1542
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.0 mm	AN2800	AN2802	AN2804
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.0 mm	AN2801	AN2803	AN2805
CALCINABILE NON ROTANTE	AN3098	AN3099	AN3100
SCANBODY ROTANTE	SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN W-R
SCANBODY NON ROTANTE	SCAN N	SCAN R	SCAN W
INTRAORAL SCAN	SCAN1021	SCAN1046	SCAN1047
MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm	AN2568	AN2552	AN2552*
MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm	AN2569	AN2553	AN2553*
MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm	AN2570	AN2554	AN2554*
MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm	AN2571	AN2555	AN2555*
MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm	AN2572	AN2556	AN2556*
MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm	AN3084	AN2541	AN4312
MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm	AN3085	AN2542	AN4313
MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm	AN3086	AN2543	AN4314
MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm	AN3087	AN2544	AN4315
MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm	AN3088	AN2545	AN4316
MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm	AN4317 (R)	AN4305(R)	AN4324 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm	AN4318 (R)	AN4306 (R)	AN4325 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm	AN4319 (R)	AN4307 (R)	AN4326 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm	AN4320 (R)	AN4308 (R)	AN4327 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm	AN4321 (R)	AN4309 (R)	AN4328 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm	AN4322 (R)	AN4310 (R)	AN4329 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm	AN4323 (R)	AN4311 (R)	AN4330 (R)

Chiavi inserimento m.u.a.



M.U.A. DRIVER for RATCHET LONG ST1106


M.U.A. DRIVER for RATCHET SHORT ST1107

M.U.A. DRIVER ST1001

SERRAGGIO

Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

ABUTMENT PROTESI AVVITATA



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm
M.U.A. DRITTO H 2.0 mm
M.U.A. DRITTO H 3.0 mm
M.U.A. DRITTO H 4.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 3.0 mm
M.U.A. 17° H 4.0 mm

Titanio grado 5

* i diametri Ø 4.1 possono essere utilizzati nei diametri maggiori Ø 5.0 creando platform switching



M.U.A. 30° H 3.0 mm
M.U.A. 30° H 4.0 mm

Titanio grado 5

* i diametri Ø 4.1 possono essere utilizzati nei diametri maggiori Ø 5.0 creando platform switching



VITE M.U.A. ANGOLATO

Titanio grado 5

* i diametri Ø 4.1 possono essere utilizzati nei diametri maggiori Ø 5.0 creando platform switching



ANALOGO M.U.A.

Acciaio

AN1604



MONCONE PROVVISORIO M.U.A.

Titanio grado 5

AN2101



MONCONE SALDATURA M.U.A.

Titanio grado 5

AN2777



ANALOGO PROTEZIONE M.U.A.

Acciaio

AN2275



VITE M.U.A. ANGOLATO

AN1163

MICROVITE CAD/CAM

AN1360

VITE TRANSFER M.U.A.

AN1663

VITE M.U.A. D.I.S. e (Esagono)

AN3290

VITE M.U.A. D.I.S. t (Torx)

AN3894

Titanio grado 5



TRANSFER M.U.A.

Titanio grado 5

AN2098



MONCONE CALCINABILE M.U.A.

Polimetilmetacrilato

AN2099



COMBY CHROME M.U.A.

Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato

AN1157



**DUAL SISTEM M.U.A.
CALCINABILE**

Titanio grado 5
Polimetilmetacrilato

AN1156

AN3106



VITE CERATURA M.U.A. CORTA

AN1663

VITE CERATURA M.U.A. LUNGA

AN2778

Titanio grado 5



INTRAORAL SCAN M.U.A.

Titanio grado 4

SCAN1002



SCANBODY M.U.A.

Alluminio Ergal Mediale

SCAN-M-O




VITE PROTEZIONE M.U.A H 4.0 mm

Titanio grado 5

AN2267

NOTE LEGALI


OSSTEM is a trademark of OSSTEM IMPLANT CO., LTD
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

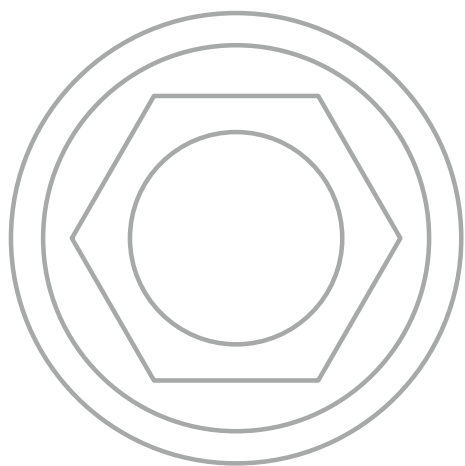


OSSerie

compatibile **OSSTEM®**
TSII®/ TSIII®/ TSIII ULTRA WIDE®/ TSIV®



	ANALOGO Acciaio	AN3000	AN3001
	TRANSFER OPEN TRAY	AN3002	AN3003
	TRANSFER CLOSED TRAY Titanio grado 5	AN4667	AN4668
	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN3004	AN3005
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm Titanio grado 5	AN3006	AN3007
	MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN3008	AN3009
	MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE Polimetilmetacrilato	AN3010	AN3011
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 4.5	AN3012	AN3013
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 4.5 Titanio grado 5	AN3014	AN3015
	MONCONE FRESABILE CILINDRICO P.E. 4.5	AN3016	AN3017
	MONCONE FRESABILE CILINDRICO P.E. 5.5	AN3018	AN3019
	MONCONE FRESABILE CILINDRICO P.E. 7.0 Titanio grado 5	-	AN3141
	MONCONE 15° H 2.5 mm - P.E. 4.0	AN3020	AN3021
	MONCONE 15° H 2.5 mm - P.E. 5.5	-	AN3022
	MONCONE 15° H 3.5 mm - P.E. 4.0	AN3023	AN3024
	MONCONE 15° H 3.5 mm - P.E. 5.5 Titanio grado 5	-	AN3025
	MONCONE 25° H 2.0 mm - P.E. 3.8	AN3026	-
	MONCONE 25° H 2.0 mm - P.E. 5.0	-	AN3027
	MONCONE 25° H 4.0 mm - P.E. 3.8	AN3028	-
	MONCONE 25° H 4.0 mm - P.E. 5.0 Titanio grado 5	-	AN3029
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 3.0 mm	AN2421	AN3031
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 5.0 mm	AN2422	AN3032
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 7.0 mm Titanio grado 5	AN3030	AN3033
	VITE PROTESICA	AN2418	AN2419
	VITE TRANSFER OPEN TRAY	AN3034	AN3035
	VITE TRANSFER CLOSED TRAY	AN4678	AN4679
	VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3277	AN3342
	VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx) Titanio grado 5	AN1137	AN3281
	I-BASE H 0.75 mm	AN1192	AN3350
	I-BASE H 1.5 mm	AN1193	AN3351
	I-BASE H 2.5 mm Titanio grado 5	AN1194	AN3352
	COMBY CHROME ROTANTE	AN3048	AN3049
	COMBY CHROME NON ROTANTE Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato	AN3050	AN3051



DUAL SISTEM ROTANTE H 1.0 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 2.0 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 3.5 mm
CALCINABILE ROTANTE
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.0 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.0 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.5 mm
CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
 N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
 N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx
 N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE
SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 139**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø4.0
PIATTAFORMA MINI	PIATTAFORMA REGULAR
AN3036	AN3037
AN3038	AN3039
AN3040	AN3041
AN3101	AN3101
AN3042	AN3043
AN3044	AN3045
AN3046	AN3047
AN3098	AN3098
SCAN N-R	SCAN N-R
SCAN N	SCAN N
SCAN1048	SCAN1049
AN3052	AN3057
AN3053	AN3125
AN3054	AN3126
AN3055	AN3127
AN3056	AN3128
AN3124	AN3129
AN4333 (R)	AN4346 (R)
AN4334 (R)	AN4347 (R)
AN4335 (R)	AN4348 (R)
AN4336 (R)	AN4349 (R)
AN4337 (R)	AN4350 (R)
AN4338 (R)	AN4351 (R)
AN4352 (R)	AN4339 (R)
AN4353 (R)	AN4340 (R)
AN4354 (R)	AN4341 (R)
AN4355 (R)	AN4342 (R)
AN4356 (R)	AN4343 (R)
AN4357 (R)	AN4344 (R)
AN4358 (R)	AN4345 (R)

	Ø3.5	Ø4.0	M.U.A.
	N.cm 20	N.cm 30	N.cm 15
	M 1.6	M 2.0	M 1.4
	ES 1.20 mm	ES 1.20 mm	ES 1.20 mm

Chiavi inserimento m.u.a.



M.U.A. DRIVER for RATCHET LONG ST1106


M.U.A. DRIVER for RATCHET SHORT ST1107



M.U.A. DRIVER ST11001

SERRAGGIO
 Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
 Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

ABUTMENT PROTESI AVVITATA



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm
M.U.A. DRITTO H 2.0 mm
M.U.A. DRITTO H 3.0 mm
M.U.A. DRITTO H 4.0 mm
M.U.A. DRITTO H 5.0 mm
M.U.A. DRITTO H 6.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.5 mm
M.U.A. 17° H 3.5 mm
M.U.A. 17° H 4.5 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.5 mm
M.U.A. 30° H 4.5 mm
M.U.A. 30° H 5.5 mm

Titanio grado 5



VITE M.U.A. ANGOLATO

Titanio grado 5

IMPIANTI
Ø3.5

PIATTAFORMA
MINI

AN3058

AN3059

AN3060

AN3061

AN3062

-

AN3063

AN3064

-

AN3067

AN3068

-

AN2420

IMPIANTI
Ø4.0

PIATTAFORMA
REGULAR

AN2316

AN3142

AN3143

AN3144

AN3145

AN3167

AN3065

AN3066

AN3168

AN3069

AN3070

AN3169

AN3137



ANALOGO M.U.A.

Acciaio

AN1604



TRANSFER M.U.A.

Titanio grado 5

AN2098



MONCONE PROVVISORIO M.U.A.

Titanio grado 5

AN2101



MONCONE CALCINABILE M.U.A.

Polimetilmetacrilato

AN2099



MONCONE SALDATURA M.U.A.

Titanio grado 5

AN2777



COMBY CHROME M.U.A.

Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato

AN1157



ANALOGO PROTEZIONE M.U.A.

Acciaio

AN2275



**DUAL SISTEM M.U.A.
CALCINABILE M.U.A.**

Titanio grado 5
Polimetilmetacrilato

AN1156

AN3106



MICROVITE M.U.A.

AN1360

VITE TRANSFER M.U.A.

AN1663

VITE M.U.A. D.I.S. e (Esagono)

AN3290

VITE M.U.A. D.I.S. t (Torx)

AN3894

Titanio grado 5



**VITE CERATURA M.U.A. CORTA
VITE CERATURA M.U.A. LUNGA**

Titanio grado 5

AN1663

AN2778



INTRAORAL SCAN M.U.A.

Titanio grado 4

SCAN1002



SCANBODY M.U.A.

Alluminio Ergal Mediale

SCAN-M-OS



VITE PROTEZIONE M.U.A H 4.0 mm


Titanio grado 5

AN2267

NOTE LEGALI

OSSTEM is a trademark of OSSTEM IMPLANT CO., LTD


Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

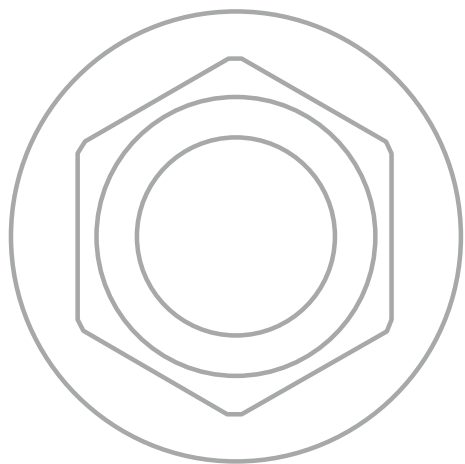

PHSerie

compatibile **PHIBO®/TSH®**



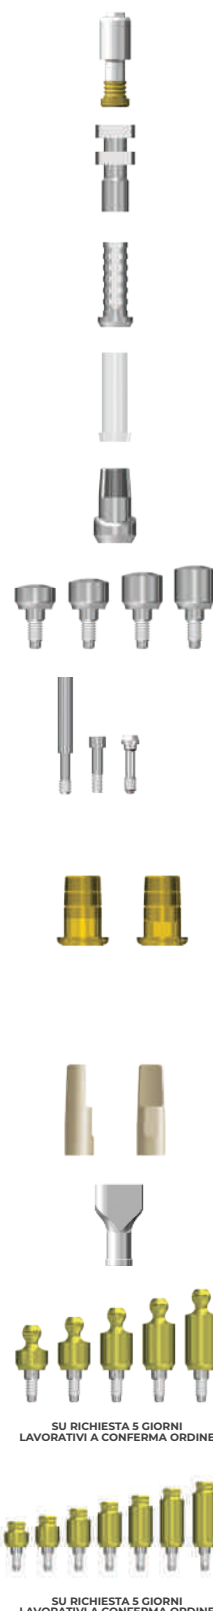

ANALOGO

Acciaio

TRANSFER OPEN TRAY

Titanio grado 5

MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm

Titanio grado 5

MONCONE CALCINABILE ROTANTE

MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

Polimetilmetacrilato

MONCONE DRITTO

Titanio grado 5

VITE GUARIGIONE H 2.0 mm

VITE GUARIGIONE H 4.0 mm

VITE GUARIGIONE H 5.0 mm

Titanio grado 5

VITE PROTESICA

VITE TRANSFER

VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)

VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)

Titanio grado 5

DUAL SISTEM ROTANTE H 1.0 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.0 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"

SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone

INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**

MONCONE OT EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT EQUATOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

	IMPIANTI Ø3.3 PIATTAFORMA S2	IMPIANTI Ø3.6 PIATTAFORMA S3	IMPIANTI Ø4.2 PIATTAFORMA S4	IMPIANTI Ø4.8 PIATTAFORMA S5
ANALOGO	AN3394	AN3393	AN3393	AN3377
TRANSFER OPEN TRAY	AN3384	AN3381	AN3381	AN1530
MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN1694	AN1629	AN1629	-
MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm	AN1531	AN1628	AN1628	-
MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN3391	AN3382	AN3382	AN1511
MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	AN3388	AN3383	AN3383	AN1512
MONCONE DRITTO	AN3386	AN3380	AN3380	-
VITE GUARIGIONE H 2.0 mm	AN3378	AN1492	AN1492	-
VITE GUARIGIONE H 4.0 mm	AN3379	AN1493	AN1493	AN1495
VITE GUARIGIONE H 5.0 mm	AN1485	AN1494	AN1494	AN1496
VITE PROTESICA	AN3387	AN3389	AN3389	AN3389
VITE TRANSFER	AN3385	AN3390	AN3390	AN3390
VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3227	AN3228	AN3228	AN3228
VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN4331	AN4332	AN4332	AN4332
DUAL SISTEM ROTANTE H 1.0 mm	AN1498	AN1501	AN1501	AN1502
CALCINABILE ROTANTE	AN3101	AN3102	AN3102	AN3103
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.0 mm	AN1504	AN1505	AN1505	AN1510
CALCINABILE NON ROTANTE	AN3098	AN3099	AN3099	AN3100
SCANBODY ROTANTE	SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN R-R	SCAN W-R
SCANBODY NON ROTANTE	SCAN N	SCAN R	SCAN R	SCAN W
INTRAORAL SCAN	SCAN1077	SCAN1078	SCAN1078	SCAN1079
MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm	AN3089 (R)	AN3392 (R)	AN3392 (R)	AN3806 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm	AN3090 (R)	AN3415 (R)	AN3415 (R)	AN3807 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm	AN3091 (R)	AN3737 (R)	AN3737 (R)	AN3808 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm	AN3092 (R)	AN3738 (R)	AN3738 (R)	AN3809 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm	AN3093 (R)	AN3739 (R)	AN3739 (R)	AN3810 (R)
MONCONE OT EQUATOR H 1.0 mm	AN3745 (R)	AN3740 (R)	AN3740 (R)	AN3750 (R)
MONCONE OT EQUATOR H 2.0 mm	AN3746 (R)	AN3741 (R)	AN3741 (R)	AN3751 (R)
MONCONE OT EQUATOR H 3.0 mm	AN3747 (R)	AN3742 (R)	AN3742 (R)	AN3752 (R)
MONCONE OT EQUATOR H 4.0 mm	AN3748 (R)	AN3743 (R)	AN3743 (R)	AN3753 (R)
MONCONE OT EQUATOR H 5.0 mm	AN3749 (R)	AN3744 (R)	AN3744 (R)	AN3754 (R)

	S2	S3/S4	S5	M.U.A.
	N.cm 25	N.cm 32	N.cm 35	N.cm 15
	M 1.8	M 2.0	M 2.0	M 1.4
	ES 1.2 mm	ES 1.2 mm	ES 1.2 mm	ES 1.2 mm

Chiavi inserimento m.u.a.



M.U.A. DRIVER for RATCHET LONG ST1106

M.U.A. DRIVER for RATCHET SHORT ST1107


M.U.A. DRIVER ST1001

SERRAGGIO

Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1.27.

Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

ABUTMENT PROTESI AVVITATA



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

M.U.A. DRITTO H 1.0 mm
M.U.A. DRITTO H 2.0 mm
M.U.A. DRITTO H 3.0 mm
Titanio grado 5

IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.6	IMPIANTI Ø4.2	IMPIANTI Ø4.8
PIATTAFORMA S2	PIATTAFORMA S3	PIATTAFORMA S4	PIATTAFORMA S5
AN1338	AN1367	AN1367	-
AN1342	AN1372	AN1372	-
AN1366	AN1375	AN1375	-



ANALOGO M.U.A. AN1604
Acciaio



TRANSFER M.U.A. AN1318
Titanio grado 5



MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN1226
Titanio grado 5



MONCONE CALCINABILE M.U.A. AN1253
Polimetilmetacrilato



MONCONE SALDATURA M.U.A. AN2774
Titanio grado 5



COMBY CHROME M.U.A. AN2327
Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato



ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275
Acciaio



DUAL SISTEM M.U.A. AN1332
CALCINABILE M.U.A. AN3106
Titanio grado 5
Polimetilmetacrilato



MICROVITE M.U.A. AN1274
VITE TRANSFER M.U.A. AN1423
VITE M.U.A. D.I.S. e (Esagono) AN3290
VITE M.U.A. D.I.S. t (Torx) AN3894
Titanio grado 5



VITE CERATURA M.U.A. CORTA AN1423
VITE CERATURA M.U.A. LUNGA AN2776
Titanio grado 5



INTRAORAL SCAN M.U.A. SCAN1001
Titanio grado 4




SCANBODY M.U.A. SCAN-M-PH
Alluminio Ergal Medicales








VITE PROTEZIONE M.U.A H 4.0 mm AN2258
Titanio grado 5

NOTE LEGALI
Phibo®, TSH® sono marchi registrati da PHIBO DENTAL SOLUTIONS, S.L.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

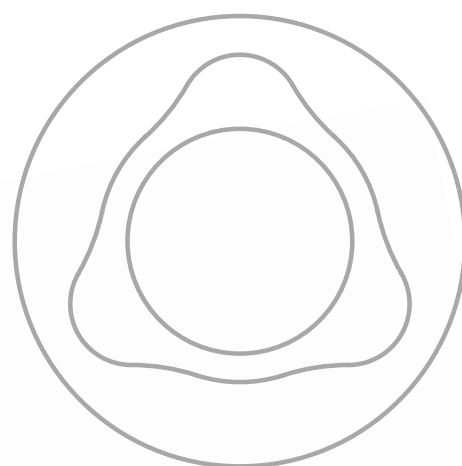

RSerie

	IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø4.3	IMPIANTI Ø5.0
	PIATTAFORMA NP	PIATTAFORMA RP	PIATTAFORMA WP
 ANALOGO Acciaio	AN1409	AN1410	AN1411
 TRANSFER OPEN TRAY Titanio grado 5	AN1926	AN1927	AN1928
 MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN1054	AN1929	AN1097
 MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 3.0 mm	AN1930	AN1932	AN1934
 MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm	AN1069	AN1070	AN1071
 MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 3.0 mm	AN1931	AN1933	AN1935
Titanio grado 5			
 MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN1415	AN1416	AN1417
 MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	AN1412	AN1413	AN1414
Polimetilmetacrilato			
 MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm	AN1447	AN1449	AN1451
 MONCONE ESTETICO DRITTO H 4.0 mm	AN1448	AN1450	AN1452
Titanio grado 5			
 MONCONE FRESABILE	AN1942	AN1943	AN1944
Titanio grado 5			
 MONCONE 15° H 1.5 mm	AN1453	AN1455	AN1457
 MONCONE 15° H 3.0 mm	AN1454	AN1456	AN1458
Titanio grado 5			
 VITE GUARIGIONE H 1.0 mm - P.E. 3.5	AN3076	-	-
 VITE GUARIGIONE H 1.0 mm - P.E. 4.3	-	AN3077	-
 VITE GUARIGIONE H 1.0 mm - P.E. 5.0	-	-	AN3078
 VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 3.5	AN1751	-	-
 VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 4.3	-	AN1951	-
 VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 5.0	-	-	AN1753
 VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 3.5	AN1752	-	-
 VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 4.3	-	AN1952	-
 VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 5.0	-	-	AN1953
Titanio grado 5			
 VITE PROTESICA	AN1923	AN1924	AN1924
 VITE TRANSFER	AN1925	AN2265	AN2265
 VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3274	AN3275	AN3275
 VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN4390	AN4391	AN4391
Titanio grado 5			
 COMBY CHROME ROTANTE	AN1936	AN1938	AN1940
 COMBY CHROME NON ROTANTE	AN1937	AN1939	AN1941
Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato			
 BASE "FOR PRESS" ROTANTE	AN2690	AN2691	-
 BASE "FOR PRESS" NON ROTANTE	AN2693	AN2694	-
Titanio grado 5			



DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN BODY

Titanio grado 4



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 144**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

PILASTRO SFERA NORMO H 1.0 mm

PILASTRO SFERA NORMO H 2.0 mm

PILASTRO SFERA NORMO H 3.0 mm

PILASTRO SFERA NORMO H 4.0 mm

PILASTRO SFERA NORMO H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 149**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø4.3	IMPIANTI Ø5.0
PIATTAFORMA NP	PIATTAFORMA RP	PIATTAFORMA WP
AN1973	AN1974	AN1975
AN2684	AN2685	AN2686
AN3101	AN3102	AN3103
AN1426	AN1427	AN1428
AN2687	AN2688	AN2689
AN3098	AN3099	AN3100
SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN W-R
SCAN N	SCAN R	SCAN W
SCAN 1050	SCAN 1051	SCAN 1052
AN2696	AN2701	-
AN2697	AN2702	-
AN2698	AN2703	-
AN2699	AN2704	-
AN2700	AN2705	-
AN1994 (R)	AN2198 (R)	AN4371 (R)
AN1995 (R)	AN2199 (R)	AN4372 (R)
AN2003 (R)	AN2200 (R)	AN4373 (R)
AN2066 (R)	AN2201 (R)	AN4374 (R)
AN2067 (R)	AN2202 (R)	AN4375 (R)
AN4376 (R)	AN4364 (R)	AN4383 (R)
AN4377 (R)	AN4365 (R)	AN4384 (R)
AN4378 (R)	AN4366 (R)	AN4385 (R)
AN4379 (R)	AN4367 (R)	AN4386 (R)
AN4380 (R)	AN4368 (R)	AN4387 (R)
AN4381 (R)	AN4369 (R)	AN4388 (R)
AN4382 (R)	AN4370 (R)	AN4389 (R)

	Ø3.5 (NP)	Ø4.1 (RP)	Ø5.0 (WP)	M.U.A.
	N.cm 20	N.cm 32	N.cm 35	N.cm 15
	M 1.6	M 2.0	M 2.0	M 1.4
	TX 5.5 mm	TX 5.5 mm	TX 5.5 mm	TX 5.5 mm

Chiavi inserimento m.u.a.



M.U.A. DRIVER for RATCHET LONG ST1106

M.U.A. DRIVER for RATCHET SHORT ST1107




M.U.A. DRIVER ST1001

SERRAGGIO

Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

ABUTMENT PROTESI AVVITATA



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm
M.U.A. DRITTO H 2.0 mm
M.U.A. DRITTO H 3.0 mm
M.U.A. DRITTO H 4.0 mm
 Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.0 mm
M.U.A. 17° H 3.0 mm
 Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.0 mm
M.U.A. 30° H 4.0 mm
 Titanio grado 5



VITE M.U.A. ANGOLATO
 Titanio grado 5



ANALOGO M.U.A. AN1604
 Acciaio



MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN1601
 Titanio grado 5



MONCONE SALDATURA M.U.A. AN2783
 Titanio grado 5



ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275
 Acciaio



MICROVITE M.U.A. AN1548
VITE TRANSFER M.U.A. AN1119
VITE M.U.A. D.I.S. e (Esagono) AN3290
VITE M.U.A. D.I.S. t (Torx) AN3894
 Titanio grado 5



INTRAORAL SCAN M.U.A. SCAN1000
 Titanio grado 4



VITE PROTEZIONE M.U.A H 4.0 mm AN1279
 Titanio grado 5



TRANSFER M.U.A. AN1603
 Titanio grado 5



MONCONE CALCINABILE M.U.A. AN1602
 Polimetilmetacrilato



COMBY CHROME M.U.A. AN2029
 Lega Cr.Co.
 Polimetilmetacrilato



DUAL SISTEM M.U.A. CALCINABILE M.U.A. AN1105
 AN3106
 Titanio grado 5
 Polimetilmetacrilato




VITE CERATURA M.U.A. CORTA AN1119
VITE CERATURA M.U.A. LUNGA AN2784
 Titanio grado 5





SCANBODY M.U.A. SCAN-M-B
 Alluminio Ergal Mediale

NOTE LEGALI

Brånemark®, Replace® e Active® sono marchi registrati da Nobel Biocare, AB SWEDEN.
 Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

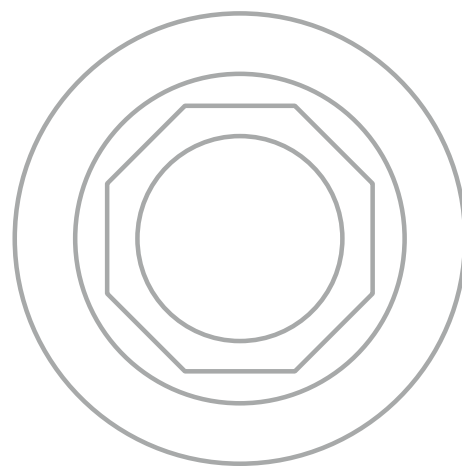

SSerie

		IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø3.3 Ø4.1 Ø4.8	IMPIANTI Ø6.5
		PIATTAFORMA NCC	PIATTAFORMA RN	PIATTAFORMA WN
	ANALOGO ADM	AN1726	AN3305	AN1727
	Acciaio			
	TRANSFER OPEN TRAY	AN1730	AN1731	AN1732
	VITE TRANSFER	AN1713	AN1771	AN1771
	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN1734	AN1050	AN1736
	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 3.0 mm	-	AN1624	-
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm	AN1735	AN1467	AN1737
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 3.0 mm	-	AN1623	-
	VITE PROTESICA	AN1768	AN1770	AN1770
	Titanio grado 5			
	MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN1738	AN1347	AN1740
	MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	AN1739	AN1072	AN1741
	VITE PROTESICA	AN1768	AN1486	AN1486
	Polimetilmetacrilato			
	FIG.1 MONCONE DRITTO ESTETICO	-	AN1469	AN1748
	FIG.2 RICAMBIO CUFFIA CALCINABILE (5pz)	-	AN1484	AN1237
	VITE PROTESICA	-	AN1303	AN1303
	VITE D.I.S.	-	AN3253	AN3253
	FIG.1 MONCONE FRESABILE	AN1749	AN1305	AN1750
	FIG.2 COMPONENTE PIENO 6° H 5.5 mm	-	AN1304	-
	FIG.2 COMPONENTE PIENO 6° H 7.0 mm	-	AN1238	-
	VITE PRIMARIA	AN1768	AN1486	AN1486
				
	Titanio grado 5			
	MONCONE 15° TIPO "A"	AN2765	AN1028	AN2767
	MONCONE 15° TIPO "B"	AN2766	AN1286	AN2768
	VITE PROTESICA	AN1768	AN1303	AN1303
	Titanio grado 5			
	MONCONE 20° TIPO "A"	-	AN1046	-
	MONCONE 20° TIPO "B"	-	AN1285	-
	VITE PROTESICA	-	AN1303	-
	Titanio grado 5			
	VITE GUARIGIONE H 1.5 mm - P.E. 4.5	AN2444	-	-
	VITE GUARIGIONE H 1.5 mm - P.E. 5.5	-	AN1760	-
	VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 5.5	-	AN1761	-
	VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 7.0	-	-	AN1765
	VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 4.5	AN1764	-	-
	VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 5.5	-	AN1762	-
	VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 7.0	-	-	AN1766
	VITE GUARIGIONE H 4.5 mm - P.E. 5.5	-	AN1763	-
	VITE GUARIGIONE H 4.5 mm - P.E. 7.0	-	-	AN1767
	VITE GUARIGIONE H 5.5 mm - P.E. 5.5	-	AN2266	-
	I-BASE H 0.75 mm	AN4814	AN4812	AN4813
	I-BASE H 1.5 mm	-	-	-
	I-BASE H 2.5 mm	-	-	-
	VITE PROTESICA	-	AN1486	AN1486
				
	Titanio grado 5			



COMBY CHROME ROTANTE
COMBY CHROME NON ROTANTE
VITE PROTESICA

Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato



DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm
CALCINABILE ROTANTE
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm
CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5



VITE PROTESICA CONICA NON ROTANTE
VITE CAD-CAM ROTANTE
VITE D.I.S. e (Esagono) ROTANTE
VITE D.I.S. e (Esagono) CONICA
VITE D.I.S. t (Torx) ROTANTE
VITE D.I.S. t (Torx) CONICA

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"




SCANBODY ROTANTE
SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN
VITE SCAN

Titanio grado 4



MONCONE CONNEKTOR H 0.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 144**



MONCONE SFERA H 0.0 mm
MONCONE SFERA H 1.0 mm
MONCONE SFERA H 2.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**

* i diametri Ø 4.8 possono essere utilizzati nei diametri maggiori Ø 6.5 creando platform switching

SU RICHIESTA 5 GIORNI LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE



SU RICHIESTA 5 GIORNI LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø3.3 Ø4.1 Ø4.8	IMPIANTI Ø6.5
PIATTAFORMA NCC	PIATTAFORMA RN	PIATTAFORMA WN
AN1746	AN1745	AN1309
AN2386	AN1744	AN1310
AN1768	AN1486	AN1486
AN1978	AN1102	AN1980
-	AN2770	-
AN3101	AN3102	AN3102
AN1436	AN1117	AN1979
-	AN2771	-
AN3098	AN3099	AN3099
AN1768	AN1486	AN1486
-	AN1770	AN1770
-	AN3252	AN3252
-	AN3221	AN3221
AN1138	AN4815	AN4815
AN4395	AN4396	AN4396
SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN R-R
SCAN N	SCAN R	SCAN R
SCAN1053	SCAN1054	SCAN1055
AN1768	AN1486	AN1486
-	AN2557	-
AN2563	AN2558	-
AN2564	AN2559	-
AN2565	AN2560	-
AN2566	AN2561	-
AN2567	AN2562	-
AN4392	AN1120	-
AN4393	AN1267	-
AN4392	AN1099	-
AN4410 (R)	AN4404 (R)	AN4398 (R)
AN4411 (R)	AN4405 (R)	AN4399 (R)
AN4412 (R)	AN4406 (R)	AN4400 (R)
AN4413 (R)	AN4407 (R)	AN4401 (R)
AN4414 (R)	AN4408 (R)	AN4402 (R)
AN4415 (R)	AN4409 (R)	AN4403 (R)

	Ø3.5 (NCC)	Ø3.5 (RN)	Ø6.5 (WN)	M.U.A.
	N.cm 20	N.cm 20	N.cm 30	N.cm 30
	M 1.6	M 2.0	M 2.0	M 2.0
	TX 6.0 mm	TX 6.0 mm	TX 6.0 mm	TX 6.0 mm

Chiavi inserimento OCTA



M.U.A. DRIVER for RATCHET ST1107



OCTA DRIVER ST1063

SERRAGGIO

Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

ABUTMENT PROTESI AVVITATA



* fare riferimento alla componentistica coordinata protesi avvitata D-Serie

OCTA DRITTO H 0.0 mm
OCTA DRITTO H 1.0 mm
OCTA DRITTO H 2.0 mm
OCTA DRITTO H 3.0 mm
OCTA DRITTO H 4.0 mm
OCTA DRITTO H 5.0 mm

Titanio grado 5

IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø3.3 Ø4.1 Ø4.8	IMPIANTI Ø6.5
PIATTAFORMA NCC	PIATTAFORMA RN	PIATTAFORMA WN
-	AN1758	AN1759
AN1287*	AN2247	-
-	AN2248	-
AN1701*	AN2249	-
-	AN2250	-
AN1693*	AN2251	-



ANALOGO OCTA Ø 4.8 mm AN1728
ANALOGO OCTA Ø 6.5 mm AN1729
Acciaio



TRANSFER OCTA Ø 4.8 mm AN1733
Titanio grado 5



**MONCONE PROVVISORIO
OCTA ROTANTE** Ø4.8 mm AN1773
Titanio grado 5



MONCONE CALCINABILE OCTA ROTANTE Ø 4.8 mm AN1743
MONCONE CALCINABILE OCTA NON ROTANTE Ø 4.8 mm AN1742
MONCONE CALCINABILE OCTA ROTANTE Ø 6.5 mm AN3146
Polimetilmetacrilato




DUAL SISTEM OCTA Ø4.8 mm AN1259
CALCINABILE OCTA AN3106
Titanio grado 5



COMBY CHROME OCTA Ø 4.8 mm AN2388
Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato



MICROVITE OCTA AN1769
VITE TRANSFER OCTA AN2423
VITE OCTA D.I.S. e (Esagono) AN3226
VITE OCTA D.I.S. t (Torx) AN4397
Titanio grado 5



VITE CERATURA OCTA CORTA AN2786
VITE CERATURA OCTA LUNGA AN2787
Titanio grado 5




INTRAORAL SCAN OCTA SCAN1093
Titanio grado 4



SCANBODY OCTA Ø4.8mm SCAN-M-RM
SCANBODY OCTA Ø6.5mm SCAN-M-WN
Alluminio Ergal Mediale


NOTE LEGALI
ITI®, Straumann®, Bone Level® marchi registrati da Straumann Holding AG, Svizzera.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

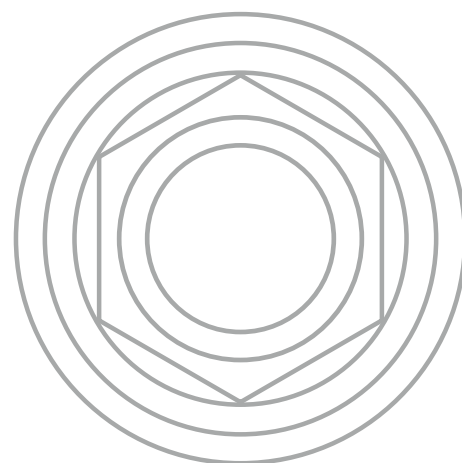


SHSerie

compatibile **SWEDEN®/SHELTA®/PREMIUM®/KOHNO ONE®**



	IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.8	IMPIANTI Ø4.25	IMPIANTI Ø5.0
	PIATTAFORMA Ø3.3	PIATTAFORMA Ø3.8	PIATTAFORMA Ø4.25	PIATTAFORMA Ø5.0
 ANALOGO Acciaio	AN1534	AN1101	AN4416	AN4417
 TRANSFER OPEN TRAY Titanio grado 5	AN1778	AN1781	AN4418	AN4419
 MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN1784	AN1786	AN4420	AN4422
 MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm	AN1785	AN1787	AN4421	AN4423
 MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN1350	AN1354	AN4424	AN4426
 MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	AN1260	AN1246	AN4425	AN4427
 MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.0 mm	AN1219	AN1217	-	-
 MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm	AN1793	AN1795	AN4429	AN4432
 MONCONE ESTETICO DRITTO H 4.0 mm	AN1794	AN1220	AN4430	AN4433
 MONCONE FRESABILE CILINDRICO	AN2122	AN1465	-	-
 MONCONE FRESABILE CONO ROVESCIO	AN2118	AN2119	-	-
 MONCONE 15° H 2.0 mm	AN1830	AN1806	AN4434	AN4435
 MONCONE 25° H 2.0 mm	AN1996	AN1808	AN4436	AN4437
 VITE GUARIGIONE H 2.0 mm	AN1810	AN1811	AN4438	AN4441
 VITE GUARIGIONE H 3.0 mm	AN1814	AN1815	AN4439	AN4442
 VITE GUARIGIONE H 5.0 mm	AN1818	AN1819	AN4440	AN4443
 VITE PROTESICA	AN1344	AN1344	AN1344	AN1344
 VITE TRANSFER	AN2390	AN2390	AN2390	AN2390
 PROTESICA D.I.S. Esa	AN3227	AN3227	AN3227	AN3227
 PROTESICA D.I.S. Torx	AN4331	AN4331	AN4331	AN4331
 I-BASE H 0.75 mm	AN3095	AN3094	AN4428	AN4431
 I-BASE H 1.5 mm	-	-	-	-
 I-BASE H 2.5 mm	-	-	-	-
 SCAN POST	AN3264	AN2593	-	-
 BASE "FOR PRESS" ROTANTE	-	AN2754	-	-
 BASE "FOR PRESS" NON ROTANTE	-	AN2756	-	-
 COMBY CHROME ROTANTE	AN1312	AN1313	AN4454	-
 COMBY CHROME NON ROTANTE	AN1792	AN1425	AN4455	-
Cr.Co. alloy Polimetilmetacrilato				



DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 0.8 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 2.0 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 3.0 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.8 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.0 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.0 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone

INTRAORAL SCAN BODY

Titanio grado 4



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 139**

* i diametri Ø5.0 possono essere utilizzati nei diametri minori Ø 4.25 creando platform switching



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm


MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 141**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm


MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.8	IMPIANTI Ø4.25	IMPIANTI Ø5.0
PIATTAFORMA Ø3.3	PIATTAFORMA Ø3.8	PIATTAFORMA Ø4.25	PIATTAFORMA Ø5.0
AN1038	-	-	-
-	AN1854	AN4444	AN4450
AN2758	-	-	-
-	AN2759	AN4445	AN4451
-	AN2760	AN4446	-
AN3101	AN3101	AN3102	AN3103
AN1107	-	-	-
-	AN1110	AN4447	AN4452
AN2471	-	-	-
-	AN2466	AN4448	AN4453
-	AN2467	AN4449	-
AN3098	AN3098	AN3099	AN3100
SCAN N-R	SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN W-R
SCAN N	SCAN N	SCAN R	SCAN W
SCAN 1011	SCAN 1012	SCAN 1012	SCAN 1012
AN2714	AN2719	*	*
AN2715	AN2720	*	*
AN2716	AN2721	*	*
AN2717	AN2722	*	*
AN2718	AN2723	*	*
AN1999 (R)	AN2276 (R)	AN4456 (R)	AN4490 (R)
AN2000 (R)	AN2277 (R)	AN4457 (R)	AN4491 (R)
AN2001 (R)	AN2278 (R)	AN4458 (R)	AN4492 (R)
AN2002 (R)	AN2279 (R)	AN4459 (R)	AN4493 (R)
AN4496 (R)	AN4498 (R)	AN4460 (R)	AN4494 (R)
AN4497 (R)	AN4499 (R)	AN4461 (R)	AN4495 (R)
AN4462 (R)	AN4483 (R)	AN4476 (R)	AN4469 (R)
AN4463 (R)	AN4484 (R)	AN4477 (R)	AN4470 (R)
AN4464 (R)	AN4485 (R)	AN4478 (R)	AN4471 (R)
AN4465 (R)	AN4486 (R)	AN4479 (R)	AN4472 (R)
AN4466 (R)	AN4487 (R)	AN4480 (R)	AN4473 (R)
AN4467 (R)	AN4488 (R)	AN4481 (R)	AN4474 (R)
AN4468 (R)	AN4489 (R)	AN4482 (R)	AN4475 (R)

	Ø3.3	Ø3.8	Ø4.25	Ø5.0	P.A.D.
	N.cm 25	N.cm 25	N.cm 25	N.cm 25	N.cm 15
	M 1.8	M 1.8	M 1.8	M 1.8	M 1.4
	ES 1.25 mm	ES 1.25 mm	ES 1.25 mm	ES 1.25 mm	ES 1.25 mm

ABUTMENT PROTESI AVVITATA



P.A.D. DRITTO H 1.0 mm

P.A.D. DRITTO H 2.0 mm

P.A.D. DRITTO H 3.0 mm

P.A.D. DRITTO H 4.0 mm

Titanio grado 5



P.A.D. 17° H 2.5 mm

Titanio grado 5

* i diametri Ø5.0 possono essere utilizzati nei diametri minori Ø 4.25 creando platform switching



P.A.D. 30° H 3.5 mm

Titanio grado 5

* i diametri Ø5.0 possono essere utilizzati nei diametri minori Ø 4.25 creando platform switching



VITE PROTESICA P.A.D.

Titanio grado 5

IMPIANTI
Ø3.3

PIATTAFORMA
Ø3.3

AN2501

AN2502

AN2503

AN2508

IMPIANTI
Ø3.8

PIATTAFORMA
Ø3.8

AN2491

AN2492

AN2493

AN2509

IMPIANTI
Ø4.25

PIATTAFORMA
Ø4.25

AN4504

AN4505

AN4506

AN4507

IMPIANTI
Ø5.0

PIATTAFORMA
Ø5.0

AN4508

AN4509

AN4510

AN4511

AN4500

AN2487

AN4502 (R)

AN4502 (R)*

AN4501

AN2488

AN4503 (R)

AN4503 (R)*

AN2497

AN2497

AN2497

AN2497



ANALOGO P.A.D.

Acciaio

AN1252



TRANSFER P.A.D.

Titanio grado 5

AN1251



MONCONE PROVVISORIO P.A.D.

Titanio grado 5

AN1208



MONCONE CALCINABILE P.A.D.

Polimetilmetacrilato

AN1215



MONCONE SALDATURA P.A.D.

Titanio grado 5

AN3139



COMBY CHROME P.A.D.

Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato

AN1420



VITE P.A.D. ANGOLATO

AN2497

MICROVITE P.A.D.

AN1274

VITE TRANSFER P.A.D.

AN2126

MICROVITE P.A.D. D.I.S. e (Esagono)

AN3290

MICROVITE P.A.D. D.I.S. t (Torx)

AN3894

Titanio grado 5



DUAL SISTEM P.A.D.

AN2005

CALCINABILE P.A.D.

AN5525

Titanio grado 5
Polimetilmetacrilato



INTRAORAL SCAN P.A.D.

Titanio grado 4

SCAN1085



VITE CERATURA P.A.D. CORTA

AN2126

VITE CERATURA P.A.D. LUNGA

AN2776

Titanio grado 5



VITE PROTEZIONE P.A.D. H 4.0 mm

Titanio grado 5

AN2785




SCANBODY P.A.D.

Alluminio Ergal Mediale


SCAN-M-SH


NOTE LEGALI

Sweden & Martina®, Khono®, Pilot®, Global®, Outlink® sono marchi registrati da Sweden & Martina Spa, ITALIA.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

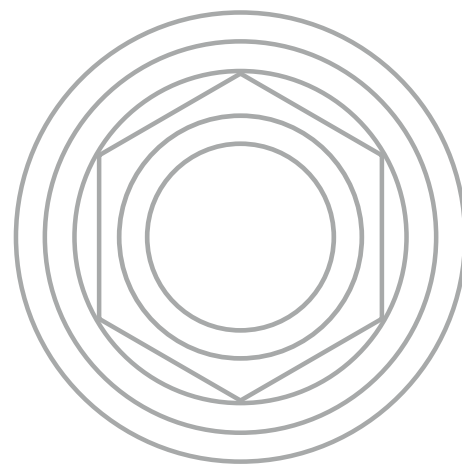

SKSerie
compatibile **SWEDEN®/PREMIUM®/KOHNO®**

	IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.8	IMPIANTI Ø4.25	IMPIANTI Ø5.0
	PIATTAFORMA Ø3.3	PIATTAFORMA Ø3.8	PIATTAFORMA Ø4.25	PIATTAFORMA Ø5.0
 ANALOGO Acciaio	AN1534	AN1101	AN1149	AN1323
 TRANSFER OPEN TRAY Titanio grado 5	AN1778	AN1781	AN1782	AN1783
 MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN1784	AN1786	AN1788	AN1790
 MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm	AN1785	AN1787	AN1789	AN1791
 MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN1350	AN1354	AN1358	AN1389
 MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	AN1260	AN1246	AN1339	AN1349
 MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.0 mm	AN1219	AN1217	AN1424	-
 MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm	AN1793	AN1795	AN1796	AN1798
 MONCONE ESTETICO DRITTO H 4.0 mm	AN1794	AN1220	AN1797	AN1799
 MONCONE FRESABILE CILINDRICO	AN2122	AN1465	AN1477	AN1478
 MONCONE FRESABILE CONO ROVERSCIO	AN2118	AN2119	AN2120	AN2121
 MONCONE 15° H 2.0 mm	AN1830	AN1806	AN1807	AN1221
 MONCONE 25° H 2.0 mm	AN1996	AN1808	AN1809	-
 VITE GUARIGIONE H 2.0 mm	AN1810	AN1811	AN1812	AN1813
 VITE GUARIGIONE H 3.0 mm	AN1814	AN1815	AN1816	AN1817
 VITE GUARIGIONE H 5.0 mm	AN1818	AN1819	AN1820	AN1821
 VITE PROTESICA	AN1344	AN1344	AN1346	AN1346
 VITE TRANSFER	AN2390	AN2390	AN1780	AN1780
 VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3227	AN3227	AN3228	AN3228
 VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN4331	AN4331	AN4332	AN4332
 I-BASE H 0.75 mm	AN3095	AN3094	AN3265	AN3205
 I-BASE H 1.5 mm	-	-	-	-
 I-BASE H 2.5 mm	-	-	-	-
 SCANPOST	AN3264	AN3263	AN3262	AN3263
 BASE "FOR PRESS" ROTANTE	-	AN2754 (E)	AN2755 (E)	-
 BASE "FOR PRESS" NON ROTANTE	-	AN2756 (E)	AN2757 (E)	-
 COMBY CHROME ROTANTE	AN1312	AN1313	AN1363	AN1364
 COMBY CHROME NON ROTANTE	AN1792	AN1425	AN2116	AN2117
Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato				



DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 0.8 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 2.0 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 3.0 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.8 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.0 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.0 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN BODY

Titanio grado 4



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 139**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA H 1.0 mm

MONCONE SFERA H 2.0 mm

MONCONE SFERA H 3.0 mm

MONCONE SFERA H 4.0 mm

MONCONE SFERA H 5.0 mm

MONCONE SFERA H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 141**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.8	IMPIANTI Ø4.25	IMPIANTI Ø5.0
PIATTAFORMA Ø3.3	PIATTAFORMA Ø3.8	PIATTAFORMA Ø4.25	PIATTAFORMA Ø5.0
DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm AN1038	-	-	-
DUAL SISTEM ROTANTE H 0.8 mm -	AN1854	AN1855	AN1857
DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm AN2758	-	-	-
DUAL SISTEM ROTANTE H 2.0 mm -	AN2759	AN2761	-
DUAL SISTEM ROTANTE H 3.0 mm -	AN2760	AN2762	-
CALCINABILE ROTANTE AN3101	AN3101	AN3102	AN3103
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm AN1107	-	-	-
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.8 mm -	AN1110	AN1114	AN1118
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm AN2471	-	-	-
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.0 mm -	AN2466	AN2468	-
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.0 mm -	AN2467	AN2469	-
CALCINABILE NON ROTANTE AN3098	AN3098	AN3099	AN3100
SCANBODY ROTANTE SCAN N-R	SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN W-R
SCANBODY NON ROTANTE SCAN N	SCAN N	SCAN R	SCAN W
INTRAORAL SCAN BODY SCAN 1011	SCAN 1012	SCAN 1013	SCAN 1014
MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm AN2714	AN2719	AN2724	AN2729
MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm AN2715	AN2720	AN2725	AN2730
MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm AN2716	AN2721	AN2726	AN2731
MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm AN2717	AN2722	AN2727	AN2732
MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm AN2718	AN2723	AN2728	AN2733
MONCONE SFERA H 1.0 mm AN1999	AN2276	AN2280	AN2411
MONCONE SFERA H 2.0 mm AN2000	AN2277	AN2281	AN2412
MONCONE SFERA H 3.0 mm AN2001	AN2278	AN2282	AN2413
MONCONE SFERA H 4.0 mm AN2002	AN2279	AN2283	AN2414
MONCONE SFERA H 5.0 mm AN4496	AN4498	AN4513	AN4511
MONCONE SFERA H 6.0 mm AN4497	AN4499	AN4514	AN4512
MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm AN4462 (R)	AN4483 (R)	AN4522 (R)	AN4515 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm AN4463 (R)	AN4484 (R)	AN4523 (R)	AN4516 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm AN4464 (R)	AN4485 (R)	AN4524 (R)	AN4517 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm AN4465 (R)	AN4486 (R)	AN4525 (R)	AN4518 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm AN4466 (R)	AN4487 (R)	AN4526 (R)	AN4519 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm AN4467 (R)	AN4488 (R)	AN4527 (R)	AN4520 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm AN4468 (R)	AN4489 (R)	AN4528 (R)	AN4521 (R)

	Ø3.3	Ø3.8	Ø4.25	Ø5.0	P.A.D.
	N.cm 25	N.cm 25	N.cm 32	N.cm 32	N.cm 15
	M 1.8	M 1.8	M 2.0	M 2.0	M 1.4
	ES 1.25 mm	ES 1.25 mm	ES 1.25 mm	ES 1.25 mm	ES 1.25 mm

ABUTMENT PROTESI AVVITATA



P.A.D. DRITTO H 1.0 mm
P.A.D. DRITTO H 2.0 mm
P.A.D. DRITTO H 3.0 mm
P.A.D. DRITTO H 4.0 mm
 Titanio grado 5



P.A.D. 17° H 2.5 mm
 Titanio grado 5



P.A.D. 30° H 3.5 mm
 Titanio grado 5



VITE PROTESICA P.A.D.
 Titanio grado 5

IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.8	IMPIANTI Ø4.25	IMPIANTI Ø5.0
PIATTAFORMA Ø3.3	PIATTAFORMA Ø3.8	PIATTAFORMA Ø4.25	PIATTAFORMA Ø5.0
AN2501	AN2491	AN2494	AN2504
AN2502	AN2492	AN2495	AN2505
AN2503	AN2493	AN2496	AN2506
AN2508	AN2509	AN2510	AN2507
-	AN2487	AN2490	-
-	AN2488	AN2489	-
-	AN2497	AN2498	-



ANALOGO P.A.D. AN1252
 Acciaio



MONCONE PROVVISORIO P.A.D. AN1208
 Titanio grado 5



MONCONE SALDATURA P.A.D. AN3139
 Titanio grado 5



MICROVITE P.A.D. AN1274
VITE TRANSFER P.A.D. AN2126
MICROVITE P.A.D. D.I.S. e (Esagono) AN3290
MICROVITE P.A.D. D.I.S. t (Torx) AN3894
 Titanio grado 5



INTRAORAL SCAN P.A.D. SCAN1085
 Titanio grado 4



VITE PROTEZIONE P.A.D. H 4.0 mm AN2785
 Titanio grado 5



TRANSFER P.A.D. AN1251
 Titanio grado 5



MONCONE CALCINABILE P.A.D. AN1215
 Polimetilmetacrilato



COMBY CHROME P.A.D. AN1420
 Lega Cr.Co.
 Polimetilmetacrilato



DUAL SISTEM P.A.D. AN2005
CALCINABILE P.A.D. AN5525
 Titanio grado 5
 Polimetilmetacrilato




VITE CERATURA P.A.D. SHORT AN2126
VITE CERATURA P.A.D. LONG AN2776
 Titanio grado 5



SCANBODY P.A.D. SCAN-M-SK
 Alluminio Ergal Mediale

NOTE LEGALI

Sweden & Martina®, Khono®, Pilot®, Global®, Outlink® sono marchi registrati da Sweden & Martina Spa, ITALIA.
 Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

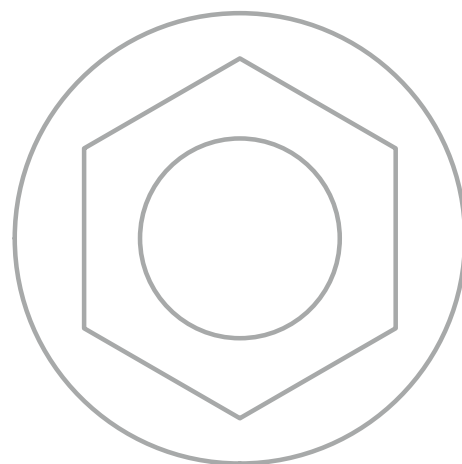

SOSerie
compatibile **SWEDEN®/OUTLINK®/SYRA®**

		IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.75 / Ø3.8 Ø4.1 / Ø4.25	IMPIANTI Ø5.0
		PIATTAFORMA Ø3.3	PIATTAFORMA Ø4.10	PIATTAFORMA Ø5.0
	ANALOGO	AN2172	AN1539	AN1140
	Acciaio			
	TRANSFER OPEN TRAY	AN2222	AN2223	AN2224
	Titano grado 5			
	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN2225	AN2227	AN2229
	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 3.0 mm	-	AN2231	-
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm	AN2226	AN2228	AN2230
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE - H 3.0 mm	-	AN2232	-
	Titano grado 5			
	MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN1213	AN2233	AN2234
	MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	AN2235	AN2236	AN2237
	Polimetilmetacrilato			
	MONCONE SALDATURA	-	AN3199	AN3200
	Titano grado 5			
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.0 mm	-	AN2238	AN2392
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm	AN1984	AN2055	AN2240
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm	-	AN2239	AN2393
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 4.0 mm	AN1985	AN2056	AN2241
	Titano grado 5			
	MONCONE FRESABILE	AN2242	AN2243	AN2244
	MONCONE FRESABILE ANGOLATO 25°	-	AN3163	-
	Titano grado 5			
	MONCONE 15° H 2.0 mm	-	AN2245	AN2253
	MONCONE 15° H 4.0 mm	-	AN2246	AN2254
	Titano grado 5			
	MONCONE 25° H 2.0 mm	-	AN2255	AN2706
	MONCONE 25° H 4.0 mm	-	AN2256	AN2707
	Titano grado 5			
	VITE PROTESICA	AN1344	AN1346	AN1346
	VITE TRANSFER	AN2390	AN2390	AN1780
	VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3227	AN3228	AN3228
	VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN4331	AN4332	AN4332
	Titano grado 5			
	BASE "FOR PRESS" ROTANTE	-	AN2710 (E)	-
	BASE "FOR PRESS" NON ROTANTE	-	AN2712 (E)	-
	Titano grado 5			
	COMBY CHROME ROTANTE	AN2173	AN2174	AN2175
	COMBY CHROME NON ROTANTE	AN2502	AN2053	AN2054
	Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato			



DUAL SISTEM ROTANTE H 1.0 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 2.0 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 3.0 mm
CALCINABILE ROTANTE
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.0 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.0 mm
CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE
SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN BODY

Titanio grado 4



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 139**

* i diametri Ø 4.1 possono essere utilizzati nei diametri maggiori Ø 5.0 creando platform switching



SU RICHIESTA 5 GIORNI LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 141**

* i diametri Ø 4.1 possono essere utilizzati nei diametri maggiori Ø 5.0 creando platform switching



SU RICHIESTA 5 GIORNI LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE


MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.75 / Ø3.8 Ø4.1 / Ø4.25	IMPIANTI Ø5.0
PIATTAFORMA Ø3.3	PIATTAFORMA Ø4.10	PIATTAFORMA Ø5.0
AN2176	AN2177	AN2178
-	AN2180	-
-	AN2475	-
AN3101	AN3102	AN3103
AN2179	AN2708	AN2181
-	AN2709	-
-	AN2476	-
AN3098	AN3099	AN3100
SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN W-R
SCAN N	SCAN R	SCAN W
SCAN1056	SCAN1057	SCAN1058
-	AN2552	AN2552*
-	AN2553	AN2553*
-	AN2554	AN2554*
-	AN2555	AN2555*
-	AN2556	AN2556*
AN3089	AN2541	AN2541*
AN3090	AN2542	AN2542*
AN3091	AN2543	AN2543*
AN3092	AN2544	AN2544*
AN3093	AN2545	AN2545*
AN3745 (R)	AN4505 (R)	AN4324 (R)
AN3746 (R)	AN4506 (R)	AN4325 (R)
AN3747 (R)	AN4507 (R)	AN4326 (R)
AN3748 (R)	AN4508 (R)	AN4327 (R)
AN3749 (R)	AN4509 (R)	AN4328 (R)
AN3750 (R)	AN4510 (R)	AN4329 (R)
AN3751 (R)	AN4511 (R)	AN4330 (R)

	Ø3.3	Ø4.1	Ø5.0	P.A.D.
	N.cm 25	N.cm 25	N.cm 32	N.cm 15
	M 1.8	M 2.0	M 2.0	M 1.4
	ES 1.25 mm	ES 1.25 mm	ES 1.25 mm	ES 1.25 mm

ABUTMENT PROTESI AVVITATA



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm

M.U.A. DRITTO H 2.0 mm

M.U.A. DRITTO H 3.0 mm

M.U.A. DRITTO H 4.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.0 mm

M.U.A. 17° H 3.0 mm

M.U.A. 17° H 4.0 mm

Titanio grado 5

* i diametri Ø 4.1 possono essere utilizzati nei diametri Ø 5.0 creando platform switching



M.U.A. 30° H 3.0 mm

M.U.A. 30° H 4.0 mm

Titanio grado 5

* i diametri Ø 4.1 possono essere utilizzati nei diametri Ø 5.0 creando platform switching



VITE PROTESICA M.U.A.

Titanio grado 5

* i diametri Ø 4.1 possono essere utilizzati nei diametri Ø 5.0 creando platform switching



ANALOGO M.U.A.

Acciaio

AN1604



MONCONE PROVVISORIO M.U.A.

Titanio grado 5

AN1226



MONCONE SALDATURA M.U.A.

Titanio grado 5

AN2774



MICROVITE M.U.A.

VITE TRANSFER M.U.A.

MICROVITE M.U.A. D.I.S. e (Esagono)

MICROVITE M.U.A. D.I.S. t (Torx)

Titanio grado 5

AN1274

AN1423

AN3290

AN3894



INTRAORAL SCAN M.U.A.

Titanio grado 4

SCAN1001



VITE PROTEZIONE M.U.A. H 4.0 mm

Titanio grado 5

AN2258



TRANSFER M.U.A.

Titanio grado 5

AN1318



MONCONE CALCINABILE M.U.A.

Polimetilmetacrilato

AN1215



COMBY CHROME M.U.A.

Lega Cr.Co.

Polimetilmetacrilato

AN2327



DUAL SISTEM M.U.A.

CALCINABILE M.U.A.

Titanio grado 5

Polimetilmetacrilato

AN1332

AN3106



VITE CERATURA M.U.A. SHORT

VITE CERATURA M.U.A. LONG

Titanio grado 5

AN1723

AN2776




SCANBODY M.U.A.

Alluminio Ergal Mediale


SCAN-M-SO

NOTE LEGALI

Sweden & Martina®, Khono®, Pilot®, Global®, Outlink® sono marchi registrati da Sweden & Martina Spa, ITALIA.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

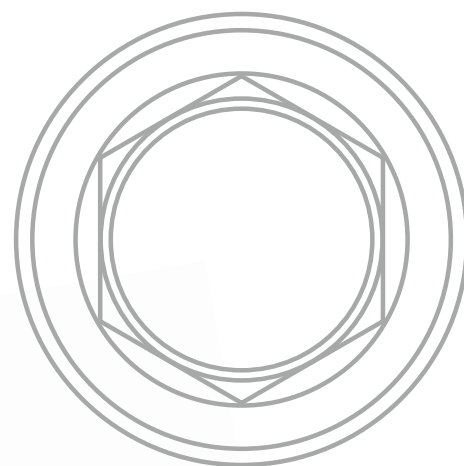


TSerie
compatibile **THOMMEN®**

	IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø4.0	IMPIANTI Ø4.5
	PIATTAFORMA YELLOW	PIATTAFORMA GREEN	PIATTAFORMA BLUE
 ANALOGO Acciaio	AN2924	AN2925	AN2926
 MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN2933	AN2934	AN2935
 MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE Polimetilmetacrilato	AN2936	AN2937	AN2938
 MONCONE ESTETICO H 0.5 mm	AN3416	AN3417	AN3418
 MONCONE ESTETICO H 2.0 mm Titanio grado 5	AN3419	AN3420	AN3421
 MONCONE 20° H 0.5 mm	AN4537	AN4538	AN4539
 MONCONE 20° H 3.0 mm Titanio grado 5	AN4540	AN4541	AN4542
 VITE PROTESICA	AN3096	AN2942	AN2942
 VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3756	AN3757	AN3757
 VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx) Titanio grado 5	AN4621	AN4622	AN4622
 COMBY CHROME ROTANTE	AN2927	AN2928	AN2929
 COMBY CHROME NON ROTANTE Cromo cobalto Polimetilmetacrilato	AN2954	AN2415	AN2416
 DUAL SISTEM ROTANTE H 0.8 mm	AN2943	AN2944	AN2945
 CALCINABILE ROTANTE	AN5526	AN3101	AN3102
 DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.8 mm	AN2946	AN2947	AN2948
 CALCINABILE NON ROTANTE Titanio grado 5 ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE. N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera e riceverete vite D.I.S. testa esagonale N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera t riceverete vite D.I.S. testa torx N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"	AN5526	AN3098	AN3099
 SCANBODY ROTANTE	SCAN S-R	SCAN N-R	SCAN R-R
 SCANBODY NON ROTANTE Poli-Eter-Eter-Chetone	SCAN S	SCAN N	SCAN R
 INTRAORAL SCAN BODY Titanio grado 4	SCAN1059	SCAN1060	SCAN1061
 PILASTRO SFERA NORMO H 1.0 mm	AN4582 (R)	AN4608 (R)	AN4595 (R)
 PILASTRO SFERA NORMO H 2.0 mm	AN4583 (R)	AN4609 (R)	AN4596 (R)
 PILASTRO SFERA NORMO H 3.0 mm	AN4584 (R)	AN4610 (R)	AN4597 (R)
 PILASTRO SFERA NORMO H 4.0 mm	AN4585 (R)	AN4611 (R)	AN4598 (R)
 PILASTRO SFERA NORMO H 5.0 mm	AN4586 (R)	AN4612 (R)	AN4599 (R)
 PILASTRO SFERA NORMO H 6.0 mm Titanio grado 5 Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN	AN4587 (R)	AN4613 (R)	AN4600 (R)
 MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm	AN4601 (R)	AN4588 (R)	AN4514 (R)
 MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm	AN4602 (R)	AN4589 (R)	AN4515 (R)
 MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm	AN4603 (R)	AN4590 (R)	AN4516 (R)
 MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm	AN4604 (R)	AN4591 (R)	AN4517 (R)
 MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm	AN4605 (R)	AN4592 (R)	AN4518 (R)
 MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm	AN4606 (R)	AN4593 (R)	AN4519 (R)
 MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm Titanio grado 5 Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE	AN4607 (R)	AN4594 (R)	AN4520 (R)

	Ø3.5	Ø4.0	Ø4.5
	N.cm 15	N.cm 25	N.cm 25
	M 1.4	M 1.6	M 1.6
	QUADRILOBO	QUADRILOBO	QUADRILOBO

ABUTMENT PROTESI AVVITATA



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm
M.U.A. DRITTO H 2.0 mm
M.U.A. DRITTO H 3.0 mm

Titanio grado 5

IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø4.0	IMPIANTI Ø4.5
PIATTAFORMA YELLOW	PIATTAFORMA GREEN	PIATTAFORMA BLUE
AN3164	AN2517	AN2514
AN3165	AN2518	AN2515
AN3166	AN2519	AN2516



ANALOGO M.U.A.

Acciaio

AN1604



MONCONE PROVVISORIO M.U.A.

Titanio grado 5

AN3153



MONCONE SALDATURA M.U.A.

Titanio grado 5

AN3154



MICROVITE M.U.A.

AN3156

VITE TRANSFER M.U.A.

AN3157

MICROVITE M.U.A. D.I.S. e (Esagono)

AN3290

MICROVITE M.U.A. D.I.S. t (Torx)

AN3894

Titanio grado 5



INTRAORAL SCAN M.U.A.

SCAN1097

Titanio grado 4



TRANSFER M.U.A.

Titanio grado 5

AN3158



MONCONE CALCINABILE M.U.A.

Polimetilmetacrilato

AN3159



COMBY CHROME M.U.A.

Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato

AN3161



DUAL SISTEM M.U.A.

AN3155

CALCINABILE M.U.A.

AN3106

Titanio grado 5
Polimetilmetacrilato



VITE PROTEZIONE M.U.A. H 4.0 mm

AN3162

Titanio grado 5




SCANBODY M.U.A.

Alluminio Ergal Mediale

SCAN-M-T

NOTE LEGALI

THOMMEN MEDICAL® è un marchio registrato da Thommen Medical AG in Waldenburg, CH4437.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

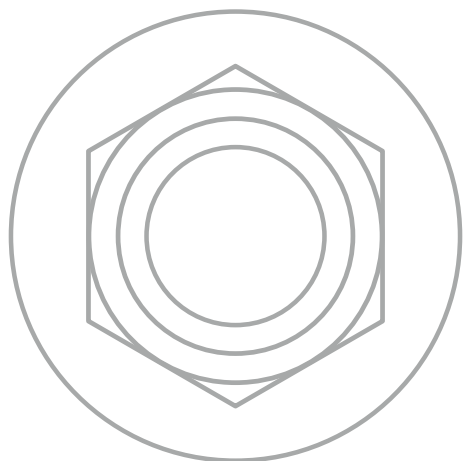

WXSerie

compatibile **WINSIX**®





ANALOGO

Acciaio

TRANSFER OPEN TRAY

Titanio grado 5

MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm

Titanio grado 5

MONCONE CALCINABILE ROTANTE

MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

Polimetilmetacrilato

MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm

Titanio grado 5

MONCONE FRESABILE P.E. 4.5

MONCONE FRESABILE P.E. 5.0

MONCONE FRESABILE P.E. 6.0

Titanio grado 5

MONCONE 15° H 2.0 mm

Titanio grado 5

VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 3.0 mm

VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 5.0 mm

VITE GUARIGIONE DRITTA H 3.0 mm

VITE GUARIGIONE DRITTA H 5.0 mm

Titanio grado 5

VITE PROTESICA

VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)

VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)

Titanio grado 5

COMBY CHROME ROTANTE

COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.

Polimetilmetacrilato

IMPIANTI
Ø3.3

PIATTAFORMA
Ø3.5

AN1091

AN3079

AN1227

AN2296

AN1986

AN2006

AN1989

AN2009

-

-

AN2213

-

AN1078

AN1322

AN1340

AN1242

AN4816

AN2962

AN2219

AN2216

IMPIANTI
Ø3.8

PIATTAFORMA
Ø4.0

AN1249

AN3080

AN1231

AN2297

AN1987

AN2007

AN1990

-

AN2010

-

AN2214

AN1080

AN1081

AN1077

AN2400

AN1242

AN4816

AN2962

AN2220

AN2217

IMPIANTI
Ø4.5

PIATTAFORMA
Ø4.5

AN1335

AN3081

AN1233

AN1236

AN1988

AN2008

AN2212

-

-

AN2011

AN2215

AN1992

-

AN1079

AN2401

AN1242

AN4816

AN2962

AN2221

AN2218



DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE


SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN BODY

Titanio grado 4



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm


MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm


Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

	IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.8	IMPIANTI Ø4.5
	PIATTAFORMA Ø3.5	PIATTAFORMA Ø4.0	PIATTAFORMA Ø4.5
AN1301	AN1301	AN1357	AN1065
AN3102	AN3102	AN3102	AN3102
AN1108	AN1108	AN1111	AN1115
AN3098	AN3098	AN3099	AN3099
SCAN N-R	SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN R-R
SCAN N	SCAN N	SCAN R	SCAN R
SCAN1005	SCAN1005	SCAN1005	SCAN1005
AN4550 (R)	AN4550 (R)	AN4563 (R)	AN4576 (R)
AN4551 (R)	AN4551 (R)	AN4564 (R)	AN4577 (R)
AN4552 (R)	AN4552 (R)	AN4565 (R)	AN4578 (R)
AN4553 (R)	AN4553 (R)	AN4566 (R)	AN4579 (R)
AN4554 (R)	AN4554 (R)	AN4567 (R)	AN4580 (R)
AN4555 (R)	AN4555 (R)	AN4568 (R)	AN4581 (R)
AN4569 (R)	AN4569 (R)	AN4543 (R)	AN4556 (R)
AN4570 (R)	AN4570 (R)	AN4544 (R)	AN4557 (R)
AN4571 (R)	AN4571 (R)	AN4545 (R)	AN4558 (R)
AN4572 (R)	AN4572 (R)	AN4546 (R)	AN4559 (R)
AN4573 (R)	AN4573 (R)	AN4547 (R)	AN4560 (R)
AN4574 (R)	AN4574 (R)	AN4548 (R)	AN4561 (R)
AN4575 (R)	AN4575 (R)	AN4549 (R)	AN4562 (R)


	Ø3.3	Ø3.8	Ø4.5
	N.cm 32	N.cm 32	N.cm 32
	M 2.0	M 2.0	M 2.0
	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm

NOTE LEGALI

Win Six® è un marchio registrato di BioSAF EUROPE
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

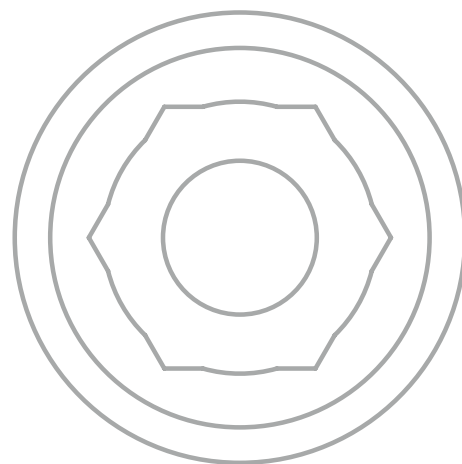

ZSerie



ANALOGO

Acciaio

A. TRANSFER OPEN TRAY

B. TRANSFER CLOSED TRAY

C. UNIVERSAL IMPRESSION CAP

Titanio grado 5

Polimetilmetacrilato



MONCONE PROVVISORIO ROTANTE - H 1.5 mm

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE - H 1.5 mm

Titanio grado 5



MONCONE CALCINABILE ROTANTE

MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

Polimetilmetacrilato



MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 4.5

MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 5.5

MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 6.5

MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 4.5

MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 5.5

MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 6.5

Titanio grado 5



MONCONE FRESABILE P.E. 3.8

MONCONE FRESABILE P.E. 4.5

MONCONE FRESABILE P.E. 5.5

MONCONE FRESABILE P.E. 6.0

Titanio grado 5



MONCONE 15° H 2.0 mm - P.E. 4.5

MONCONE 15° H 2.0 mm - P.E. 5.5

MONCONE 15° H 4.0 mm - P.E. 4.5

MONCONE 15° H 4.0 mm - P.E. 5.5

Titanio grado 5



MONCONE 25° H 2.0 mm - P.E. 4.5

MONCONE 25° H 2.0 mm - P.E. 5.5

MONCONE 25° H 4.0 mm - P.E. 4.5

MONCONE 25° H 4.0 mm - P.E. 5.5

Titanio grado 5



VITE GUARIGIONE H 2.0 mm

VITE GUARIGIONE H 3.0 mm

VITE GUARIGIONE H 4.0 mm

VITE GUARIGIONE H 5.0 mm

VITE GUARIGIONE H 7.0 mm

Titanio grado 5



VITE PROTESICA

VITE TRANSFER

VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)

VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)

Titanio grado 5



I-BASE H 0.5 mm

I-BASE H 1.5 mm

I-BASE H 2.5 mm

Titanio grado 5

IMPIANTI Ø3.7-Ø4.1	IMPIANTI Ø4.7	IMPIANTI Ø6.0
PIATTAFORMA Ø3.5	PIATTAFORMA Ø4.5	PIATTAFORMA Ø5.7
AN1169	AN1056	AN1055
AN1824	AN1825	-
AN2602	-	-
AN3136	-	-
AN1224	AN1142	-
AN1148	AN1098	-
AN1831	AN1833	AN2109
AN1832	AN1834	AN2108
AN1839	-	-
-	AN1840	-
-	-	AN1841
AN1842	-	-
AN2595	AN1843	-
-	-	AN1844
AN2470	-	-
AN1147	AN1095	-
AN1829	AN1152	-
-	-	AN1712
AN1209	-	-
AN2596	AN1355	-
AN2597	-	-
AN2598	-	-
AN1155	-	-
AN2599	AN1094	-
AN2600	-	-
AN2601	-	-
AN1845	-	-
AN1867	AN1846	AN1847
AN1848	-	-
AN1853	AN1849	AN1850
AN1851	AN1852	-
AN1075	AN1075	AN1075
AN1779	AN1779	AN1779
AN3229	AN3229	AN3229
AN3923	AN3923	AN3923
AN3172	AN3309	-
AN3173	AN3310	-
AN3174	AN3311	-



BASE FOR PRESS ROTANTE
BASE FOR PRESS NON ROTANTE

Titanio grado 5



COMBY CHROME ROTANTE
COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato



DUAL SISTEM ROTANTE - H 0.5 mm
DUAL SISTEM ROTANTE - H 1.5 mm
DUAL SISTEM ROTANTE - H 2.5 mm
CALCINABILE ROTANTE
DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 0.5 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 1.5 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 2.5 mm
CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **R** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE
SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone




INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4



MONCONE CONNECTOR H 1.0 mm
MONCONE CONNECTOR H 2.0 mm
MONCONE CONNECTOR H 3.0 mm
MONCONE CONNECTOR H 4.0 mm
MONCONE CONNECTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 139**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**

* Prodotto su richiesta



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

* Prodotto su richiesta

	Ø3.5	Ø4.5	Ø5.7	M.U.A.
	N.cm 30	N.cm 30	N.cm 30	N.cm 15
	M 1.72 UNF	M 1.72 UNF	M 1.72 UNF	M 1.4
	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm

	IMPIANTI Ø4.1	IMPIANTI Ø4.7	IMPIANTI Ø6.0
	PIATTAFORMA Ø3.5	PIATTAFORMA Ø4.5	PIATTAFORMA Ø5.7
BASE FOR PRESS ROTANTE	AN2604	-	-
BASE FOR PRESS NON ROTANTE	AN2603	-	-
COMBY CHROME ROTANTE	AN1836	AN1838	AN1879
COMBY CHROME NON ROTANTE	AN1835	AN1837	AN1880
DUAL SISTEM ROTANTE - H 0.5 mm	AN1331	AN1353	AN1964
DUAL SISTEM ROTANTE - H 1.5 mm	AN2448	AN2457	-
DUAL SISTEM ROTANTE - H 2.5 mm	AN2454	AN2458	-
CALCINABILE ROTANTE	AN3101	AN3102	AN3103
DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 0.5 mm	AN1429	AN1430	AN1431
DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 1.5 mm	AN2459	AN2819	-
DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 2.5 mm	AN2461	AN2820	-
CALCINABILE NON ROTANTE	AN3098	AN3099	AN3100
SCANBODY ROTANTE	SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN W-R
SCANBODY NON ROTANTE	SCAN N	SCAN R	SCAN W
INTRAORAL SCAN	SCAN1004	SCAN1006	SCAN1025
MONCONE CONNECTOR H 1.0 mm	AN2482	AN2636	-
MONCONE CONNECTOR H 2.0 mm	AN2483	AN2637	-
MONCONE CONNECTOR H 3.0 mm	AN2484	AN2638	-
MONCONE CONNECTOR H 4.0 mm	AN2485	AN2639	-
MONCONE CONNECTOR H 5.0 mm	AN2486	AN2640	-
MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm	AN1093 (R)	AN3771 (R)	AN3916 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm	AN1092 (R)	AN3772 (R)	AN3917 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm	AN1125 (R)	AN3773 (R)	AN3918 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm	AN1126 (R)	AN3774 (R)	AN3919 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm	AN1234 (R)	AN3775 (R)	AN3920 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm	AN3892 (R)	AN3776 (R)	AN3921 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm	AN3764 (R)	AN3781 (R)	AN3924 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm	AN3765 (R)	AN3782 (R)	AN3925 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm	AN3766 (R)	AN3783 (R)	AN3926 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm	AN3767 (R)	AN3784 (R)	AN3927 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm	AN3768 (R)	AN3785 (R)	AN3928 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm	AN3769 (R)	AN3786 (R)	AN3929 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm	AN3770 (R)	AN3787 (R)	AN3930 (R)

Chiavi inserimento m.u.a.




M.U.A. DRIVER for RATCHET LONG ST1106

M.U.A. DRIVER for RATCHET SHORT ST1107

M.U.A. DRIVER ST1001

SERRAGGIO
Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

ABUTMENT PROTESI AVVITATA



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm
M.U.A. DRITTO H 2.0 mm
M.U.A. DRITTO H 3.0 mm
M.U.A. DRITTO H 4.0 mm
M.U.A. DRITTO H 5.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.5 mm
M.U.A. 17° H 3.5 mm
M.U.A. 17° H 4.5 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.5 mm
M.U.A. 30° H 4.5 mm
M.U.A. 30° H 5.5 mm

Titanio grado 5

**M.U.A. 45°** H 3.5 mm

Titanio grado 5

**VITE M.U.A. ANGOLATO**

Titanio grado 5

**ANALOGO M.U.A.**

Acciaio

AN1604

**MONCONE PROVVISORIO M.U.A.**

Titanio grado 5

AN1226

**MONCONE SALDATURA M.U.A.**

Titanio grado 5

AN2774

**ANALOGO PROTEZIONE M.U.A.**

Acciaio

AN2275

**VITE M.U.A. ANGOLATO**

AN1720

MICROVITE M.U.A.

AN1274

VITE TRANSFER M.U.A.

AN1423

MICROVITE M.U.A. D.I.S. e (Esagono)

AN3290

MICROVITE M.U.A. D.I.S. t (Torx)

AN3894

Titanio grado 5

**INTRAORAL SCAN M.U.A.**

SCAN1001

Titanio grado 4

**VITE PROTEZIONE M.U.A** H 4.0 mm

AN2258

Titanio grado 5

**TRANSFER M.U.A.**

Titanio grado 5

AN1318

**MONCONE CALCINABILE M.U.A.**

Polimetilmetacrilato

AN1253

**COMBY CHROME M.U.A.**

Lega Cr.Co.

Polimetilmetacrilato

AN2327

**DUAL SISTEM M.U.A.**

AN1332

CALCINABILE M.U.A

AN3106

Titanio grado 5

Polimetilmetacrilato

**VITE CERATURA M.U.A. CORTA**

AN1423

VITE CERATURA M.U.A. LUNGA

AN2776

Titanio grado 5

**SCANBODY M.U.A.**

SCAN-M-Z

Alluminio Ergal Mediale

NOTE LEGALI

Zimmer® e Screw Vent™ sono marchi registrati da Zimmer Dental INC, USA.

Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

SOLUZIONI OVERDENTURE


L'overdenture su impianti rappresenta un'opzione terapeutica relativamente semplice con un buon rapporto costo-beneficio per molti pazienti. In alcuni casi non è necessario realizzare una nuova protesi in quanto è possibile utilizzare la protesi del paziente. L'overdenture su impianti può essere utilizzata anche come protesi provvisoria.

L'overdenture può essere fissata all'impianto in tre modi:

- Moncone Connector
- Moncone a sfera
- Moncone per barra

I monconi a sfera sono tradizionalmente utilizzati nella mandibola, su due impianti. L'overdenture fissata su barra può avere una struttura rigida (impianti multipli) o resiliente (due impianti).

Il Moncone Connector è indicato in caso di protesi totali o parziali supportate da impianti nell'arcata superiore o inferiore. Il design auto-posizionante permette ai pazienti di applicare facilmente la protesi.

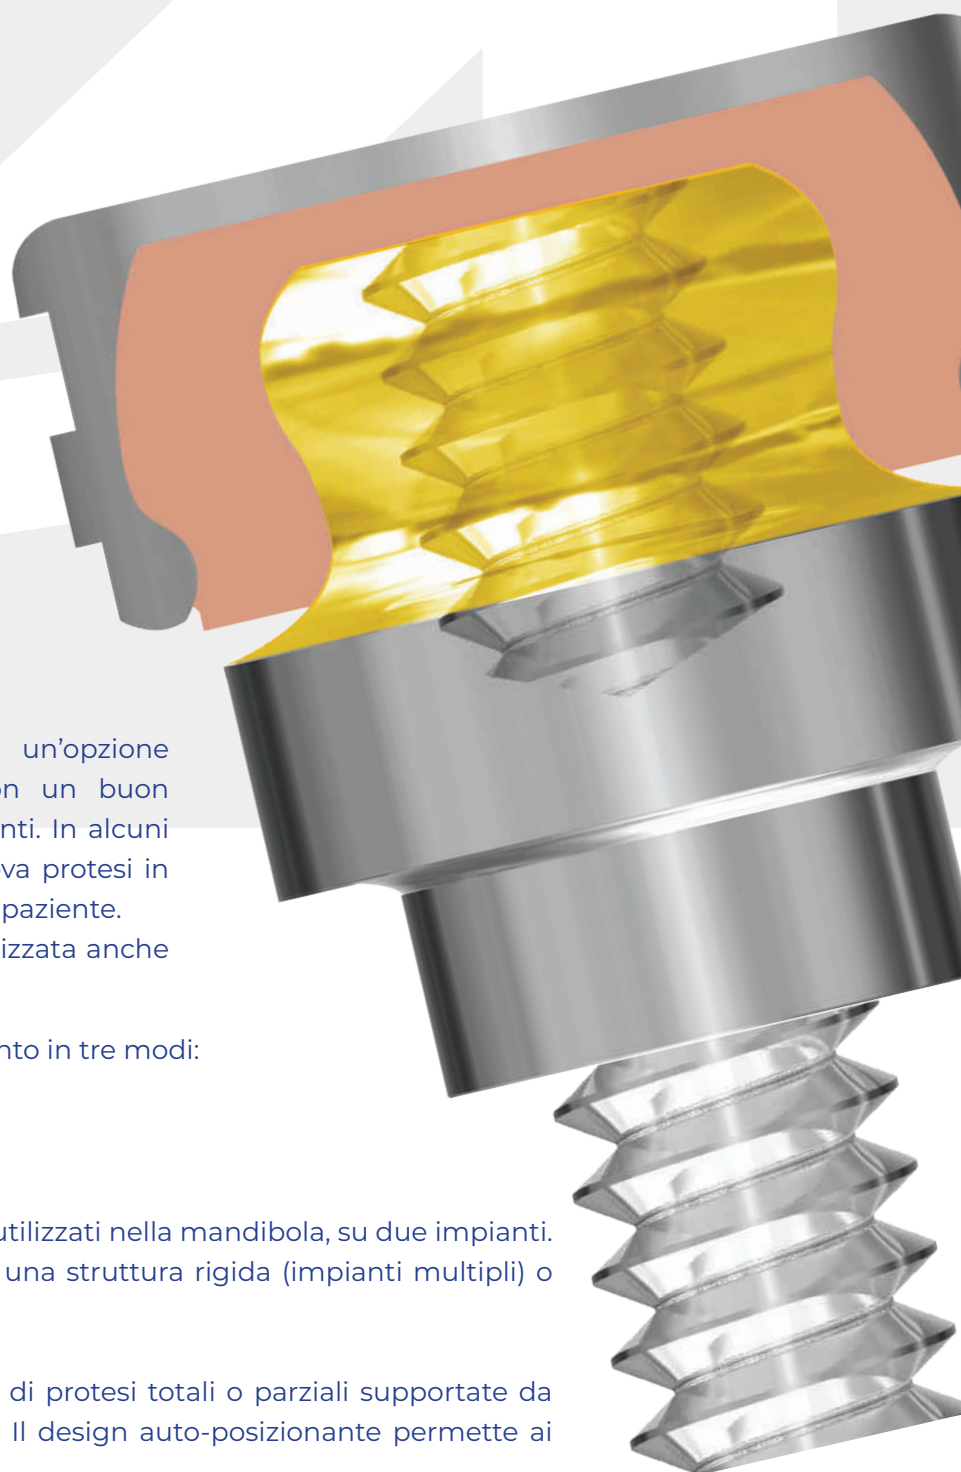

CONNEKTOR Vedi singole case implantari

KIT 1081 - SET LAVORAZIONE 0°- 10°

1 Cuffia Nera, 1 Spaziatori Bianchi, 1 Cuffia Trasparente, 1 Cuffia Rosa, 1 Cuffia Blue, 1 Contenitore in titanio.



KIT 1082 - SET LAVORAZIONE 10°- 20°

1 Cuffia Nera, 1 Spaziatori Bianchi, 1 Cuffia Verde, 1 Cuffia Rossa, 1 Cuffia Arancio, 1 Contenitore in titanio.



Connektor extended - Ref. 1083
(Cuffia Verde) RETENTION: 5LB
4 PACK



Connektor extended - Ref. 1084
(Cuffia Arancio) RETENTION: 2LB
4 PACK



Connektor extended - Ref. 1085
(Cuffia Rossa) RETENTION: 1LB
4 PACK



Connektor extended - Ref. 1086
(Cuffia Grigia) RETENTION: 0LB
4 PACK



Contenitore titanio - Ref. 1087
1 PACK



Analogo Connektor - Ref. 1088
1 PACK



Connektor - Ref. 1089
(Cuffia Trasparente) RETENTION: 5LB
4 PACK



Connektor - Ref. 1090
(Cuffia Rosa) RETENTION: 3LB
4 PACK



Connektor - Ref. 1091
(Cuffia Blue) RETENTION: 1.5LB
4 PACK



Connektor - Ref. 1092
(Cuffia Nera) CUFFIA LABORATORIO
4 PACK



Perno parallelismo - Ref. 1093
4 PACK



Transfer abutment - Ref. 1094
2 PACK



Guida misurazione angolare Connektor
Ref. ST1506
1 PACK



Puntale in acciaio avvitaemento Connektor
Ref. ST1003
1 PACK



STRUMENTO UNIVERSALE CONNEKTOR - Ref. ST1110



Puntale in acciaio inserimento - Ref. ST1109



Manico - Ref. ST1108



Driver Manuale - Ref. ST1111

RICAMBI OT CAP SYSTEM - Normo Ø 2,5 mm



Ref. 055SCN

• 4 SFERE NORMO CALCINABILI SINGOLE

Ref. 151BAN

• 2 BARRE CALCINABILI NORMO ANGOLARI

Ref. 150BPN

• 2 BARRE CALCINABILI NORMO DIRITTE



Ref. 192ACN

KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE OT CAP NORMO CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTA NERA DA LABORATORIO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (1 VERDE, 1 GIALLA, 1 ROSA, 1 BIANCA TRASPARENTE)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO



Ref. 048CAN

• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI NORMO ARGENTO
(ELASTICHE-GOMMOSE) - 350g



Ref. 048CON

• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI NORMO ORO
(LEGGERMENTE ELASTICHE) - 500g



Ref. 049PCN

• 6 CAPPETTE NORMO VERDI
(RITENZIONE MOLTO ELASTICA) - 350g



Ref. 060CRN AY

• 6 CAPPETTE NORMO GIALLE
(RITENZIONE EXTRA SOFT) - 500g



Ref. 040CRN SN

• 6 CAPPETTE NORMO ROSA
(RITENZIONE SOFT) - 900g



Ref. 040CRN

• 6 CAPPETTE NORMO BIANCHE TRASPARENTI
(RITENZIONE STANDARD) - 1300g



Ref. 040TCN

• 2 CAPPETTE TITAN CAP NORMO



Ref. 043CLN

• 6 CAPPETTE NORMO NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)



Ref. 042AMN

• 2 OT BOX MONO NORMO
(CONTENITORI CALCINABILI PER CAPPETTE)



Ref. 041CAN

• 2 CONTENITORI INOX NORMO



Ref. 041CTN

• 2 CONTENITORI IN TITANIO NORMO ANODIZZATI FUCSIA



Ref. 101PPN

• 2 POSIZIONATORI NORMO PLASTICA




Ref. 044PPN

• 2 PERNI ANALOGHI NORMO



Ref. 100SAN

• 10 SPAZIATORI IN ALLUMINIO PER BARRE OT CAP NORMO



Ref. 100AD

ANELLI DIREZIONALI PER SPHERO FLEX - BLOCK CONFEZIONE CONTENENTE

- 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONI DI 0° - 7° - 14°

RICAMBI OT CAP SYSTEM - per sfere sottodimensionate $\varnothing 2.25$



Ref. KITBN225

KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE OT CAP $\varnothing 2.25$

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTA NERA DA LABORATORIO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (1 VERDE ACQUA, 1 GIALLA, 1 ROSA, 1 ARANCIO)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO



Ref. 043CLN

- 6 CAPPETTE NORMO NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)



Ref. 049PCNDR8

- 6 CAPPETTE ARANCIO (RITENZIONE MOLTO ELASTICA)
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE $\varnothing 2,25$ mm) - 350g



Ref. 060CRNAYDR8

- 6 CAPPETTE NORMO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT)
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE $\varnothing 2,25$ mm) - 500g



Ref. 040CRNSNDR8

- 6 CAPPETTE NORMO ROSA (RITENZIONE SOFT)
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE $\varnothing 2,25$ mm) - 900g



Ref. 040CRNDR8

- 6 CAPPETTE NORMO VERDE ACQUA (RITENZIONE FORTE)
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE $\varnothing 2,25$ mm) - 1300g



Ref. 042AMN

- 2 OT BOX MONO NORMO
(CONTENITORI CALCINABILI PER CAPPETTE)



Ref. 041CAN

- 2 CONTENITORI INOX NORMO




Ref. 041CTN

- 2 CONTENITORI IN TITANIO NORMO ANODIZZATI FUCSIA



Ref. 101PPN

- 2 POSIZIONATORI NORMO PLASTICA



Ref. 100AD

ANELLI DIREZIONALI PER SPHERO FLEX - BLOCK

CONFEZIONE CONTENENTE

- 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONI DI 0° - 7° - 14°



Ref. 100PDR

- 10 DISCHETTI PROTETTIVI ROSA DIAMETRO INTERNO 2,9mm



Ref. 044PP22

- 2 PERNI ANALOGHI SFERA $\varnothing 2,2$ mm

STRUMENTI NORMO-MICRO



Ref. 485IC

- 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE OT EQUATOR - OT CAP NORMO/MICRO
(NEI BOX METALLICI E IN BOCCA AL PAZIENTE)



Ref. 74AC01

- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO NORMO/EQUATOR



Ref. 74AC02

- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO MICRO



Ref. 74AC03

- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO TECNO NORMO E MICRO
(SOLO PER OT CAP TECNO)



Ref. 491EC

- 1 ESTRATTORE DI CAPPETTE RITENTIVE MULTIUSO
(CON FORO PORTA STELO)



Ref. 008MDS

- 1 MISURATORE DI SFERE
(PER MISURARE LE SFERE DI DIAMETRO: 1,6-1,8-2,2-2,5mm)

NEW

SFERE SINGOLE FILETTATE

CON GUAINA DA INCOLLAGGIO NORMO - MICRO



Ref. 139KSFN

KIT SFERA FILETTATA NORMO + TiN da INCOLLARE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE in TITANIO
(ESAGONO 1.3mm FILETTO 1.6mm passo fine)
- 2 GUAINE FILETTATE DA INCOLLARE in TITANIO
- 2 SPAZIATORI PER GUAINA (sfera Normo) in ACCIAIO

Ref. 139KSFM

KIT SFERA FILETTATA MICRO + TiN da INCOLLARE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE in TITANIO
(ESAGONO 0.9mm FILETTO 1.6mm passo fine)
- 2 GUAINE FILETTATE DA INCOLLARE in TITANIO
- 2 SPAZIATORI PER GUAINA (sfera Micro) in ACCIAIO

RICAMBI



Ref. 239SFN

- 1 SFERA FILETTATA NORMO + TiN
ESAGONO 1.3mm FILETTO 1.6mm passo fine

Ref. 239SFM

- 1 SFERA FILETTATA MICRO + TiN
ESAGONO 0.9mm FILETTO 1.6mm passo fine

Ref. 239GSF

- 1 GUAINA FILETTATA DA INCOLLARE
per Normo e Micro - 1.6mm passo fine

Ref. 239SSN

- 1 SPAZIATORE PER GUAINA con SFERA NORMO

Ref. 239SSM

- 1 SPAZIATORE PER GUAINA con SFERA MICRO

Ref. 039SFN2

- 1 SFERA SINGOLA FILETTATA NORMO + TiN
ESAGONO 1.3mm FILETTO 2.0mm

Ref. 039SFM2

- 1 SFERA SINGOLA FILETTATA MICRO + TiN
ESAGONO 0.9mm FILETTO 2.0mm

Ref. 760CBR

- 1 CHIAVE A BRUGOLA (per sfere singole filettate normo)
ESAGONO 1.3mm

Ref. 772CSF

- 1 CHIAVE A BRUGOLA (per sfere singole filettate micro)
ESAGONO 0.9mm

OT CAP TRANSFER DA IMPRONTA



Ref. 044CAIN

- 2 TRANSFER OT EQUATOR - OT CAP NORMO Ø 2,5mm
da impronta a strappo con cappetta intercambiabile

Ref. 044CAI22

- 2 TRANSFER PER SFERE Ø 2,2mm
da impronta a strappo con cappetta intercambiabile

Ref. 044CAIM

- 2 TRANSFER OT CAP MICRO Ø 1,8mm
da impronta a strappo con cappetta intercambiabile



Ref. OC

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 SIRINGA BICOMPONENTE 5ml
- 10 PUNTALI AUTOMISCELANTI

OT EQUATOR



CALCINABILE



Ref. 092ECQ

KIT OT EQUATOR CALCINABILE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 MASCHI "semi sfere" CALCINABILI
- 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(2 ROSA SOFT, 2 BIANCHE TRASPARENTI STANDARD)

IMPIANTI



Ref. 130

KIT OT EQUATOR PER IMPIANTI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE INOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)



Ref. 131

KIT OT EQUATOR PER IMPIANTI CON SMART BOX

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE "AUTOPARALLELIZZANTE" SMART BOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO ROSA
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)



Ref. 030

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN

BARRE



Ref. 160EQB

KIT OT EQUATOR FILETTATO CON GUAINA DI INCOLLAGGIO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 EQUATOR FILETTATO per guaina in titanio (FILETTO 1.6 mm)
- 2 GUAINA FILETTATE (FILETTO 1.6 mm)
- 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
- 2 SPAZIATORI IN ACCIAIO (per guaina filettata)
- 8 CAPPETTE RITENTIVE
(2 GIALLA EXTRA-SOFT, 2 ROSA SOFT, 2 BIANCHE TRASPARENTI STANDARD, 2 NERE DA LABORATORIO)

ELASTIC SEEGER UNIONE A BARRA PASSIVA FRA IMPIANTI



Ref. 158ESA

KIT ELASTIC SEEGER

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CILINDRO CALCINABILE CONTENITORE PER SEEGER
- 1 ANELLO SEEGER AUTOESTRAENTE OT EQUATOR
- 1 VITE IN TITANIO PER ANELLO SEEGER AUTOESTRAENTE

KIT CAPPETTE



Ref. 192ECE

KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTA NERA da laboratorio
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO

KIT SMART BOX CONTENITORE AUTOPARALLELIZZANTE PER OT EQUATOR



Ref. 335SBC

KIT SMART BOX

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE SMART BOX CON CAPPETTA NERA DI POSIZIONAMENTO
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO ROSA
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

RICAMBI



Ref. 151SS

• 2 MASCHI "OT EQUATOR" CALCINABILI



Ref. 140CEV

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - VIOLA (FORTE 2700g)



Ref. 140CET

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - BIANCA TRASPARENTE (STANDARD 1800g)



Ref. 140CER

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - ROSA (SOFT 1200g)



Ref. 140CEG

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - GIALLA (EXTRA-SOFT 600g)



Ref. 140CEN

• 4 CAPPETTE NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)



Ref. 140CEDR8

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - VERDE ACQUA DIAMETRO INTERNO RIDOTTO 2,2mm (FORTE 1300g)



Ref. 140CEADR8

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - ARANCIO DIAMETRO INTERNO RIDOTTO 2,2mm (MOLTO ELASTICA 350g)



Ref. 141CAE

• 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE



Ref. 141CTE

• 2 CONTENITORI IN TITANIO DI CAPPETTE ANODIZZATI FUCSIA



Ref. 330SBE

• 1 CONTENITORE IN TITANIO SMART BOX (CON CAPPETTA DI POSIZIONAMENTO)



Ref. 335CSB

• 4 CAPPETTE SMART BOX NERE (DI POSIZIONAMENTO)



Ref. 039SFE2

• 1 EQUATOR FILETTATO 2mm (FILETTO STANDARD)



Ref. 339SFE

• 1 EQUATOR FILETTATO 1.6mm (PER GUAINA IN TITANIO)



Ref. 239GSF

• 1 GUAINA IN TITANIO FILETTATA (FILETTO 1.6mm)



Ref. 339SSE

• 1 SPAZIATORE PER GUAINA OT EQUATOR



Ref. 159VEA

• 1 OT EQUATOR SEEGER
(PER ANELLO AUTOESTRAENTE IN PEEK O ANELLO DI GUARIGIONE IN TITANIO)



Ref. 158VAE

• 1 VITE IN TITANIO PER SEEGER AUTOESTRAENTE



Ref. 158SAE

• 1 ANELLO SEEGER AUTOESTRAENTE OT EQUATOR IN PEEK



Ref. 158CCE

• 1 CILINDRO CALCINABILE h 2,5mm (PER ANELLO SEEGER)



Ref. 158CCAE

• 1 CILINDRO CALCINABILE ALTO h 3,5mm (PER ANELLO SEEGER)



MONCONI PER PROTESI FISSA



Ref. MTSEG

Ø 3,5 mm

Ref. MT40SEG

Ø 4,0 mm

Ref. MT50SEG

Ø 5,0 mm

MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE DA INCOLLAGGIO h9,5mm
- 1 VITE IN TITANIO h2mm
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO



Ref. MMSEG

Ø 3,5 mm

Ref. MM40SEG

Ø 4,0 mm

MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE MINI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE MINI DA INCOLLAGGIO h5,7mm
- 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE MINI
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO



Ref. MTSFEG

Ø 3,5 mm

Ref. MTEG15SF

Ø 4,0 mm

MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE INCLINATO 15°

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE INCLINATO DI 15° DA INCOLLAGGIO
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO
- 1 VITE IN TITANIO SFERICA PER MONCONE INCLINATO



Ref. CMEG40C

Ø 4,0 mm

MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE CON FORO
- 1 VITE IN TITANIO h2mm
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO



Ref. MCEG15SF

Ø 4,0 mm

MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE SENZA FORO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE (DISPONIBILE SOLO CON Ø 4,0mm)
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO



Ref. CMTFP

h 1,8 mm

Ref. CMTB30FP

h 3,0 mm

MONCONE IN TITANIO CON FORI PASSANTI PER PROVVISORIO RESINA-FILO-ARMATA

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE IN TITANIO CON FORI PASSANTI h3,0mm (DISPONIBILE SOLO CON Ø 3,5mm)
- 1 VITE h2mm
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO



Ref. MT40GL

Ø 4,0 mm

MONCONE IN TITANIO NORMO PER SALDATURA ENDORALE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE IN TITANIO NORMO PER SALDATURA ENDORALE h9,5mm Ø 4,0 mm
- 1 VITE h2mm
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO

ACCESSORI



Ref. 144TTE

- 1 TRANSFER OT EQUATOR IN TITANIO + VITE IN TITANIO



Ref. 144MTE

- 2 TRANSFER OT EQUATOR
PER PORTAIMPRONTA INDIVIDUALE



Ref. 044CAIN

- 2 TRANSFER OT EQUATOR - OT CAP NORMO
DA IMPRONTA A STRAPPO CON CAPPETTA INTERCAMBIABILE



Ref. 144AE

- 2 ANALOGHI DA LABORATORIO



Ref. 144AVC4

- 1 ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE IN TITANIO PER CAD/CAM Ø4mm

Ref. 144AVC5

- 1 ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE IN TITANIO PER CAD/CAM Ø5mm

TRANSFER DA IMPRONTA



Ref. 144TLE

- 1 TRANSFER LUNGO OT EQUATOR IN TITANIO + VITE IN TITANIO h11,5mm



Ref. 144TTE

- 1 TRANSFER OT EQUATOR IN TITANIO + VITE IN TITANIO h6mm



Ref. 144MTE

- 2 TRANSFER OT EQUATOR *PER PORTAIMPRONTA INDIVIDUALE*



Ref. TPM2

- 2 MINI TRANSFER OT EQUATOR h3,7mm

OT EQUATOR SCAN ABUTMENT



Ref. 145SAE

- 1 OT EQUATOR SCAN ABUTMENT + VITE

TAPPI DI GUARIGIONE



Ref. 159VAG

VITE E ANELLO DI GUARIGIONE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 VITE IN TITANIO AUTOESTRAENTE
- 1 ANELLO DI GUARIGIONE IN TITANIO



Ref. 159EAG

OT EQUATOR SEEGER E ANELLO DI GUARIGIONE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 OT EQUATOR SEEGER IN TITANIO + TIN AUTOESTRAENTE
- 1 ANELLO DI GUARIGIONE IN TITANIO



Ref. 159VEA

- 1 OT EQUATOR SEEGER
(*per anello autoestraente in peek o anello di guarigione in titanio*)

ANALOGHI DA LABORATORIO



Ref. 144AE

- 2 ANALOGHI DA LABORATORIO ø 4mm

Ref. AI502

- 2 ANALOGHI DA LABORATORIO ø 5mm



Ref. 144AVC4

- 1 ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE PER CAD/CAM ø 4mm

Ref. 144AVC5

- 1 ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE PER CAD/CAM ø 5mm

KIT CALBRATORI PER TAGLIO MONCONI EXTRAGRADE



Ref. CGDA

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CALBRATORE PER TAGLIO MONCONE EXTRAGRADE h 6,8mm
- 1 CALBRATORE PER TAGLIO MONCONE EXTRAGRADE h 4,8mm
- 1 CALBRATORE PER TAGLIO MONCONE INCLINATO h 5,0mm
- 1 VITE DI SERRAGGIO PER CALBRATORE

VITI



Ref. 147VME

- 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE
(*per cacciavite foro inclinato*)



Ref. 146VMI

- 1 VITE IN TITANIO SFERICA PER MONCONE INCLINATO
(*per cacciavite foro inclinato*)



Ref. 148VCM

- 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE MINI
(*per cacciavite foro inclinato*)

Ref. VC

- 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE h2mm

Ref. VM

- 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE h6mm

Ref. VXL

- 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE h11,5mm



STRUMENTI

	Ref. 774CHE	• 1 CHIAVE QUADRATA + HOLDER per avvitare Ot Equator (QUADRATO 1.25mm) (UTILIZZABILE CON CRICCHETTO DINAMOMETRICO)
	Ref. 775CLE* (*versione lunga)	
	Ref. 760CSC	• 1 CACCIAVITE/STELO PER FORO INCLINATO PER MANIPOLO DINAMOMETRICO (QUADRATO 1,25mm) E PER ADATTATORE CRICCHETTO DINAMOMETRICO
	Ref. 760CS* (*versione lunga)	
	Ref. 760ACC	• 1 ADATTATORE PER CACCIAVITE/STELO PER FORO INCLINATO (UTILIZZABILE CON CRICCHETTO DINAMOMETRICO)
	Ref. 774HC	• 1 HOLDER INTERCAMBIABILE
	Ref. 760CE	• 1 CACCIAVITE/STELO OT EQUATOR PER MANIPOLO DINAMOMETRICO E PER ADATTATORE CRICCHETTO DINAMOMETRICO PREDISPOSTO PER HOLDER (QUADRATO 1,25MM)
	Ref. 760CRD-US	
	Ref. 124ICP	• 1 MANICO UNIVERSALE
	Ref. CGD48	• 1 CALIBRATORE PER TAGLIO MONCONE EXTRAGRADE h4,8mm
	Ref. CGD68	• 1 CALIBRATORE PER TAGLIO MONCONE EXTRAGRADE h6,8mm
	Ref. CGA5	• 1 CALIBRATORE PER TAGLIO MONCONE INCLINATO h5,0mm
	Ref. VCG	• 1 VITE DI SERRAGGIO PER CALIBRATORE

T-BAR ACCIAIO MEDICALE

  	Ref. G80A	• 4 GIUNTI IN ACCIAIO MEDICALE
	Ref. T20A	• 4 CILINDRI IN ACCIAIO MEDICALE
	Ref. T20Ai	• 4 CILINDRI RITENTIVI IN ACCIAIO MEDICALE

T-BAR TITANIO

  	Ref. G80T	• 4 GIUNTI IN TITANIO
	Ref. T20T	• 4 CILINDRI IN TITANIO
	Ref. T20Ti	• 4 CILINDRI RITENTIVI IN TITANIO

T-BAR STRUMENTI

	Ref. T-APLUS	• 2 ADATTATORI T-BAR
---	---------------------	----------------------

COMPONENTI IN CONFEZIONE SINGOLA

	Ref. RMTSFEG	• 1 MONCONE EXTRAGRADE INCLINATO 15° Ø 3,5mm
	Ref. RMTEG15SF	• 1 MONCONE EXTRAGRADE INCLINATO 15° Ø 4,0mm
	Ref. RMTSEG	• 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE Ø 3,5mm
	Ref. RMT40SEG	• 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE Ø 4,0mm
	Ref. RMT50SEG	• 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE Ø 5,0mm
	Ref. RMMSEG	• 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE MINI Ø 3,5mm
	Ref. RMM40SEG	• 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE MINI Ø 4,0mm
	Ref. GCMR	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE INCLINATO Ø 3,5mm
	Ref. GCMR4	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE INCLINATO Ø 4,0mm
	Ref. GC	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE IN TITANIO Ø 3,5mm
	Ref. GC4	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE IN TITANIO Ø 4mm
	Ref. GC5	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE IN TITANIO Ø 5mm
	Ref. GMM	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE IN TITANIO MINI Ø 3,5mm
	Ref. GMM4	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE IN TITANIO MINI Ø 4mm
	Ref. MTFP	• 1 MONCONE IN TITANIO CON FORI PASSANTI PER PROVVISORIO RESINA-FILO-ARMATA h1,8mm (DISPONIBILE SOLO CON Ø 3,5mm)
	Ref. MTB30FP	• 1 MONCONE IN TITANIO CON FORI PASSANTI PER PROVVISORIO RESINA-FILO-ARMATA h3mm (DISPONIBILE SOLO CON Ø 3,5mm)
	Ref. HR800	• 1 FILO RICURVO IN TITANIO SPECIALE SENZA MEMORIA ELASTICA Ø 1,0mm
	Ref. MEG40C	• 1 MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE Ø 4,0mm
	Ref. RMCEG15SF	• 1 MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE SENZA FORO (DISPONIBILE SOLO CON Ø 4,0mm)
	Ref. SM6	• 6 SEEGER BIANCHI CON MANICO (TENUTA STANDARD)
	Ref. SRM6	• 6 SEEGER ROSA CON MANICO (TENUTA SOFT)
	Ref. 022RGO	• 3 CONNETTORI CALCINABILI
	Ref. FSS	• 1 FRESA PER LA PULIZIA DELLE SEDI DEI SEEGER

MISURATORE DI BORDO GENGIVALE



Ref. 008MBG

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MISURATORE B.G. A CORSOIO
- 1 MISURATORE B.G. AD ASTA FISSA
- 1 DISPENSER DI ANELLINI IN SILICONE
- 20 ANELLINI IN SILICONE



KIT OT BAR MULTIUSE REF. 0210BM



- 2 BARRE CALGINABILI
- 4 CLIP DI POSIZIONE A
- 4 CLIP DI POSIZIONE B
- 4 BOX CALGINABILI
- 4 CLIP RITENTIVE ROSA
- 4 CLIP RITENTIVE GIALLO
- 2 CONNETTORI



Ref. 0220BB
4 OT Bar Multituse calcinabile



Ref. 025CPB
4 BOX calcinabili OT Bar Multituse



Ref. 023CPA
4 OT Bar Multituse clip di posizione A



Ref. 024CPB
6 OT Bar Multituse clip di posizione B



Ref. 022RGO
2 Raccordi gengivali



Ref. 027CRG
Clip ritentiva gialla tenuta "medium"



Ref. 026CRR
Clip ritentiva rosa tenuta "soft"



Ref. 027CRS
Clip ritentiva rossa tenuta "extra soft"



Ref. 472ICV
Inseritore/Estrattore per clip




Ref. 0280CP
Parallelometro per OT Bar Multituse



Ref. 155CC
Connettore

SPECIFICHE PRODOTTO

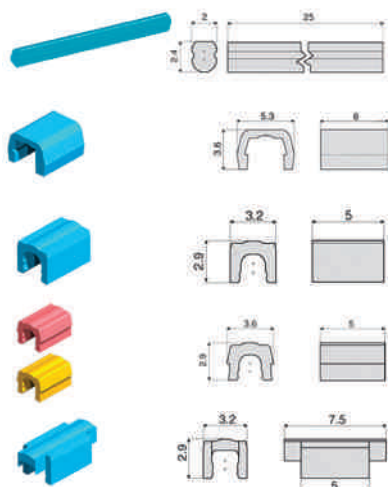


La OT BAR è una barra a due lati, un lato piatto e un lato rotondo che può essere utilizzata ogni volta secondo le esigenze. Se occorre resilienza si monta la barra con la parte piana girata verso l'alto, se si costruisce una protesi a funzione rigida sarà il lato rotondo rivolto verso l'alto. Quando la barra viene montata in un solo tratto lineare per esempio nel caso classico fra due canini in zona incisiva, si può utilizzare indifferentemente uno dei due lati. Nel caso del lato rotondo avremo un movimento altalenante con cedimento solo nella zona edentula distale. Nell'altra versione avremo una resilienza anche in zona incisiva e il cedimento anche in zona distale. Altra opportunità è la struttura fusa di rinforzo alla protesi mobile in resina che verrà modellata direttamente sul modello MASTER senza duplicare il modello in rivestimento. La nicchia di questa fusione che trattiene la CLIP ritentiva è calcolata con una tolleranza all'imbocco che permette una duratura funzionalità alla CLIP ritentiva.

LABORATORIO



La barra in versione "RIGIDA" è particolarmente indicata per i collegamenti fra due pilastri dove si richiede un movimento basculante anteroposteriore e nei casi con più pilastri dove la base protesica di una progettazione rigida appoggia su gengiva "ATROFICA".



Applicare la barra nel verso A con l'apposita chiave e completare la modellatura con cera o resina.



Barra fusa e finita, attenzione a non consumare nella lucidatura l'area ritentiva della barra.



Eliminare i sottosquadri con cera ed inserire il posizionatore A in sito.



Per isolare, adattare del nastro in teflon sui posizionatori A e sulla barra fusa, poi inserire i box contenitori calcinabili.



Unire i box calcinabili con resina autopolimerizzante. Il nastro in teflon impedisce le infiltrazioni della resina.



Completare la modellatura anche con cera, per le estensioni usare i connettori calcinabili, applicare i perni di colata e fondere.




Fusione finita, inserzione delle clip ritentive a scatto nella fusione.




Protesi finita con rinforzo fuso incorporato, con clip ritentive inserite.

PRECİ-HORİX®

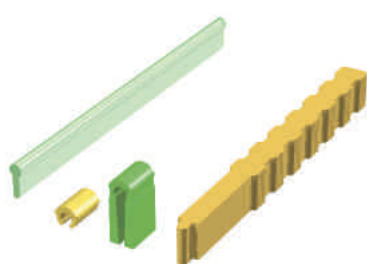


CK1701 SET PRECİ-HORİX STANDARD

2 barre in plastica
6 cavalieri gialli
6 cavalieri per lavorazione
1 accessorio per l'inserzione

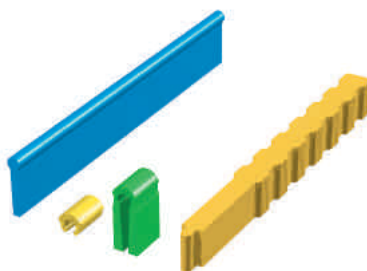

CK1731 SET PRECİ-HORİX PLASTICWAX

2 barre in Plasticwax
6 cavalieri gialli
6 cavalieri per lavorazione
1 accessorio per l'inserzione

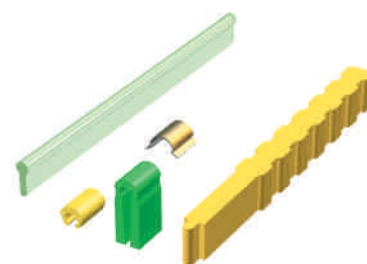

CK1741 SET PRECİ-HORİX COMBI

1 barra in plastica
2 cavalieri gialli
2 cavalieri per lavorazione
2 alloggiamenti in acciaio inossidabile
1 accessorio per l'inserzione



PARTI SINGOLE E ACCESSORI



ALLOGGIAMENTO PRECI-HORİX

Alloggiamento in acciaio inossidabile ultrasottile con uno strato colore giallo oro di nitrato di titanio per un assetto preciso dei cavalieri nella protesi. L'alloggiamento viene fissato nella resina (con il cavaliere per la lavorazione).

Non saldare! Contiene Ni.

Lunghezza: 5 mm - Larghezza: 5 mm - Spessore: 0,2 mm

CK1706 6 pezzi



PREFORMATO PRECI-HORİX

Barra preformata in plastica calcinabile che può essere ridotta in caso di occlusione bassa facilitando così l'applicazione. Usare solamente leghe dure.

Unicamente per l'uso in laboratorio.

Altezza barra: 4 mm - Lunghezza: 50 mm - $\varnothing$ 1,8 mm

CK1704 6 pezzi



CAVALIERE PRECI-HORİX

Polipropilene

Altezza: 2,87 mm - Lunghezza: 5 mm - $\varnothing$ 3,3 mm

Disponibile con tre valori di ritenzione:

Ritenzione normale:

CK 1802 GIALLO 6 pezzi



Ritenzione inferiore:

CK 1805 BIANCO 6 pezzi



Ritenzione maggiore:

CK 1806 ROSSO 6 pezzi

Confezione combinata:

CK 1807 2 giallo + 2 rosso + 2 blu



PREFORMATO PRECI-HORİX PLASTICWAX

Barra preformata in PLASTICWAX che può essere ridotta in caso di occlusione bassa facilitando così l'applicazione. Ideale per la lavorazione con rivestimenti rapidi.

Usare solamente leghe dure.

Unicamente per l'uso in laboratorio.

Altezza barra: 8,25 mm (riducibile fino a 3 mm)

Lunghezza: 50 mm - $\varnothing$ 1,8 mm

CK1734 4 pezzi



ANALOGO DEL PREFORMATO PRECI-HORİX

Analogo del preformato in plastica per il modello da lavoro, da usare in caso di riparazioni e ribasatura o per ricostruire una protesi nuova.

Unicamente per l'uso in laboratorio.

Altezza: 8,25 mm - Lunghezza: 50 mm - $\varnothing$ 1,8 mm

CK1707 2 pezzi



CAVALIERE PER LAVORAZIONE PRECI-HORİX

Adattare il cavaliere per la lavorazione in plastica alla barra prima della polimerizzazione.

Unicamente per l'uso in laboratorio.

Lunghezza: 5 mm

(riducibile a seconda dell'altezza della barra)

CK 1703 6 PEZZI

CX 1703B 50 pezzi



ACCESSORIO PER L'INSERZIONE PRECI-HORİX

Accessorio per l'inserzione dei 3 tipi di cavalieri

CK1705 2 pezzi



MANDRINO PARALLELOMETRO PRECI-HORİX

Mandrino per posizionare in parallelo i preformati.

Ideale per parallelizzare più sezioni della barra.

Unicamente per l'uso in laboratorio.

CK1708 1 pezzo

PRECİ-BAR

BARRE MINI

Altezza: 2,3 mm - Larghezza: 1,6 mm



BARRA MINI OVALE DINAMICA IN PLASTICA
CK1012/B 4 x 50 mm

CAVALIERI MINI

Altezza: 2,8 mm - Larghezza: 4 mm



CAVALIERE MINI ORAX®
con ritenzione
CK1102/H/MR/OR 50 mm
senza ritenzione
CK1102/H/ZR/OR 50 mm



CAVALIERE MINI IN PALLAX®
con ritenzione
CK1102/H/MR/PA 50 mm



CAVALIERE MINI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
CK1102/H/MR/IN 50 mm

BARRE STANDARD


Altezza: 3 mm - Larghezza: 2,2 mm



BARRA STANDARD OVALE DINAMICA IN ORAX®
CK1101/B/OR 50 mm



BARRA STANDARD OVALE DINAMICA IN PLASTICA
Per l'uso in laboratorio
CK1013/B 4 x 50 mm



BARRA STANDARD FORMA U RIGIDA IN PLASTICA
Per l'uso in laboratorio
CK1011/B 4 x 50 mm

CAVALIERI STANDARD

Altezza: 3,5 mm - Larghezza: 5 mm



CAVALIERE STANDARD IN ORAX®
con ritenzione
CK 1100/H/MR/OR 50 mm
senza ritenzione
CK 1100/H/ZR/OR 50 mm



CAVALIERE STANDARD IN PALLAX®
con ritenzione
CK 1100/H/MR/PA 50 mm
senza ritenzione
CK 1100/H/ZR/PA 50 mm



CAVALIERE STANDARD IN ACCIAIO INOSSIDABILE
CK 1100/H/MR/IN 50 mm



MANDRINI PER PARALLELOMETRO
Unicamente per l'uso in laboratorio
CK1000 P BARRE STANDARD
CK1102 P BARRE MINI

LEGHE*

ORAX

Colore: Giallo - Au 70 - Pt 5 - Ag 12 - Cu 13
Tempera: 60 min. a 400 °C
Intervallo di fusione: 910-955 °C

PALLAX

Colore: Bianco - Au 2 - Ag 37 - Pt 9,5 - Pd 37 - Cu 14,5
Tempera: 60 min. a 450 °C
Intervallo di fusione : 1055-1130 °C

ACCIAIO INOSSIDABILE

Colore: Bianco - Fe 73 - Cr 18 - Ni 8 - Mo, Cu, C, Mn e Si 1
Non riscaldare! Contiene Ni.

PRECIPROFILE

Profilati di titanio da saldare con il laser, idoneo per impianti ponti.
Da usare con il saldame CEKA SOL T1 CS31.
Veloce, versatile e economico. Titanio puro grado 2.

Altezza: 2,9 mm - Larghezza: 2 mm - Lunghezza: 50 mm - Durezza Vickers: 210 ± 20

PROFILATO DI TITANIO DRITTO PER LA SALDATURA LASER

CK-IMP-015 1 pezzo
CK-IMP-025 25 pezzi

PROFILATO DI TITANIO CURVO PER LA SALDATURA LASER

CK-IMP-016 1 pezzo
CK-IMP-026 25 pezzi

Raggio di curva: 20 mm - A trattamento termico



PLASTIC-WAX



CERA ARRICCHITA CON RESINA. (45GR)

Ideale per la modellazione e la tecnica di fresaggio.
Unicamente per l'uso in laboratorio.

CK-IMP-045 Scatola 45 g



PROFILATI DI 8°

(altezza: 4,5 mm - lunghezza: 60 mm - larghezza sopra: 1,9 mm / sotto: 2,8 mm)

CK-IMP-014 Profilati 8° 4 pezzi



TABELLA DELLE LEGHE E DEI MATERIALI

PALLAX

Da saldare con leghe preziose e non preziose

Bianco - Au 2 - Ag 37 - Pt 9,5 - Pd 37 - Cu 12,5 - Co 2 Intervallo di fusione 1055-1130 °C

IRAX

Unicamente per sovrapposizione con leghe preziose

Bianco - Au 60 - Pt 24 - Pd 15 - Ir 1 Intervallo di fusione: 1400-1460 °C

NOPRAX

Unicamente per sovrapposizione con leghe non preziose

Bianco - Ni 72 - Cr 17 - Fe 10 - Mn 1 - Contiene Ni. Intervallo di fusione: 1355-1450 °C

ORAX

Da saldare con leghe preziose e non preziose

Giallo - Au 67 - Pt 8,6 - Ag 13,2 - Cu 11 - Zn 0,2 Intervallo di fusione: 910-995 °C

Temperatura: 60 min. a 400 °C

PLATIRAX

Per sovrapposizione con qualsiasi lega

Bianco - Pt 85 - Ir 15

Intervallo di fusione: 1790-1820 °C

TITANAX

Unicamente per l'incollaggio e da inglobare nella resina

Bianco - Ti 90 - Al 6 - V 4 - Non riscaldare!

ACCIAIO INOSSIDABILE

Unicamente per l'incollaggio e da inglobare nella resina

Bianco - Fe 66 - Cr 17 - Ni 11 - Mo 2 - altri 4 - Non riscaldare! Contiene Ni.

POLIPROPILENE

1802, 1805, 1806

POLIACETALE

1231, 1232, 1233, 1311, 1312, 1313, 1361, 1362, 1363, 1822

ELASTOMERO TERMOPLASTICO

1201 B

► SOLUZIONI PER SALDATURA

ANTEEA® è in grado di offrire soluzioni per saldatura a 360° tra cui barre in Titanio Gr.4, mediante le quali è possibile realizzare una struttura stabile, dal fit passivo, per ricostruzioni immediate sia provvisorie che durature.

Sono idonee sia per i carico immediato sia per quello differito.

È una soluzione rapida ed economica che consente di fornire ricostruzioni di arcate parziali o complete nello stesso giorno dell'intervento chirurgico.



BARRA IN TITANIO Ø1.2mm ST1157

Ti4 - Titanio Gr. 4

Barra in titanio Gr. 4, L. 150 mm, Ø 1.2 mm

Confezione da 5 pezzi



BARRA IN TITANIO Ø1.5mm ST1158

Ti4 - Titanio Gr. 4

Barra in titanio Gr. 4, L. 150 mm, Ø 1.5 mm

Confezione da 5 pezzi



BARRA IN TITANIO Ø2.0mm ST1159

Ti4 - Titanio Gr. 4

Barra in titanio Gr. 4, L. 150 mm, Ø 2.0 mm

Confezione da 5 pezzi

STRUMENTARIO PROTESICO



CACCIAVITI MANUALI
CACCIAVITE PER CONTRANGOLO - ATTACCO MANIPOLO
CHIAVE PER DINAMOMETRICA
ADATTATORE PER CHIAVE PER DINAMOMETRICA
IMPUGNATURA MANUALE
SCHEMI DI SERRAGGIO

KIT V1 MEDIUM



DESCRIZIONE

		29 mm MEDIA
ESAGONALE 0.9 mm	●	ST1041
ESAGONALE 1.0 mm	●	ST1042
ESAGONALE 1.2 mm	●	ST1043
ESAGONALE 1.27 mm	●	ST1044
ESAGONALE 1.3 mm	●	ST1045
ESAGONALE 1.8 mm	●	ST1046
ATTACCO QUADRATO 1.3 mm	■	ST1047
A TAGLIO 2.0 mm	—	ST1048
UNIGRIP 5.5 mm	★	ST1049
TORX 6.0 mm	★	ST1050



IMPUGNATURA STUDIO ST1005

***N.B.** Le punte Long e Short del kit V3 sono optional e acquistabili singolarmente.

KIT V2 MEDIUM LONG



DESCRIZIONE

		29 mm MEDIA	36 mm LUNGA
ESAGONALE 0.9 mm	●	ST1041	ST1051
ESAGONALE 1.0 mm	●	ST1042	ST1052
ESAGONALE 1.2 mm	●	ST1043	ST1053
ESAGONALE 1.27 mm	●	ST1044	ST1054
ESAGONALE 1.3 mm	●	ST1045	ST1055
ESAGONALE 1.8 mm	●	ST1046	ST1056
ATTACCO QUADRATO 1.3 mm	■	ST1047	ST1057
A TAGLIO 2.0 mm	—	ST1048	ST1058
UNIGRIP 5.5 mm	★	ST1049	ST1059
TORX 6.0 mm	★	ST1050	ST1060



IMPUGNATURA STUDIO ST1005

***N.B.** Le punte Long del kit V2 sono optional e acquistabili singolarmente.

KIT V3 COMPLETE



DESCRIZIONE

		21 mm CORTA	29 mm MEDIA	36 mm LUNGA
ESAGONALE 0.9 mm	●	ST1031	ST1041	ST1051
ESAGONALE 1.0 mm	●	ST1032	ST1042	ST1052
ESAGONALE 1.2 mm	●	ST1033	ST1043	ST1053
ESAGONALE 1.27 mm	●	ST1034	ST1044	ST1054
ESAGONALE 1.3 mm	●	ST1035	ST1045	ST1055
ESAGONALE 1.8 mm	●	ST1036	ST1046	ST1056
ATTACCO QUADRATO 1.3 mm	■	ST1037	ST1047	ST1057
A TAGLIO 2.0 mm	—	ST1038	ST1048	ST1058
UNIGRIP 5.5 mm	★	ST1039	ST1049	ST1059
TORX 6.0 mm	★	ST1040	ST1050	ST1060



IMPUGNATURA STUDIO ST1005

Vassoio inferiore



CACCIAVITI MANUALI STUDIO

DESCRIZIONE		CORTA	MEDIA	LUNGA	COMPATIBILITÀ
ESAGONALE 0.9 mm		STI424	STI435	STI446	BREDENT® (Viti laterali)
ESAGONALE 1.0 mm		STI425	STI436	STI447	ANKYLOS®
ESAGONALE 1.2 mm		STI426	STI437	STI448	3I ES. ESTERNO® - 3I CERTAIN® - CHAORUM® - DIOIMPLANT® FRIALIT® (XIVE®) - NEOBHIOTECH® - OSSTEM®
ESAGONALE 1.27 mm		STI014	STI024	STI449	ANTONGYR® - ASTRA® - BTK® - BIOGENESIS® - BIOHORIZON® ALPHABIO® - CAMLOG® - DENTIUM® - DENTIS® - DIOIMPLANT® GEASS® - WINSIX® - INTRALOCK® - ISOMED® - LEADER® - MEGAGEN® MIS® - PRODENT® - TEKKA® - SWEDEN® MARTINA® - ZIMMER®
ESAGONALE 1.3 mm		STI427	STI438	STI450	ASTRA® - RHEIN83®
ESAGONALE 1.6 mm		STI428	STI439	STI451	INTRALOCK® (FLAT ABUTMENT)
ESAGONALE 1.67 mm		STI429	STI440	STI452	MATRIX®
ESAGONALE 1.8 mm		STI430	STI441	STI453	ANKYOS® - BALANCE BASE®
QUADRATO 1.3 mm		STI431	STI442	STI454	3I® - LIFE CORE®
QUADRILOBO		STI432	STI443	STI455	THOMMEN®
A TAGLIO 2.0 mm		STI018	STI028	STI456	UNIVERSALE
UNIGRIP 5.5 mm		STI019	STI029	STI457	NOBEL® - ACTIVE® NOBEL® - BRANEMARK® NOBEL® - REPLACE® NEOSS®
TORX 6.0 mm		STI020	STI030	STI 458	STRAUMANN® - BONE LEVEL® STRAUMANN® - TISSUE LEVEL® STRAUMANN® - BLX® - BLT® BREDENT®
D.I.S. e (Esagono)		STI433	STI444	STI459	ALL INCLINATED SCREWS BY ANTEEA®
D.I.S. t (Torx)		STI434	STI445	STI460	DINAMIC ABUTMENT®



LUNGO




MEDIO




CORTO

CACCIAVITI ATTACCO MANIPOLO


DESCRIZIONE		CORTA	MEDIA	LUNGA	COMPATIBILITÀ
ESAGONALE 0.9 mm		ST1031	ST1041	ST1051	BREDENT® (Viti laterali)
ESAGONALE 1.0 mm		ST1032	ST1042	ST1052	ANKYLOS®
ESAGONALE 1.2 mm		ST1033	ST1043	ST1053	3I ES. ESTERNO® - 3I CERTAIN® - FRIALIT® (XIVE®) - OSSTEM NEOBHIOTECH - DIOIMPLANT - CHAORUM
ESAGONALE 1.27 mm		ST1034	ST1044	ST1054	ASTRA® - SWEDEN&MARTINA® - ZIMMER® - BIOHORIZON® ALPHABIO® - MIS® - CAMLOG® - DENTIUM® - DENTIS® - BIOGENESIS®
ESAGONALE 1.3 mm		ST1035	ST1045	ST1055	ASTRA® - RHEIN83®
ESAGONALE 1.6 mm		ST1461	ST1465	ST1469	INTRALOCK® (FLAT ABUTMENT)
ESAGONALE 1.67 mm		ST1462	ST1466	ST1470	MATRIX®
ESAGONALE 1.8 mm		ST1036	ST1046	ST1056	ANKYOS® - BALANCE BASE®
QUADRATO 1.3 mm		ST1037	ST1047	ST1057	3I® - LIFE CORE®
QUADRILOBO		ST1463	ST1467	ST1471	THOMMEN®
A TAGLIO 2.0 mm		ST1038	ST1048	ST1058	
UNIGRIP 5.5 mm		ST1039	ST1049	ST1059	NOBEL® - ACTIVE® NOBEL® - BRANEMARK® NOBEL® - REPLACE® NEOSS®
TORX 6.0 mm		ST1040	ST1050	ST1060	STRAUMANN® - BONE LEVEL® STRAUMANN® - TISSUE LEVEL® STRAUMANN® - BLX® - BLT®
D.I.S. e (Esagono)		ST1127	ST1128	ST1129	ALL INCLINATED SCREWS BY ANTEEA®
D.I.S. t (Torx)		ST1464	ST1468	ST1472	DINAMIC ABUTMENT®

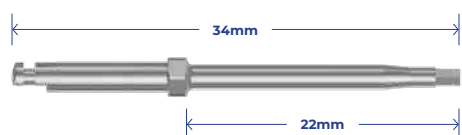

LUNGO

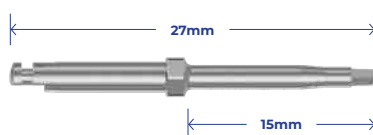

MEDIO



CORTO

SYSTEM TORQUE

DRIVER

CHIAVE PER M.U.A. DRITTO



ST1001

DRIVER LOKATOR



ST1003

DRIVER MONCONE SFERICO



ESAGONO Ø 2.0mm ST1002

DRIVER P.A.D.



ESAGONO Ø 2.7mm ST1004

DRIVER COMPONENTE SECONDARIA SYNOCTA



ST1063

DRIVER M.U.A. DRITTO DINAMOMETRICA



LONG ST1106
SHORT ST1107

WRENCH

WRENCH - TORQUE WRENCH



10-45 Ncm ST1008



15-70 Ncm ST1507



∞ Ncm ST1010



10-70 Ncm ST1130



10-100 Ncm ST1131

IMPUGNATURA MANUALE LAB.



ST1006

IMPUGNATURA MANUALE STUDIO



ST1005

ADATTATORE PER WRENCH NOBEL



ST1189

ADATTATORE PER WRENCH STRAUMANN



ST1007

SCHEMI DI SERRAGGIO

Per un corretto serraggio delle viti Anteea® si consiglia l'uso dei nostri driver originali e chiave dinamometrica dedicata.

Si consiglia di rispettare sempre i valori contenuti in questa tabella di riferimento. Anteea® non risponde di eventuali rotture delle viti, dovuto all'impiego di attrezzature non conformi.

VITI PASSANTI PER SERRARE GLI IMPIANTI ED ABUTMENT

M 1.4	M 1.6	M 1.8	M 2.0	M 2.5
12 Ncm	25 Ncm	30 Ncm	35 Ncm	35 Ncm
A-SERIE BH-SERIE EV-SERIE N-SERIE	A-SERIE B-SERIE C-SERIE D-SERIE FX-SERIE N-SERIE EV-SERIE	AK-SERIE AL-SERIE BT-SERIE BH-SERIE CX-SERIE EV-SERIE	LP-SERIE MS-SERIE R-SERIE SK-SERIE SO-SERIE Z-SERIE	A-SERIE B-SERIE EV-SERIE N-SERIE O-SERIE
			R-SERIE S-SERIE SO-SERIE SK-SERIE WS-SERIE	B-SERIE

VITI PASSANTI PER SERRARE SOVRASTRUTTURE PROTESICHE AGLI ABUTMENT

M 1.4	M 1.6	M 1.8	M 2.0
12 Ncm	25 Ncm	30 Ncm	35 Ncm
A-SERIE AL-SERIE B-SERIE BE-SERIE BH-SERIE C-SERIE D-SERIE	MS-SERIE N-SERIE O-SERIE R-SERIE SK-SERIE SO-SERIE T-SERIE Z-SERIE	AK-SERIE FX-SERIE	EV-SERIE Z-SERIE
			S-SERIE LE-SERIE

VITI TRANSMUCOSE DI GUARIGIONE

M 1.4	M 1.6	M 1.8	M 2.0	M 2.5
12 Ncm	25 Ncm	30 Ncm	35 Ncm	35 Ncm
A-SERIE BH-SERIE N-SERIE	A-SERIE B-SERIE C-SERIE D-SERIE FX-SERIE N-SERIE	AK-SERIE AL-SERIE BT-SERIE BH-SERIE LP-SERIE	MS-SERIE R-SERIE SK-SERIE SO-SERIE Z-SERIE	B-SERIE O-SERIE R-SERIE S-SERIE SO-SERIE SK-SERIE WS-SERIE
				B-SERIE

SURGICAL GUIDE SLEEVES



CARATTERISTICHE:

Il posizionamento delle sleeves può avvenire sia per ritenzione o per incollaggio.

Il design delle sleeves è ottimizzato e consente anche l'utilizzo in spazi interdentali ristretti.


Le sleeves Anteea® sono compatibili con le diverse case implantari disponibili a catalogo e con i maggiori software per chirurgia guidata 3Shape®, Exoplan®, Medialab®, Real Guide®, ed Exoplan Guide Creator®.

APPLICAZIONE:

Per preparare il sito implantare utilizzare le frese chirurgiche della relativa casa implantare in quanto le sleeves garantiscono totale compatibilità.

DETTAGLI TECNICI:

- Titanio grado 5 o PEEK Polietereeterketone

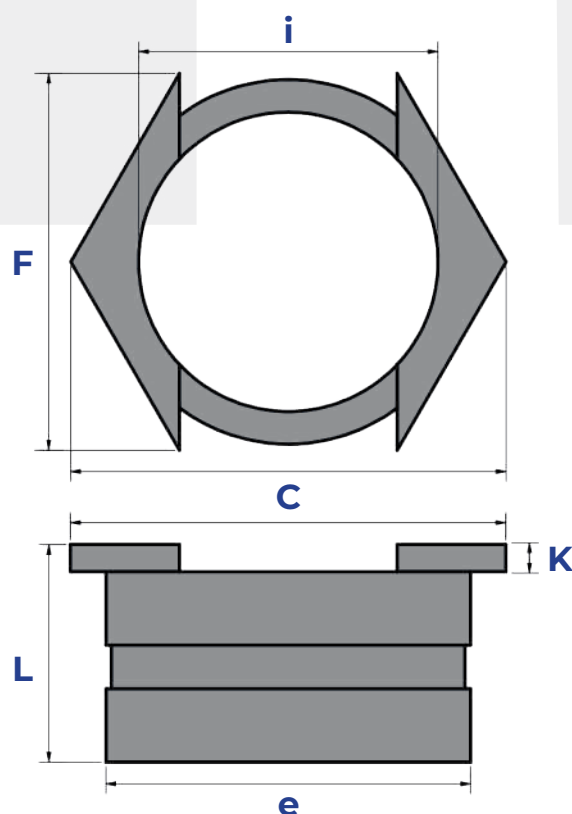

SURGICAL GUIDE SLEEVES

GUIDE SLEEVE FOR:	CODE:	Ø i	Ø e	K	C	F	L
Biomet 3i Ø4.1	ST1260	4.15	5.18	0.25	5.6	X	4
Biomet 3i Ø5.0	ST1389	5.0	6.18	0.25	6.6	x	4
Alphabio® Ø4.1	ST1009	4.1	5.0	1.5	5.5	x	5
Alphabio® Ø5.5	ST1261	5.5	6.35	1.5	7.0	x	5
Alphabio® Ø4.1 CAMMA	ST1390	4.1	5.5	x	5.5	x	4
Alphabio® Ø5.5 CAMMA	ST1391	5.5	6.7	1.5	7.3	x	4
Ankylos® ND	ST1360	4.48	6.0	0.5	7.0	5.7	4
Ankylos® WD	ST1361	4.9	6.0	0.5	7.0	5.7	4
Astra EV® ND	ST1362	4.6	5.6	0.5	7.0	x	4
Astra EV® WD	ST1363	5.2	6.0	0.5	8.0	x	4
Astra TX® Small	ST1364	4.7	6.0	0.5	7.0	5.7	4
Astra TX® Large	ST1365	5.7	7.0	0.5	8.0	6.7	4
Bicon® Violet	ST1366	4.0	5.2	0.3	5.7	x	5
Bicon® Red	ST1367	4.5	5.7	0.3	6.2	x	5
Bicon® Yellow	ST1368	5.0	6.2	0.3	6.75	x	5
BioHorizons® Yellow	ST1369	4.3	5.3	0.5	6.0	4.5	6
BioHorizons® Green	ST1370	5.1	6.0	0.5	6.6	5.4	6
BioHorizons® Blue	ST1371	6.3	7.0	0.5	7.0	6.5	6
Camlog® Ø3.5	ST1372	3.5	4.8	0.5	5.8	4.5	3
Camlog® Ø4.5	ST1373	4.5	5.6	0.5	6.6	5.1	3
Camlog® Ø4.5	ST1255	4.5	5.6	0.5	6.6	5.1	4
IDC® Guide Pilot	ST1254	2.4	3.4	0.5	4.2	x	6
IDC® SP	ST1374	3.50	4.5	0.5	5.8	4.5	4
IDC® NP	ST1255	4.5	5.5	0.5	6.6	5.1	4
IDC® LP	ST1256	5.5	6.5	0.5	7.7	x	4
Sleeves K (NP) Ø4.5	ST1305	4.5	5.5	0.5	5.5	x	4
Sleeves K (LP) Ø5.5	ST1486	5.5	6.7	0.5	7.5	x	4
IDC® PEEK Esa Ø4.5 NP	ST1303	4.5	5.5	0.3	x	x	4
IDC® PEEK Esa Ø5.5 LP	ST1304	5.5	6.5	0.5	x	x	4
IDC® Ø4.5 NP CAMMA	ST1390	4.5	5.5	x	5.5	x	4
IDC® Ø5.5 LP CAMMA	ST1391	5.5	6.7	1.5	7.3	x	4
Medialab® Ø4.1	ST1009	4.1	5.00	1.5	5.5	x	5
Medialab® Ø5.5	ST1261	5.5	6.35	1.5	7.0	x	5
Medialab® Ø4.1 CAMMA	ST1390	4.1	5.5	x	x	x	4
Medialab® Ø5.5 CAMMA	ST1391	5.5	6.7	1.5	7.3	x	4
Mis® Narrow	ST1375	4.0	4.6	0.5	5.5	x	4
Mis®	ST1376	5.5	6.5	0.5	7.0	6.0	4.5
Nobel Biocare® NP	ST1377	4.1	5.0	0.5	5.8	4.4	3.5
Nobel Biocare® RP	ST1378	5.0	6.0	0.5	7.0	5.6	3.5
Nobel Biocare® WP	ST1379	6.2	7.0	0.5	8.0	6.7	3.5
Straumann® Ø2.8	ST1380	2.8	4.8	0.4	5.8	4.5	4
Straumann® Ø5.0	ST1259	5.0	6.3	0.4	7.0	5.6	5
Sweden&Martina® Ø4.25	ST1382	4.25	5.0	0.5	5.5	x	5
Sweden&Martina® Ø5.5	ST1383	5.55	6.35	0.5	7.0	x	5
Xive® ND	ST1360	4.48	6.0	0.5	7.0	5.7	4
Xive® WD	ST1363	5.2	6.0	0.5	7.0	5.7	4
Zimmer® A	ST1386	4.20	5.2	0.5	5.5	x	4
Zimmer® B	ST1387	5.3	6.30	0.5	7.0	x	4
Sleeve for Anchor Pin Medialab	ST1295	1.5	3.2	0.8	3.8	x	3
Sleeve for Anchor Pin IDC	ST1476	1.5	3.2	0.5	3.5	x	6
Fresa Pin Laterale	ST1295						
Pin Laterale	ST1302						

N.B. Tutte le misure sono espresse in millimetri

SMART LOCK-C SCREW

Per avvitalenti occlusali e orizzontali

CARATTERISTICHE:

Con il sistema Smart Lock C Screw è possibile eseguire l'avvitamento di protesi amovo-inamovibili. È così possibile realizzare un avvitamento sia trasversale che occlusale.

Quando la direzione della vite, nel cavo orale del paziente, per motivi funzionali ed estetici deve essere cambiata, l'avvitamento può essere riposizionato e adattato alle nuove esigenze.

Questo sistema rappresenta una nuova soluzione di avvitamento secondario individuale per i materiali di nuova generazione come: Zirconio, BioHpp, etc.



KIT M1.4 - ST1583

2 Microviti Coniche M1.4
2 Anelli Calcinabili M1.4
2 Guaine Filettate M1.4



KIT M1.6 - ST1584

2 Microviti Coniche M1.6
2 Anelli Calcinabili M1.6
2 Guaine Filettate M1.6



Microvite Conica M1.4

Microvite Conica M1.6

Titanio

CODE:	L	T	LT*	M	E	G
AN2252	4.5	2.1	2.5	1.4	0.9	1.5
AN4661	5.2	2.2	2.5	1.6	0.9	1.7

* accorciabile max 1.4mm



Anello Copertura M1.4

Anello Copertura M1.6

POM - Poliossimetilene

CODE:	L	T	C	G
AN4643	2.1	2.1	2.7	1.5
AN4659	2.1	2.2	2.8	1.7



Guaina Filettata M1.4

Guaina Filettata M1.6

Titanio

CODE:	L	D	F
AN2430	3.5	2.8	2.3
AN4645	3.6	2.9	2.4

CACCIAVITE MANUALE



ST1424

CACCIAVITE CONTRANGOLO



ST1021

N.B. Tutte le misure sono espresse in millimetri

SMART LOCK-T BAR

Per avvitamento trasversale

CARATTERISTICHE:

Con il sistema Smart - Lock T Bar è possibile eseguire l'ancoraggio della protesi amovo-inamovibili realizzando un avvitamento trasversale.

Quando la direzione della vite, nel cavo orale del paziente, per motivi funzionali ed estetici deve essere cambiata, l'avvitamento può essere riposizionato e adattato alle nuove esigenze.

Questo sistema rappresenta una nuova soluzione di ancoraggio individuale per le strutture secondarie realizzate con materiali di nuova generazione come: Zirconio, BioHpp, etc



KIT M1.4 - ST1585

2 Microviti M1.4
2 Smart Connector M1.4
2 Guaine Filettate M1.4






KIT M1.6 - ST1586

2 Microviti M1.6
2 Smart Connector M1.6
2 Guaine Filettate M1.6



KIT M1.8 - ST1587


2 Microviti M1.8
2 Smart Connector M1.8
2 Guaine Filettate M1.8



	CODE:	DT	F	E	C*	A	B	L	CH	LC
Vite con Perno M1.4	AN4647	ø1.4	ø1.3	1.0	2.5	5.0	3.5	8.5	0.9	2.3
Vite con Perno M1.6	AN4648	ø1.6	ø1.5	1.0	2.5	5.0	3.5	8.5	0.9	2.3
Vite con Perno M1.8	AN4649	ø1.8	ø1.7	1.0	2.5	5.0	3.5	8.5	0.9	2.3

Titanio

* accorciabile max 1.4mm

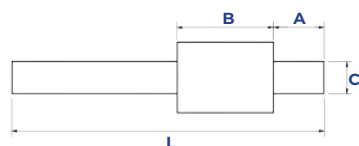

Perno Modellazione ø1.4

CODE:	L	A	B	C
-------	---	---	---	---


Perno Modellazione ø1.6

AN4660	11	3.5	5.3	ø1.3
--------	----	-----	-----	------

Perno Modellazione ø1.8

AN4646	11	3.5	5.3	ø1.5
AN4662	11	3.5	5.3	ø1.7

Ottone



Guaina Filettata M1.4

CODE:	DT	F	D	A	L
-------	----	---	---	---	---

Guaina Filettata M1.6

AN4663	ø2.8	ø1.3	1.4	5.0	5.3
--------	------	------	-----	-----	-----

Guaina Filettata M1.8

AN4664	ø2.8	ø1.5	1.6	5.0	5.3
AN4665	ø3.2	ø1.7	1.8	5.0	5.3

Titanio

CACCIAVITE MANUALE



ST1424

CACCIAVITE CONTRANGOLO



ST1021

N.B. Tutte le misure sono espresse in millimetri

SMART LOCK-B SCREW

Per avvitamento occlusale con stop

CARATTERISTICHE:

La tecnica Smart Lock-B permette di ancorare la struttura secondaria alla primaria per mezzo di due sistemi :
o per ancoraggio diretto o per cementazione della guaina filettata nella struttura.



Il primo sistema quello dell'ancoraggio diretto è possibile integrare viti aggiuntive per avvitare la struttura secondaria es: (in zirconio) alla barra in titanio. Grazie alle nuove funzioni dei software in commercio è possibile visualizzare le posizioni virtuali delle viti e generare filettature.

I canali della vite generati nel software vengono integrati nella barra durante la fresatura. La barra in titanio viene quindi avvitata agli impianti e la struttura secondaria alla barra.

Il secondo sistema è quello analogico , inserire nella struttura primaria incollando una ghiera filettata, così che per mezzo della cannula guida (in dotazione) possiamo generare il canale vite (con il metodo analogico) così che possiamo ancorare la struttura secondaria alla barra primaria .

La tecnica Smart Lock-B non solo evita i canali vestibolari non estetici, ma migliora anche la manutenzione e l'igiene post-operatorie.

Con la tecnica Smart Lock-B è così possibile realizzare riabilitazioni su barra altamente stabili anche in casi complessi senza comprometterne l'estetica.

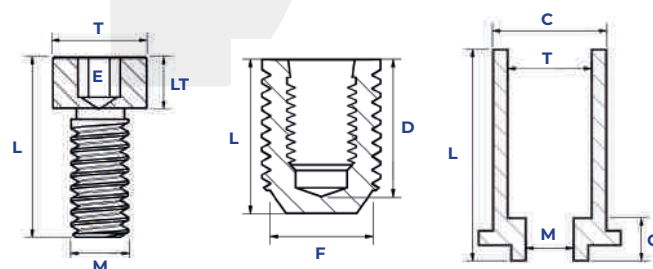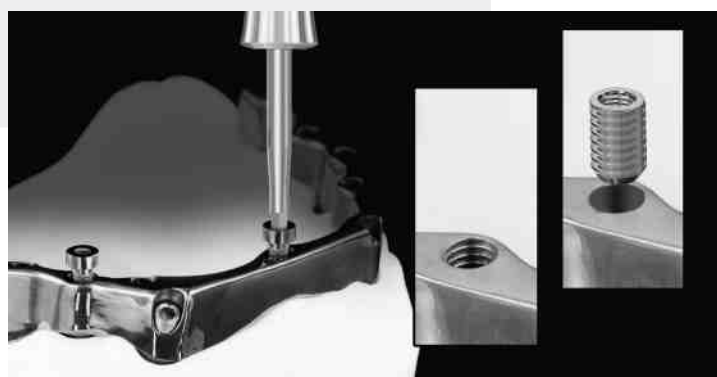

SMART LOCK - B Kit M1.4 - ST1589

2 Microviti M1.4
2 Smart Connector POM
2 Guaine Filettate M1.4



SMART LOCK - B Kit M1.6 - ST1590

2 Microviti M1.6
2 Smart Connector POM
2 Guaine Filettate M1.6



Microvite M1.4

Microvite M1.6

Titanio

CODE:	L	T	LT*	M	E
AN4652	6.7	2.3	0.7	1.4	1.2
AN4653	6.7	2.3	0.7	1.6	1.2

* accorciabile max 2.0mm



Smart Connector - POM

Smart Connector - TITANIO

CODE:	L	T	C	G	M
AN4654	8.0	2.4	3.0	1.0	1.7
AN4655	8.0	2.4	3.0	1.0	1.7



Guaina Filettata M1.4

Guaina Filettata M1.6

Titanio

CODE:	L	D	F
AN2430	3.5	2.8	2.3
AN4645	3.6	2.9	2.4



Perno Filettato M1.4

Perno Filettato M1.6

Titanio

CODE:

AN1663

AN1241

CACCIAVITE MANUALE



ST1426

CACCIAVITE CONTRANGOLO



ST1035

MATERIALI

ACCIAIO KLEINOX 4598

Aspetto

Colore

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE

Odore

Resistenza alla trazione

Trattamento termico

Velocità di taglio

COMPOSIZIONE CHIMICA (%)

Carbonio (C)

Silicio (Si)

Manganese (Mn)

Fosforo (P)

Zolfo (S)

Cromo (Cr)

Nichel (Ni)

Molibdeno (Mo)

Rame (Cu)

Solido

Grigio metallico

Inodore

ca 740-960 N/mm² (a seconda della misura)

ricottura: 1050°C con raffreddamento in H₂O

da 45 a 60 m/min in relazione ad utensili e tipo di pezzo

Max 0,03%

Max 1,00

Max 2,00

Max 0,045

0,10-0,20

16,5-18,5

10-13

2,0-2,5

1,3-1,8

Kleinox 4598-4404+S+Cu è un acciaio legato al Cr-Ni-Mo adatto per lavorazione su torni automatici impiegato soprattutto dove è richiesta altissima resistenza alla corrosione. In particolare, con l'aggiunta di zolfo e rame si ottengono elevate caratteristiche di lavorabilità.



TITANIO GR. 5**

Aspetto

Colore

Solido

Grigio metallico

PROPRIETÀ MECCANICHE

	Tensione a rottura	Carico di snervamento	Allungamento (4D)	Allungamento (5D)	Riduzione di area %	Modulo (info only)
Specifiche (min)	135 ksi	125 ksi	10%	10%	25%	Mps (info only)
Risultati	143,7	131,1	22,4	20,8	51,7	15,6


COMPOSIZIONE CHIMICA

	Spec. min.	Spec. max.	Top	Bottom
Vanadio (V)	3,5	4,5	4,0	4,0
Alluminio (Al)	5,5	6,5	6,0	6,0
Carbonio (C)	0	0,08	0,01	<0,01
Ferro (Fe)	0	0,25	0,16	0,16
Azoto (N)	0	0,05	0,01	0,01
Ossigeno (O)	0	0,13	0,11	0,12
Ittrio (Y)	0	0,005	< 0,001	< 0,001
Titanio (Ti)		Balance		

**** Queste informazioni tecniche fanno fede a quanto espressamente riportato nelle normative vigenti per l'utilizzo del Titanio gr.5 in implantologia:**

• Specifiche standard per saldato Titanium-6 in alluminio-4 Vanadium ELI (Extra Low Interstitial) in lega per applicazioni di impianti chirurgici;

• ISO 5832-3:1996: Impianti per la chirurgia - materiali metallici - Parte 3: lega di titanio saldato 6-alluminio a 4-Vanadio.



MATERIALI

LEGA DI CROMO COBALTO

Aspetto

Colore

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE

Odore

Intervallo di fusione

Temperatura di colata

Densità

Carico di rottura (MPa)

Carico di snervamento Rp 0,2%

Modulo di elasticità

Allungamento percentuale A%

Riduzione di area %

Durezza Vickers HV 30

COMPOSIZIONE ELEMENTARE IN PESO

Cromo (Cr)

Molibdeno (Mo)

Tungsteno (W)

Cobalto (Co)

Solido

Grigio metallico

Inodore

1.310-1.330°C

1.450°C

8.8 g/cm³

700 MPa

580 MPa

210 MPa

8%

10%

300

22%

6.5%

6%

63%

Possono essere presenti inoltre elementi come P,S,Cu,Al,V,Nb,etc.

La concentrazione in peso di questi elementi è inferiore ai limiti riportati nel supplemento ordinario alla G.U. 29/02/1992, Serie Generale nr. 50. Essi non sono classificati come pericolosi per la salute o non sono soggetti a limiti di esposizione riconosciuti.

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

Aspetto

Colore

PROPRIETÀ MECCANICHE

Resistenza a trazione - rottura

Allungamento a rottura

Modulo elastico a trazione

Resistenza agli urti

Durezza Rokwell

Durezza alla sfera di acciaio

Limite a tensione

Compressione-carico per determinare 2% di deformazione

Coefficiente di attrito dinamico (con acciaio)

PROPRIETÀ TERMICHE

Punto di fusione Met. A

Temperatura di utilizzo:

- minima

- per qualche ora

- 5.000 ore (50% res. a trazione)

- 20.000 ore (50% res. a trazione)

Temperatura Met.A di distorsione ISO 75 Met.B

Coefficiente di dilatazione termica lineare

Conduttività termica Met.A

Calore specifico

Solido

Naturale (Sabbia)

97 N/mm²

25%

3,600 N/mm²

NR

M105

230 N/mm²

-

57 N/mm²

-

340°C

-60°C

300°C

260°C

250°C

152°C

4,7 1/K-105

0,25 W/K-m

-

Tutti i valori qui indicati sono stati testati con una temperatura di +23°C e umidità relativa del 50%.

I dati qui riportati vogliono essere un aiuto affinché sia possibile individuare ed utilizzare il tipo di materiale più adatto nelle varie applicazioni.

Poiché le condizioni di impiego generalmente non corrispondono a quelle dei metodi di prova, questi valori dovranno essere considerati solo come una indicazione e non una base di calcolo per l'ottenimento dei limiti specifici in fase di progettazione; tutti i dati di questo prospetto sono forniti in buona fede, ma senza garanzia e non implicano responsabilità da parte nostra

MATERIALI MATERIALS

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

Colore

PROPRIETÀ TERMICHE

Temperatura di transizione vetrosa (DIN 537665);
Temperatura di distorsione (HTD metodo A - DIN 53461);
Temperatura di distorsione (HTD metodo B - DIN 53461);
Temperatura massima per l'utilizzo a breve;
Temperatura massima per l'utilizzo in continuo;
Conducibilità termica (23°C);
Calore specifico;
Coefficienti di dilatazione termica lineare a 23-55°C (DIN 53752).

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE


Densità (DIN 53479);
Tensione di snervamento (ISO 527);
Tensione di rottura a trazione (ISO 527);
Modulo elastico a trazione (ISO 527);
Durezza con penetrazione a sfera (DIN 53456);
Resistenza all'urto a 23°C (Charpy, ISO 179);
Resistenza a compressione;
Varie
Assorbimento umidità (23°C / 50% RH, ISO 62);
Assorbimento d'acqua (ISO 62).

Trasparente

105°C
60°C
100°C
100°C
100°C
0,19 W/(mK)
1,47 J/(gK)
7 x 10⁻⁵ 1/K

1,18 g/cm³
60 MPa
3-8 MPa
3000 MPa
180
18KJ/m²
110 MPa

1%
2%



POM - POLIOSSIMETILENE

Colore

PROPRIETÀ TERMICHE

Temperatura di fusione (DIN 53736)
Temperatura di trasformazione vetrosa (DIN 537665);
Temperatura di stabilità dimensionale (metodo A - ISO 75);
Temperatura di stabilità dimensionale (metodo B - ISO 75);
Temperatura massima per l'utilizzo a breve;
Temperatura massima per l'utilizzo in continuo;
Capacità termica specifica;
Conducibilità termica;
Coefficienti di dilatazione termica lineare.

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE

Densità (DIN 53479);
Tensione di snervamento (ISO 527);
Allungamento a rottura (ISO 527);
Modulo di elasticità alla trazione (ISO 527);
Durezza con penetrazione a sfera (DIN 53456);
Resistenza all'urto a 23°C (Charpy, ISO 179);
Resistenza a rottura per creep (a 1000 ore carico statico).
Varie
Assorbimento umidità (23°C / 50% RH, ISO 62);
Assorbimento d'acqua (ISO 62).

Bianco opaco

165°C
-60°C
110°C
160°C
140°C
100°C
1,5 J/(gK)
0,31 W/(mK)
10x10⁻⁵ 1/K

1,18 g/cm³
65 MPa
40%
3000 MPa
150
Intatto - Unbroken
40 MPa

0,3%
0,5%





Orgogliosamente Italiani



20 anni di storia, ricerca e manifattura
più di **15** paesi forniti nel mondo
oltre **600.000** componenti prodotti annualmente
1500 mq di superficie produttiva, logistica e amministrativa
200 mq di spazio congressi e formazione







Viale Europa, 126 O/P - 55012 - loc. Lammari (LUCCA) - ITALY
Tel.+39 0583 308371 - info@anteea.com
www.anteea.com